



## AVVERTENZA del 06/06/2025

IMPORTANTE PER GLI UTILIZZATORI DEL PRODOTTO:

### « HCV ELITe MGB<sup>®</sup> Kit » Ref. RTK601ING

Questa nuova revisione dell'IFU contiene le seguenti modifiche:

Marcatura CE secondo il nuovo Regolamento Europeo 2017/746 (IVDR).

Aggiornamento delle prestazioni analitiche e diagnostiche nel paragrafo "CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI"

Composizione, utilizzo e prestazioni del prodotto restano del tutto invariate.

### NOTA BENE

I lotti di prodotto sotto elencati, con marcatura CE secondo la Direttiva IVDD, rimarranno presenti sul mercato fino alla data di scadenza, in accordo all' Articolo 110 dell' IVDR. Se in possesso di questi lotti, si prega di contattare il personale di ELITechGroup per richiedere la relativa precedente revisione delle IFUs.

NUMERO DI CATALOGO	Numero di Lotto	Data di scadenza
RTK601ING	C0125-009	31/07/2026




ELITechGroup S.p.A.  
C.so Svizzera, 185  
10149 Torino ITALIA  
Uffici: Tel. +39-011 976 191 Fax +39-011 936 76 11  
E-mail: emd.support@elitechgroup.com  
Sito internet: www.elitechgroup.com

# HCV ELITe MGB® Kit


reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

**REF**

RTK601ING



0123



**UDI**

08033891487072

**INDICE**

<b>USO PREVISTO</b>	pagina 1
<b>PRINCIPIO DEL SAGGIO</b>	pagina 2
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	pagina 2
<b>MATERIALI INCLUSI NEL PRODOTTO</b>	pagina 3
<b>MATERIALI RICHIESTI MA NON INCLUSI NEL PRODOTTO</b>	pagina 3
<b>ALTRI PRODOTTI RICHIESTI</b>	pagina 4
<b>AVVERTENZE E PRECAUZIONI</b>	pagina 4
<b>CAMPIONI E CONTROLLI</b>	pagina 5
<b>PROCEUDRA ELITe InGenius</b>	pagina 7
<b>PROCEDURA ELITe BeGenius</b>	pagina 13
<b>CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI</b>	pagina 17
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	pagina 28
<b>LIMITI DELLA PROCEDURA</b>	pagina 29
<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	pagina 30
<b>LEGENDA DEI SIMBOLI</b>	pagina 32
<b>AVVISO PER L'UTILIZZATORE</b>	pagina 32
<b>AVVISO PER L'ACQUIRENTE: LICENZA LIMITATA</b>	pagina 33
<b>ANNEX: QUICK GUIDE</b>	pagina A

**USO PREVISTO**

Il prodotto **HCV ELITe MGB® Kit** è un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* destinato all'uso da parte degli operatori sanitari come saggio di trascrizione inversa e Real-Time PCR quantitativa degli acidi nucleici per la rilevazione e la quantificazione dell'RNA del virus dell'epatite C (HCV), estratto da campioni clinici.

Il saggio è validato in associazione agli strumenti **ELITe InGenius®** e **ELITe BeGenius®**, sistemi integrati e automatizzati per l'estrazione, la trascrizione inversa, la Real-Time PCR e l'interpretazione dei risultati a partire da campioni di plasma umano raccolto in EDTA o in ACD e di siero.

Il prodotto è destinato all'uso come ausilio nella gestione di pazienti HCV-positivi sottoposti a terapia antivirale.

I risultati devono essere interpretati in associazione a tutte le osservazioni cliniche rilevanti e gli esiti degli esami di laboratorio.

Il prodotto non è destinato all'uso come test di screening o per rilevare la presenza di o l'esposizione ad agenti trasmissibili nel sangue, negli emoderivati, nelle cellule, nei tessuti, negli organi o in qualsiasi dei loro

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

derivati al fine di valutarne l'idoneità per la trasfusione, il trapianto o la terapia cellulare. Il prodotto non è destinato all'uso come test diagnostico per confermare la presenza di un'infezione da HCV.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

### PRINCIPIO DEL SAGGIO

Il saggio è una reazione di trascrizione inversa e Real-Time PCR (metodica one step) quantitativa per l'estrazione, la trascrizione inversa, l'amplificazione e la rilevazione dell'RNA di HCV isolato dai campioni clinici, utilizzando una miscela di reazione completa che contiene primer e sonde con tecnologia ELITE MGB®.

Le sonde ELITE MGB sono attivate mediante ibridazione con i prodotti specifici della PCR. **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius** monitorano l'incremento di fluorescenza emessa e calcolano i "cicli soglia" (Ct) e le temperature di melting (Tm). La quantità di HCV è calcolata sulla base di una curva di calibrazione.

Nelle sonde ELITE MGB i fluorofori non emettono segnale quando la sonda non ibrida con il prodotto di reazione specifico. Quando la sonda ibrida con il prodotto specifico di amplificazione, il quencher viene separato dal fluoroforo ed emette il segnale di fluorescenza. Da notare che la sonda non viene idrolizzata durante la PCR e può essere utilizzata per l'analisi di dissociazione e il calcolo della temperatura di melting.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'**HCV ELITE MGB Kit** fornisce i seguenti componenti:

- **HCV ELITE MGB Mix**

Questo componente fornisce i seguenti due componenti secondari:

- **HCV PCR Mix**, miscela per PCR ottimizzata e stabilizzata, che contiene:
  - primer e sonda specifici per l'**HCV**, la regione 5' UTR, rilevata dal canale **HCV**; la sonda è stabilizzata da MGB®, inattivata dall'Eclipse Dark Quencher® e marcata con il fluoroforo FAM;
  - primer e sonda specifici per il controllo interno (**IC**), per una regione di RNA genomico di fago **MS2**, rilevati dal canale **IC**; la sonda è stabilizzata da MGB, inattivata dall'Eclipse Dark Quencher e marcata con il fluoroforo AquaPhluor® AP525;
  - buffer, cloruro di magnesio, nucleotidi trifosfato e DNA polimerasi ad attivazione termica ("hot-start"). Ogni provetta contiene **600 µL** di soluzione ed è sufficiente per **24 test**, se si processano almeno 5 campioni per sessione.
- **RT EnzymeMix**, una miscela ottimizzata e stabilizzata di enzimi per trascrizione inversa. Ogni provetta contiene **20 µL** di soluzione ed è sufficiente per **48 test**, se si processano almeno 5 campioni per sessione.

**HCV ELITE MGB Mix** contiene reagenti sufficienti per **96 test** su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius**, usando 20 µL di **HCV PCR Mix** e 0,3 µL di **RT EnzymeMix** per reazione.

- **HCV ELITE Standard**

Questo componente fornisce i sub-componenti **HCV Q-PCR Standard**, quattro soluzioni stabilizzate di DNA plasmidico con la regione 5' UTR di HCV amplificata a **titolo noto**. **HCV ELITE Standard** deve essere utilizzato con la miscela **HCV ELITE MGB Mix** su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius** per calcolare la curva di calibrazione del sistema (lotto del prodotto e strumento) per la quantificazione dell'HCV.

La concentrazione del DNA plasmidico in copie/mL è stata determinata mediante misurazione con uno spettrofotometro UV, ed è stata messa in correlazione con lo standard internazionale "WHO International Standard 6<sup>th</sup> HCV International Standard" (NIBSC, UK, codice 18/184) con l'ausilio di un fattore di conversione che consente di esprimere la quantificazione dell'HCV in unità internazionali/mL (IU/mL).

**HCV ELITE Standard** contiene reagenti sufficienti per eseguire **2 sessioni** su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius**, usando 20 µL per reazione.

- **HCV - ELITE Positive Control**

Questo componente contiene il sub-componente **HCV Positive Control**, una soluzione stabilizzata di DNA plasmidico con la regione 5' UTR di HCV amplificata a **titolo noto**. **HCV Positive Control** deve essere utilizzato con la miscela **HCV ELITE MGB Mix** su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius** per creare i traccianti dei controlli per la verifica del sistema (lotto del prodotto e strumento).

**HCV Positive Control** contiene reagenti sufficienti per eseguire **8 sessioni** su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius (4 sessioni per provetta)**, usando 20 µL per reazione.

- **HCV Internal Control**

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

Questo componente contiene il sub-componente **HCV CPE** (controllo interno esogeno), una soluzione stabilizzata di RNA genomico di fago MS2. L'**HCV CPE** viene aggiunto ai reagenti di estrazione per validare i risultati di campioni HCV negativi.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

L'HCV Internal Control contiene reagenti sufficienti per eseguire **96 test** su ELITE InGenius e ELITE BeGenius (12 test per provetta), usando 10 µL per reazione.

L'HCV ELITE MGB Kit può essere utilizzato anche in associazione con strumenti equivalenti.

**MATERIALI INCLUSI NEL PRODOTTO**

Componente	Componente secondario	Descrizione	Quantità	Classificazione dei rischi
HCV ELITE MGB Mix rif. RTS601ING	HCV PCR Mix rif. RTS601ING	Miscela di reagenti per trascrizione inversa e real-time PCR in provetta con <b>tappo BIANCO</b>	4 x 600 µL	-
	RT EnzymeMix rif. RTS003-RT	Enzimi per trascrittasi inversa in provetta con <b>tappo con inserto-NERO</b>	2 x 20 µL	-
HCV ELITE Standard rif. STD601ING	HCV Q-PCR Standard 10 <sup>5</sup> rif. STD601ING-5	Soluzione di plasmide in provetta con <b>tappo ROSSO</b>	1 x 160 µL	-
	HCV Q-PCR Standard 10 <sup>4</sup> rif. STD601ING-4	Soluzione di plasmide in provetta con <b>tappo BLU</b>	1 x 160 µL	
	HCV Q-PCR Standard 10 <sup>3</sup> rif. STD601ING-3	Soluzione di plasmide in provetta con <b>tappo VERDE</b>	1 x 160 µL	
	HCV Q-PCR Standard 10 <sup>2</sup> rif. STD601ING-2	Soluzione di plasmide in provetta con <b>tappo GIALLO</b>	1 x 160 µL	
HCV - ELITE Positive Control rif. CTR601ING	HCV Positive Control rif. CTR601ING	Soluzione di plasmide in provetta con <b>tappo NERO</b>	2 x 160 µL	-
HCV Internal Control rif. CPE601ING	HCV CPE rif. CPE601ING	Soluzione di DNA plasmidici e RNA genomico di fago MS2 in provetta con <b>tappo NEUTRO</b>	8 x 160 µL	-

**Nota:** La concentrazione dei quattro prodotti **Q – PCR Standard** è espressa in copie/reazione (10<sup>5</sup> copie/rxn, 10<sup>4</sup> copie/rxn, 10<sup>3</sup> copie/rxn, 10<sup>2</sup> copie/rxn).

**MATERIALI RICHIESTI MA NON INCLUSI NEL PRODOTTO**

- Cappa a flusso laminare.
- Guanti senza polvere monouso in nitrile o materiale analogo.
- Agitatore vortex.
- Centrifuga da banco (~3.000 giri/minuto).
- Microcentrifuga da banco (~13.000 giri/minuto).
- Micropipette e puntali sterili con filtro per aerosol o a spostamento positivo (0,5-10 µL, 2-20 µL, 5-50 µL, 50-200 µL, 200-1000 µL).
- Provette sterili da 2,0 mL con tappo a vite (Sarstedt, Germania, rif. 72.694.005).
- Acqua per biologia molecolare.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

### ALTRI PRODOTTI RICHIESTI

I reagenti per l'estrazione dell'RNA dai campioni e i materiali di consumo **non** sono inclusi in questo prodotto. Per l'estrazione automatica degli acidi nucleici, la trascrizione inversa, la Real-Time PCR e l'interpretazione dei risultati dei campioni, sono richiesti i seguenti prodotti.

Strumenti e software	Prodotti e reagenti
<b>ELITE InGenius</b> (ELITechGroup S.p.A., EG SpA rif. INT030)	
<b>ELITE InGenius Software</b> versione 1.3.0.17 (o successiva)	
<b>HCV ELITE_PC</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi del Controllo Positivo	
<b>HCV ELITE_NC</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi del Controllo Negativo	
<b>HCV ELITE_STD</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi dei Calibratori	
<b>HCV ELITE_PL_600_50</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi dei campioni di Plasma	
<b>HCV ELITE_Se_600_50</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi dei campioni di Siero	
<b>ELITE BeGenius</b> (EG SpA, rif. INT040)	
<b>ELITE BeGenius Software</b> versione 2.1.0. (o successiva)	
<b>HCV ELITE_Be_PC</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi del Controllo Positivo	
<b>HCV ELITE_Be_NC</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi del Controllo Negativo	
<b>HCV ELITE_Be_STD</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi dei Calibratori	
<b>HCV ELITE_Be_PL_600_50</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi dei campioni di Plasma	
<b>HCV ELITE_Be_Se_600_50</b> , Assay Protocol con i parametri per l'analisi dei campioni di Siero	
	<b>ELITE InGenius SP 1000</b> (EG SpA, rif. INT033SP1000)
	<b>ELITE InGenius SP 200 Consumable Set</b> (EG SpA, rif. INT032CS)
	<b>ELITE InGenius PCR Cassette</b> (EG SpA, rif. INT035PCR),
	<b>300 µL Filter Tips Axygen</b> (Corning Life Sciences Inc., rif. TF-350-L-R-S) solo con ELITE InGenius
	<b>1000 µL Filter Tips Tecan</b> (Tecan, Svizzera, rif. 30180118) solo con ELITE BeGenius
	<b>ELITE InGenius® Waste Box</b> (EG SpA, rif. F2102-000)

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

**Questo prodotto è riservato esclusivamente all'uso *in vitro*.**

#### Avvertenze e precauzioni generali

Manipolare e smaltire tutti i campioni biologici come se fossero potenzialmente infettivi. Evitare il contatto diretto con campioni biologici. Evitare di produrre schizzi o aerosol. Provette, puntali e altri materiali che vengono a contatto con i campioni biologici devono essere trattati per almeno 30 minuti con ipoclorito di sodio (candeggina) al 3% o in autoclave a 121 °C per un'ora prima di smaltirli.

Manipolare e smaltire tutti i reagenti e tutti i materiali utilizzati per eseguire il saggio come se fossero potenzialmente infettivi. Evitare il contatto diretto con i reagenti. Evitare di produrre schizzi o aerosol. Trattare e smaltire i rifiuti nel rispetto di norme di sicurezza adeguate. Incenerire il materiale monouso combustibile. Neutralizzare i rifiuti liquidi contenenti acidi o basi prima di smaltirli. Evitare che i reagenti di estrazione entrino in contatto con l'ipoclorito di sodio (candeggina).

Indossare indumenti protettivi e guanti adatti a proteggersi gli occhi e il viso.

Non pipettare mai le soluzioni con la bocca.

Non mangiare, bere, fumare o applicare cosmetici sul posto di lavoro.

Lavarsi accuratamente le mani dopo avere maneggiato campioni e reagenti.

Eliminare i reagenti avanzati e i rifiuti secondo le norme vigenti.

Prima di eseguire il saggio, leggere attentamente tutte le istruzioni.

Durante l'esecuzione del saggio attenersi alle istruzioni fornite con il prodotto.

Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

Utilizzare solo i reagenti in dotazione con il prodotto e quelli consigliati dal fabbricante.  
Non utilizzare reagenti provenienti da lotti diversi.  
Non utilizzare reagenti di altri fabbricanti.

**Avvertenze e precauzioni per la biologia molecolare**

Le procedure di biologia molecolare devono essere eseguite da personale qualificato e addestrato per evitare il rischio di risultati errati, soprattutto a causa della degradazione degli acidi nucleici dei campioni o della contaminazione dei campioni stessi da parte di prodotti della PCR.

Utilizzare camici, guanti e strumenti per la preparazione delle sessioni di lavoro.

I campioni devono essere idonei e, se possibile, specifici per questo tipo di analisi. Manipolare i campioni sotto una cappa a flusso laminare. Utilizzare le pipette destinate alla manipolazione dei campioni solo per questo specifico scopo. Utilizzare pipette a spostamento positivo o con puntali con filtro per aerosol. Utilizzare puntali sterili, esenti da DNasi e RNasi, come anche da DNA e RNA.

Manipolare i reagenti sotto una cappa a flusso laminare. Utilizzare le pipette destinate alla manipolazione dei reagenti unicamente per questo scopo. Utilizzare pipette a spostamento positivo o con puntali con filtro per aerosol. Utilizzare puntali sterili, esenti da DNasi e RNasi, come anche da DNA e RNA.

Manipolare i prodotti di estrazione in modo tale da ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente per prevenire il rischio di contaminazione.

Manipolare con attenzione e non aprire mai la PCR Cassette in modo tale da evitare la diffusione dei prodotti della PCR nell'ambiente e la contaminazione dei campioni e dei reagenti.

**Avvertenze e precauzioni specifiche per i componenti**

Componente (Sub-componente)	Temperatura di conservazione	Uso dopo la prima apertura	Cicli di congelamento/scongelo	Stabilità sullo strumento (ELITE InGenius e ELITE BeGenius)
HCV ELITE MGB Mix (HBV PCR Mix)	-20 °C o inferiore (al riparo dalla luce)	60 giorni	Fino a cinque	Non applicabile
HCV ELITE MGB Mix (RT EnzymeMix)	-20 °C o inferiore	60 giorni	Fino a dieci cicli, fino a dieci minuti, a 2/8 °C	Non applicabile
HCV ELITE Standard (HCV Q-PCR Standard)	-20 °C o inferiore	60 giorni	Fino a due	2 sessioni separate di 2 ore ciascuna
HCV ELITE - Positive Control (HCV Positive Control)	-20 °C o inferiore	60 giorni	Fino a quattro	4 sessioni separate di 3 ore ciascuna
HCV ELITE Internal Control (HCV CPE)	-20 °C o inferiore	60 giorni	Fino a sei	6 sessioni separate di 3 ore ciascuna

**CAMPIONI E CONTROLLI****Campioni**

Questo prodotto deve essere utilizzato su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius** con i seguenti campioni clinici, identificati e manipolati secondo le linee guida del laboratorio e raccolti, trasportati e conservati nelle condizioni indicate di seguito:

Campione	Requisiti per la raccolta	Condizioni di trasporto/conservazione			
		16/26 °C (temperatura ambiente)	2/8 °C	-20 ± 10 °C	-70 ± 15 °C

**HCV ELITE MGB® Kit**reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR**REF** RTK601ING

<b>Plasma</b>	EDTA o ACD	≤1 giorno	≤3 giorni	≤1 mese	≤6 mesi
<b>Siero</b>	-	≤1 giorno	≤5 giorni	≤1 mese	≤6 mesi

Si raccomanda di suddividere i campioni in aliquote prima di congelarli, per evitare di ripetere più cicli di congelamento e scongelamento. Se si usano campioni congelati, scongelarli immediatamente prima dell'estrazione in modo da evitare la possibile degradazione degli acidi nucleici.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

Per l'analisi di campioni su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius**, è necessario utilizzare gli Assay Protocol di seguito elencati. Questi protocolli di saggio IVD sono stati validati per l'uso specifico con i kit ELITE MGB e con **ELITE InGenius** o **ELITE BeGenius** con le matrici indicate.

**Assay Protocol HCV ELITE MGB Kit**

Campione	Strumento	Nome Assay Protocol	Report	Caratteristiche
Plasma	<b>ELITE InGenius</b>	<b>HCV ELITE_PL_600_50</b>	Positivo / copie/mL / IU/mL / Negativo	Volume estrazione in ingresso: 600 µL Volume eluizione estratto: 50 µL Controllo interno: 10 µL Sonicazione: NO Fattore di diluizione: 1,7 Volume PCR Mix: 20 µL Volume del campione in PCR: 20 µL
	<b>ELITE BeGenius</b>	<b>HCV ELITE_Be_PL_600_50</b>	Positivo / IU/mL / copie/mL / Negativo	Volume estrazione in ingresso: 600 µL Volume eluizione estratto: 50 µL Controllo interno: 10 µL Sonicazione: NO Fattore di diluizione: 1 Volume PCR Mix: 20 µL Volume del campione in PCR: 20 µL
Siero	<b>ELITE InGenius</b>	<b>HCV ELITE_Se_600_50</b>	Positivo / copie/mL / IU/mL / Negativo	Volume estrazione in ingresso: 600 µL Volume eluizione estratto: 50 µL Controllo interno: 10 µL Sonicazione: NO Fattore di diluizione: 1,7 Volume PCR Mix: 20 µL Volume del campione in PCR: 20 µL
	<b>ELITE BeGenius</b>	<b>HCV ELITE_Be_Se_600_50</b>	Positivo / IU/mL / copie/mL / Negativo	Volume estrazione in ingresso: 600 µL Volume eluizione estratto: 50 µL Controllo interno: 10 µL Fattore di diluizione: 1 Volume PCR Mix: 20 µL Volume del campione in PCR: 20 µL

Per tutti i protocolli, si devono trasferire 600 µL di campione in un Extraction tube (per ELITE InGenius) o in una provetta Sarstedt da 2 mL (per ELITE BeGenius).

**Nota:** Il trasferimento dei campioni nella **Extraction tube** o nella **provetta Sarstedt da 2 mL** potrebbe **generare contaminazione**. Utilizzare le pipette appropriate e seguire tutte le raccomandazioni contenute nella sezione "Avvertenze e Precauzioni".

Gli acidi nucleici purificati possono essere lasciati a temperatura ambiente per 16 ore e conservati a -20 °C o a temperatura inferiore per un periodo non superiore a un mese.

Per controllare i dati relativi alle sostanze interferenti, fare riferimento a "Sostanze potenzialmente interferenti" nella sezione Caratteristiche delle prestazioni.

Non utilizzare plasma raccolto in eparina, che è un noto inibitore di trascrizione inversa e PCR.

Non utilizzare plasma emolitico, perché l'emoglobina inibisce la reazione della PCR.

**Calibratori e controlli per PCR**

La curva di calibrazione deve essere generata e approvata per ogni lotto di reagente per PCR.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

- Per la curva di calibrazione, usare i quattro livelli del prodotto **HCV ELITE Standard**, fornito in dotazione con questo kit, con gli Assay Protocol **HCV ELITE\_STD** o **HCV ELITE\_Be\_STD**.

I risultati dei controlli per PCR devono essere generati e approvati per ogni lotto di reagente per PCR.

- Per il controllo positivo, usare il prodotto **HCV - ELITE Positive Control**, fornito in dotazione con questo kit, con gli Assay Protocol **HCV ELITE\_PC** o **HCV ELITE\_Be\_PC**.
- Per il controllo negativo, usare acqua per biologia molecolare (non fornita in dotazione con questo kit) con gli Assay Protocol **HCV ELITE\_NC** o **HCV ELITE\_Be\_NC**.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Nota:** Gli strumenti **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius** consentono di generare e memorizzare la curva di calibrazione e la convalida dei controlli della PCR per ogni lotto di reagente per PCR. Le curve di calibrazione scadono dopo **60 giorni**; trascorso questo termine, è necessario ripetere la calibrazione. I risultati dei controlli per PCR scadono dopo **15 giorni**; trascorso questo termine, è necessario rianalizzare i controlli positivo e negativo.

I calibratori e i controlli per PCR devono essere rianalizzati ogni volta che si verifica uno degli eventi seguenti:

- si utilizza un nuovo lotto di reagenti;
- i risultati delle analisi di controllo della qualità (vedere paragrafo successivo) non rientrano nelle specifiche;
- lo strumento **ELITE InGenius** o **ELITE BeGenius** viene sottoposto a un importante intervento di manutenzione o assistenza.

### Controlli di qualità

Si raccomanda la verifica della procedura di estrazione e della PCR. Si possono utilizzare campioni archiviati o materiale di riferimento certificato. Quando disponibili, utilizzare i controlli esterni in conformità con le linee guida delle organizzazioni di accreditamento locali, statali e federali.

## PROCEDURA ELITE InGenius

La procedura per l'uso del prodotto **HCV ELITE MGB Kit** con lo strumento **ELITE InGenius** si articola in tre fasi:

<b>FASE 1</b>	Verifica che il sistema sia pronto	
<b>FASE 2</b>	Impostazione della sessione	A) Corsa dei campioni (Extract + PCR)
		B) Corsa dei campioni estratti (PCR Only)
		C) Corsa di Calibrazione (PCR Only)
		D) Corsa del Controllo Positivo e del Controllo Negativo (PCR Only)
<b>FASE 3</b>	Esame ed approvazione dei risultati	A) Validazione della curva di calibrazione
		B) Validazione dei risultati del Controllo Positivo e del Controllo Negativo
		C) Validazione dei risultati del campione
		D) Refertazione dei risultati del campione

### FASE 1 - Verifica che il sistema sia pronto

Prima di iniziare la sessione:

- accendere lo strumento **ELITE InGenius** e selezionare la modalità "**CLOSED**";
- nel menu "Calibration" nella home page, verificare che i calibratori (**HCV Q-PCR Standard**) siano approvati e validi (Status) per il lotto di **HCV PCR Mix** da utilizzare. Se non ci sono calibratori validi disponibili per il lotto di **HCV PCR Mix**, eseguire la calibrazione come descritto nelle sezioni seguenti;
- nel menu "Controls" nella home page, verificare che i controlli per PCR (**HCV Positive Control**, **HCV Negative Control**) siano approvati e validi (Status) per il lotto di **HCV PCR Mix** da utilizzare. Se non ci sono controlli per PCR validi disponibili per il lotto di **HCV PCR Mix**, eseguire i controlli per PCR come descritto nelle sezioni seguenti;
- scegliere il tipo di sessione analitica, seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente grafica (GUI) per l'allestimento della sessione e utilizzando gli Assay Protocol forniti da EG SpA (vedere "Campioni e controlli").

Se l'Assay Protocol d'interesse non è presente nel sistema, rivolgersi al Servizio Clienti ELITechGroup competente per il proprio paese/la propria area geografica.

### FASE 2 - Impostazione della sessione

Il prodotto **HCV ELITE MGB Kit** può essere utilizzato su **ELITE InGenius** per eseguire:

## **HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

- A. Corsa dei campioni (Extract + PCR)
- B. Corsa dei campioni estratti (PCR Only)
- C. Corsa di calibrazione (PCR Only)
- D. Corsa del Controllo Positivo e del Controllo Negativo (PCR Only)

Tutti i parametri necessari per la sessione sono inclusi negli Assay Protocol disponibili sullo strumento e vengono richiamati automaticamente nel momento in cui li si seleziona.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Nota:** Lo strumento **ELITE InGenius** può essere collegato al "Laboratory Information System" (LIS) tramite il quale è possibile scaricare i dati della sessione di lavoro. Consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per maggiori dettagli.

Prima di impostare una sessione:

1. Scongela le provette di **HCV PCR Mix** necessarie a temperatura ambiente per 30 minuti. Ogni provetta contiene un volume sufficiente per **24 test** in condizioni ottimali (5 o più test per sessione). Mescolare con vortex a bassa velocità la provetta per 10 secondi ripetendo l'operazione per tre volte, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.

**Nota:** Proteggere la miscela **PCR Mix** dalla luce durante lo scongelamento perché questo reagente è fotosensibile.

2. Prelevare le provette di **RT EnzymeMix** necessarie. Ogni provetta contiene un volume sufficiente per **48 test** in condizioni ottimali (5 o più test per sessione). Agitare delicatamente la provetta, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.

**Nota:** Non esporre il prodotto **RT EnzymeMix** a temperature superiori a -20 °C per più di 10 minuti.

3. Preparare una provetta da 2 mL (Sarstedt rif. 72.694.005, non fornita in dotazione con il kit) per la **miscela di reazione completa** ed etichettarla utilizzando un pennarello indelebile.
4. Calcolare i volumi necessari di **HCV PCR Mix** e **RT EnzymeMix** per preparare la **miscela di reazione completa** in funzione del numero di campioni (N) da analizzare, come descritto nella tabella sottostante.

Numero di campioni (N)	HCV PCR Mix	RT EnzymeMix
$1 \leq N \leq 5$	$(N + 1) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 1) \times 0,3 \mu\text{L}$
$6 \leq N \leq 11$	$(N + 2) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 2) \times 0,3 \mu\text{L}$
$N = 12$	290 $\mu\text{L}$	4,4 $\mu\text{L}$

5. Preparare la **miscela di reazione completa** trasferendo nella provetta da 2 mL etichettata i volumi calcolati dei due componenti. Mescolare con vortex a bassa velocità la provetta per 10 secondi ripetendo l'operazione per tre volte, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.

**Nota:** La **miscela di reazione completa** può essere utilizzata entro **7 ore** se mantenuta in blocco freddo (per 2 sessioni di 3 ore ciascuna e per il tempo necessario per iniziare la terza sessione). La miscela di reazione completa **non** può essere conservata per essere riutilizzata.

**Nota:** La **miscela di reazione completa** è fotosensibile per cui non esporla alla luce diretta.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

Per impostare uno dei quattro tipi di sessione, procedere come segue facendo riferimento alle istruzioni visualizzate sulla GUI:

	<b>A. Corsa dei campioni (Extract + PCR)</b>	<b>B. Corsa dei campioni estratti (PCR Only)</b>
1	<p><b>Identificare i campioni</b> e, ne necessario, scongelare a temperatura ambiente, agitare delicatamente, centrifugare per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenere su ghiaccio o su blocco freddo.</p> <p>Per questo test trasferire 600 µL di campione in un Extraction tube precedentemente etichettato. ELITE InGenius lascerà il volume eccedente nella provetta di estrazione.</p> <p><b>Scongelare le provette di CPE</b> necessarie a temperatura ambiente per 30 minuti. Agitare delicatamente le provette, centrifugarle per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerle su ghiaccio o su blocco freddo.</p>	<p><b>Scongelare</b> a temperatura ambiente la <b>provetta di eluizione</b> contenente gli acidi nucleici estratti. Agitare delicatamente la provetta, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.</p>
2	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".
3	Verificare che "Extraction Input Volume" sia 1000 µL e che "Extracted Elute Volume" sia 50 µL.	Verificare che "Extraction Input Volume" sia 1000 µL e che "Extracted Elute Volume" sia 50 µL.
4	Per ogni campione, assegnare un "Track" e compilare il "SampleID" (SID) digitando o scansionando il codice a barre.	Per ogni campione, assegnare un "Track" e compilare il "SampleID" (SID) digitando o scansionando il codice a barre.
5	Nella colonna "Assay" selezionare l' <b>Assay Protocol</b> da utilizzare (vedere "Campioni e controlli").	Nella colonna "Assay" selezionare l' <b>Assay Protocol</b> da utilizzare (vedere "Campioni e controlli").
6	Verificare che il protocollo visualizzato sia: "Extract + PCR".	Nella colonna "Protocol" (protocollo) selezionare "PCR Only".
7	Nella colonna "Sample Position" selezionare "Extraction tube" come posizione da cui caricare il campione. Verificare che " <b>Dilution factor</b> " sia " <b>1.7</b> ".	Verificare che la posizione da cui caricare il campione riportata nella colonna "Sample Position" sia "Elution Tube (bottom row)". Verificare che " <b>Dilution factor</b> " sia " <b>1.7</b> ".
8	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
9	<b>Caricare il CPE e la miscela di reazione completa</b> nell'"Inventory Block" facendo riferimento alla "Load List" e inserire il numero di lotto di CPE e PCR Mix, la data di scadenza e il numero di reazione per ogni provetta.	<b>Caricare la miscela di reazione completa</b> nell'"Inventory Block" (area reagenti) facendo riferimento alla "Load List" e inserire il numero di lotto della PCR Mix, la data di scadenza e il numero di reazione per ogni provetta.
10	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
11	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" e sostituire i rack dei puntali se necessario.	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" e sostituire i rack dei puntali se necessario.
12	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
13	<b>Caricare</b> la PCR Cassette, le cartucce per estrazione ELITE InGenius SP 1000 e tutti i materiali di consumo richiesti e i campioni da estrarre.	<b>Caricare</b> la PCR Cassette e la provetta di eluizione con i campioni estratti.
14	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
15	Chiudere lo sportello dello strumento.	Chiudere lo sportello dello strumento.
16	Premere "Start".	Premere "Start".

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

	<b>C. Corsa di Calibrazione (PCR Only)</b>	<b>D. Sessione con il controllo positivo e il controllo negativo (Solo PCR)</b>
1	<b>Scongelare le provette di Q-PCR Standard</b> necessarie (Cal1: Q-PCR Standard 10 <sup>2</sup> , Cal2: Q-PCR Standard 10 <sup>3</sup> , Cal3: Q-PCR Standard 10 <sup>4</sup> , Cal4: Q-PCR Standard 10 <sup>5</sup> ) a temperatura ambiente per 30 minuti. Agitare delicatamente la provetta, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.	<b>Scongelare le provette di controllo positivo</b> a temperatura ambiente per 30 minuti. Agitare delicatamente la provetta, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo. <b>Preparare il controllo negativo</b> trasferendo almeno 50 µL di acqua per biologia molecolare in una provetta di eluizione, fornita in dotazione con l'ELITE InGenius SP 1000 Consumable Set.
2	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".
3	Verificare che "Extraction Input Volume" sia 1000 µL e che "Extracted Elute Volume" sia 50 µL.	Verificare che "Extraction Input Volume" sia 1000 µL e che "Extracted Elute Volume" sia 50 µL.
4	Per il Q-PCR Standard, assegnare il "Track", <b>selezionare l'Assay Protocol</b> (vedere "Campioni e controlli") nella colonna "Assay" e inserire il numero di lotto reagente e la data di scadenza.	Nella colonna "Assay" selezionare <b>l'Assay Protocol</b> da utilizzare (vedere "Campioni e controlli"). Inserire il numero di lotto e la data di scadenza del controllo positivo e dell'acqua per biologia molecolare.
5	Verificare che nella colonna "Protocol" (Protocollo) sia selezionato "PCR Only".	Verificare che nella colonna "Protocol" (Protocollo) sia selezionato "PCR Only".
6	Verificare che la posizione da cui caricare il campione riportata nella colonna "Sample Position" sia "Elution Tube (bottom row)".	Verificare che la posizione da cui caricare il campione riportata nella colonna "Sample Position" sia "Elution Tube (bottom row)".
7	<b>Caricare la miscela di reazione completa</b> nell'"Inventory Block" facendo riferimento alla "Load List" e inserire il numero di lotto della PCR Mix, la data di scadenza e il numero di reazione per ogni provetta.	<b>Caricare la miscela di reazione completa</b> nell'"Inventory Block" facendo riferimento alla "Load List" e inserire il numero di lotto della PCR Mix, la data di scadenza e il numero di reazione per ogni provetta.
8	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
9	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" e sostituire i rack dei puntali se necessario.	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" e sostituire i rack dei puntali se necessario.
10	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
11	Caricare la PCR Cassette e le provette di Q-PCR Standard.	Caricare la PCR Cassette, il controllo positivo e il controllo negativo.
12	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
13	Chiudere lo sportello dello strumento.	Chiudere lo sportello dello strumento.
14	Premere "Start".	Premere "Start".

Una volta completata la sessione, **ELITE InGenius** consente all'operatore di visualizzare, approvare, salvare i risultati, stampare e salvare il report.

**Nota:** Alla fine della sessione, rimuovere dallo strumento il campione estratto residuo presente nella **provetta di eluizione**, tapparlo, identificarlo e conservarlo a -20 °C per non più di un mese. Evitare la fuoriuscita del campione estratto.

**Nota:** La **miscela di reazione completa** può essere conservata a bordo nel blocco freddo per un massimo di 7 ore (per 2 sessioni di 3 ore ciascuna e per il tempo necessario per iniziare una terza sessione). Mescolare delicatamente le provette e centrifugarle per 5 secondi prima di iniziare una nuova sessione. La miscela di reazione completa **non** può essere conservata per essere riutilizzata.

**Nota:** Alla fine della sessione, rimuovere dallo strumento il **Q - PCR Standard** residuo, tapparlo e conservarlo a -20° C o a temperatura inferiore. Evitare la fuoriuscita del **Q - PCR Standard**.

**Nota:** Alla fine della sessione, rimuovere dallo strumento il **controllo positivo** residuo, tapparlo e conservarlo a -20° C o a temperatura inferiore. Evitare la fuoriuscita del controllo positivo. Smaltire il controllo negativo residuo.

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

**Nota:** Alla fine della sessione, smaltire la **PCR Cassette** e gli altri materiali di consumo secondo le disposizioni legali e ambientali vigenti. Evitare di provocare la fuoriuscita dei prodotti di reazione.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

### FASE 3 - Esame ed approvazione dei risultati

Lo strumento **ELITE InGenius** monitora i segnali di fluorescenza del target e del controllo interno per ciascuna reazione e applica automaticamente i parametri del Protocol Assay per generare le curve della PCR che vengono poi interpretate ed espresse nei risultati.

Al termine della sessione, viene visualizzata automaticamente la schermata "Results Display". In questa schermata, sono mostrati i risultati e i dati relativi alla sessione analitica. Da questa schermata è possibile approvare i risultati, stampare o salvare i report ("Sample Report" o "Track Report"). Consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per maggiori dettagli.

**Nota:** Lo strumento **ELITE InGenius** può essere collegato al "Laboratory Information System" (LIS) che consente di caricare i risultati della sessione nel centro elaborazione dati del laboratorio. Consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per maggiori dettagli.

**ELITE InGenius** utilizza il prodotto **HCV ELITE MGB Kit** per generare risultati tramite la seguente procedura:

- A. Validazione della curva di calibrazione
- B. Validazione dei risultati del Controllo Positivo e del Controllo Negativo
- C. Validazione dei risultati del campione
- D. Refertazione dei risultati del campione

#### A. Validazione della curva di calibrazione

L'**ELITE InGenius software** interpreta i risultati della PCR per il target del calibratore con i parametri dell'Assay Protocol **HCV ELITE\_STD**. Il rapporto tra il Ct risultante e la concentrazione genera la curva di calibrazione.

Le curve di calibrazione, specifiche per il lotto di reagente per PCR, vengono registrate nel database ("Calibration") e possono essere consultati e approvati da personale avente la qualifica di "Administrator" o "Analyst", seguendo le istruzioni visualizzate sulla GUI.

La curva di calibrazione scade **dopo 60 giorni**.

**Nota:** se la curva di calibrazione non soddisfa i criteri di accettazione, sulla schermata "Calibration" appare il messaggio "Failed". In questo caso, i risultati non possono essere approvati e si devono ripetere le reazioni di amplificazione del calibratore. Inoltre, se inclusi nella sessione, i campioni non vengono quantificati e devono essere ripetuti per generare risultati quantitativi.

#### B. Validazione dei risultati dell'amplificazione per il controllo positivo e il controllo negativo

L'**ELITE InGenius software** interpreta i risultati della PCR per il target delle reazioni del controllo positivo e del controllo negativo con i parametri degli Assay Protocol **HCV ELITE\_PC** e **HCV ELITE\_NC**. I valori di Ct risultanti sono convertiti in concentrazione e devono essere usati per verificare il sistema (lotto di reagenti e strumento).

I risultati del controllo positivo e del controllo negativo, specifici per il lotto dei reagenti per PCR, sono memorizzati nel database (Controls) e possono essere consultati e approvati da personale avente la qualifica di "Administrator" o "Analyst", seguendo le istruzioni visualizzate sulla GUI.

I risultati dei controlli positivo e negativo scadono **dopo 15 giorni**.

L'**ELITE InGenius software** elabora i risultati del controllo positivo e del controllo negativo e genera i grafici dei controlli. Per impostare il grafico dei controlli iniziali si utilizzano quattro risultati approvati del controllo positivo e del controllo negativo. Per i controlli successivi, il software analizza i risultati al fine di assicurare che le prestazioni del sistema rientrino nei criteri di accettazione, mostrati nei tracciati dei grafici dei controlli. Consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per maggiori dettagli.

**Nota:** Se il risultato del controllo positivo o del controllo negativo non soddisfa i criteri di accettazione, sulla schermata "Controls" (Controlli) appare il messaggio "Failed" (Fallito). In tal caso, i risultati non possono essere approvati e si devono ripetere le sessioni del controllo positivo e del controllo negativo.

**Nota:** Se il risultato del controllo positivo e del controllo negativo non è valido e i campioni erano inclusi nella medesima sessione, i campioni possono essere approvati ma i loro risultati non sono validati. In tal caso, il(i) controllo(i) fallito(i) e i campioni devono essere ripetuti.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

### C. Validazione dei risultati del campione

Il programma **ELITE InGenius software** interpreta i risultati della PCR per il target (Canale **HCV**) e per il controllo interno (Canale **IC**) con i parametri degli Assay Protocol “**HCV ELITE\_PL\_600\_50**” e “**HCV ELITE\_Se\_600\_50**”. I valori di Ct risultanti vengono convertiti in concentrazione.

I risultati sono mostrati sulla schermata “Results Display”.

I risultati del campione possono essere approvati quando sono vere le tre condizioni riportate nella tabella sottostante.

<b>1) Curva di calibrazione</b>	<b>Stato</b>
HCV Q-PCR Standard	APPROVATO
<b>2) Controllo positivo</b>	<b>Stato</b>
HCV Positive Control	APPROVATO
<b>3) Controllo negativo</b>	<b>Stato</b>
HCV Negative Control	APPROVATO

I risultati del campione sono interpretati automaticamente dal **ELITE InGenius software** usando i parametri dell'Assay Protocol. La tabella sottostante riporta i possibili messaggi relativi al risultato ottenuto.

Per ogni campione il sistema indica una combinazione dei seguenti messaggi specificando se l'RNA del patogeno è stato rilevato.

<b>Risultato di una sessione sul campione</b>	<b>Interpretazione</b>
HIV1:RNA Rilevato, quantità pari a “XXX” copie/mL o IU/mL	L' <b>HCV RNA è stato rilevato</b> nel campione nell'intervallo di misurazione del saggio, nella concentrazione indicata.
HCV:RNA Rilevato, quantità inferiore a “LLoQ” copie/mL o IU/mL	L' <b>HCV RNA è stato rilevato</b> nel campione, al di sotto del limite inferiore di quantificazione (LLoQ) del saggio.
HCV:RNA Rilevato, quantità oltre a “ULoQ” copie/mL o IU/mL	L' <b>HCV RNA è stato rilevato</b> nel campione, oltre il limite superiore di quantificazione (ULoQ) del saggio.
HCV:RNA Non rilevato o inferiore a “LoD” copie/mL o IU/mL	L' <b>HCV RNA non è stato rilevato</b> nel campione. Il campione è negativo per l'RNA target oppure la sua concentrazione è inferiore al limite di rilevazione (LoD) del saggio.
Non valido - Ripetere test campione	<b>Risultato del saggio non valido</b> per un errore del controllo interno (dovuto ad es. a errata estrazione o effetto carryover degli inibitori). Il test deve essere ripetuto.

Campioni segnalati come “Non valido - Ripetere test campione”: in questo caso, l'RNA del controllo interno non è stato rilevato in maniera efficace, probabilmente per problemi nella fase di campionamento, estrazione, trascrizione inversa o PCR (ad es. campionamento sbagliato, degradazione o perdita di RNA durante l'estrazione o presenza di inibitori nell'eluato), che possono essere all'origine di risultati errati.

Quando il volume è sufficiente, l'eluato può essere ritestato (tal quale oppure diluito) mediante una sessione di amplificazione in modalità “PCR Only”. In caso di un secondo risultato non valido, il campione deve essere ritestato partendo dall'estrazione di un nuovo campione in modalità “Extract + PCR” (vedere “Risoluzione dei problemi”).

I campioni segnalati come “HCV:RNA Non rilevato o inferiore a “LoD” copie/mL o IU/mL” sono idonei per l'analisi, ma non è stato possibile rilevare l'RNA di HCV. In questo caso, il campione può essere negativo per l'RNA di HCV oppure

l'RNA di HCV è presente ad una concentrazione inferiore al limite di rilevazione del saggio (vedere “Caratteristiche delle prestazioni”).

I campioni positivi per l'RNA di HCV ad una concentrazione inferiore al limite di rilevazione (e al limite di quantificazione inferiore) del saggio, se rilevati, sono identificati nel report come “HCV:RNA Rilevato, quantità inferiore a “LLoQ” copie/mL o IU/mL” (vedere “Caratteristiche delle prestazioni”).

I campioni positivi per l'RNA di HCV all'interno dell'intervallo di misurazione lineare (vedere “Caratteristiche delle prestazioni”) sono rilevati e segnalati come “HCV:RNA Rilevato, quantità pari a “XXX” copie/mL o IU/mL”.

I campioni positivi per l'RNA di HCV in quantità maggiore del limite superiore di quantificazione sono segnalati come “HCV:RNA Rilevato, quantità oltre a “ULoQ” copie/mL o IU/mL” e non sono idonei per la quantificazione. Se necessario, il campione può essere diluito prima dell'estrazione o della PCR e ritestato per ottenere risultati all'interno dell'intervallo di misurazione lineare del saggio.

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

**Nota:** I risultati ottenuti con questo saggio devono essere interpretati tenendo conto di tutti i dati clinici e degli altri esiti di laboratorio.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

I risultati del campione sono memorizzati nel database e, se validi, possono essere approvati (Results Display) da personale avente la qualifica di "Administrator" o "Analyst", seguendo le istruzioni visualizzate sulla GUI. Dalla finestra "Results Display" è possibile stampare e salvare i risultati della sessione analitica sotto forma di "Sample Report" e "Track Report".

### D. Refertazione dei risultati del campione

I risultati del campione sono memorizzati nel database e possono essere esportati sotto forma di "Sample Report" e "Track Report".

Il "Sample Report" mostra i dettagli dei risultati per campione selezionato (SID).

Il "Track Report" mostra i dettagli dei risultati per track selezionato.

Entrambi i rapporti possono essere stampati e firmati da personale autorizzato.

## PROCEDURA ELITE BeGenius

La procedura per l'uso del prodotto **HCV ELITE MGB Kit** con lo strumento **ELITE BeGenius** si articola in tre fasi:

FASE 1	Verifica che il sistema sia pronto	
FASE 2	Impostazione della sessione	A) Corsa dei campioni (Extract + PCR)
		B) Corsa dei campioni estratti (PCR Only)
		C) Corsa di Calibrazione (PCR Only)
		D) Corsa del Controllo Positivo e del Controllo Negativo (PCR Only)
FASE 3	Esame ed approvazione dei risultati	A) Validazione della curva di calibrazione
		B) Validazione dei risultati del Controllo Positivo e del Controllo Negativo
		C) Validazione dei risultati del campione
		D) Refertazione dei risultati del campione

### FASE 1 - Verifica che il sistema sia pronto

Prima di iniziare la sessione:

- accendere lo strumento **ELITE BeGenius** e selezionare la modalità "**CLOSED**";
- nel menu "Calibrations" nella home page, verificare che i calibratori (**HCV Q-PCR Standard**) siano approvati e validi (Status) per il lotto di **HCV PCR Mix** da utilizzare. Se non ci sono calibratori validi disponibili per il lotto di **HCV PCR Mix**, eseguire la calibrazione come descritto nelle sezioni seguenti;

nel menu "Controls" nella home page, verificare che i controlli per PCR (**HCV Positive Control**, **HCV Negative Control**) siano approvati e validi (Status) per il lotto di **HCV PCR Mix** da utilizzare. Se non ci sono controlli per PCR validi disponibili per il lotto di **HCV PCR Mix**, eseguire i controlli per PCR come descritto nelle sezioni seguenti;

- scegliere il tipo di sessione analitica, seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente grafica (GUI) per l'allestimento della sessione e utilizzando gli Assay Protocol forniti da EG SpA (vedere "Campioni e controlli").

Se l'Assay Protocol d'interesse non è presente nel sistema, rivolgersi al Servizio Clienti ELITechGroup competente per il proprio paese/la propria area geografica.

### STEP 2 - Impostazione della sessione

Il prodotto **HCV ELITE MGB Kit** può essere utilizzato su **ELITE BeGenius** per eseguire:

- A. Corsa dei campioni (Extract + PCR)
- B. Corsa dei campioni estratti (PCR Only)
- C. Corsa di calibrazione (PCR Only)
- D. Corsa del Controllo Positivo e del Controllo Negativo (PCR Only)

Tutti i parametri necessari per la sessione sono inclusi nell'Assay Protocol disponibile sullo strumento e vengono richiamati automaticamente nel momento in cui li si seleziona.

## HCV ELITe MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

**Nota:** Lo strumento **ELITe BeGenius** può essere collegato al “Laboratory Information System” (LIS) tramite il quale è possibile scaricare i dati della sessione di lavoro. Consultare il manuale d’istruzioni dello strumento per maggiori dettagli.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

Prima di impostare una sessione:

1. Scongela le provette di **HCV PCR Mix** necessarie a temperatura ambiente per 30 minuti. Ogni provetta contiene un volume sufficiente per **24 test** in condizioni ottimali (5 o più test per sessione). Mescolare con vortex a bassa velocità la provetta per 10 secondi ripetendo l'operazione per tre volte, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.

**Nota:** Proteggere la miscela **PCR Mix** dalla luce durante lo scongelamento perché questo reagente è fotosensibile.

2. Prelevare le provette di **RT EnzymeMix** necessarie. Ogni provetta contiene un volume sufficiente per **48 test** in condizioni ottimali (5 o più test per sessione). Agitare delicatamente la provetta, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.

**Nota:** Non esporre il prodotto **RT EnzymeMix** a temperature superiori a -20 °C per più di 10 minuti.

3. Preparare una provetta da 2 mL (Sarstedt rif. 72.694.005, non fornita in dotazione con il kit) per la **miscela di reazione completa** ed etichettarla utilizzando un pennarello indelebile.
4. Calcolare i volumi necessari di **HCV PCR Mix** e **RT EnzymeMix** per preparare la **miscela di reazione completa** in funzione del numero di campioni (N) da analizzare, come descritto nella tabella sottostante.

Numero di campioni (N)	HCV PCR Mix	RT EnzymeMix
$1 \leq N \leq 5$	$(N + 1) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 1) \times 0,3 \mu\text{L}$
$6 \leq N \leq 11$	$(N + 2) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 2) \times 0,3 \mu\text{L}$
N = 12	290 $\mu\text{L}$	4,4 $\mu\text{L}$
$13 \leq N \leq 18$	$(N + 3) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 3) \times 0,3 \mu\text{L}$
$19 \leq N \leq 23$	$(N + 4) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 4) \times 0,3 \mu\text{L}$
N = 24	580 $\mu\text{L}$	8,7 $\mu\text{L}$

5. Preparare la **miscela di reazione completa** trasferendo nella provetta da 2 mL etichettata i volumi calcolati dei due componenti. Mescolare con vortex a bassa velocità la provetta per 10 secondi ripetendo l'operazione per tre volte, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.

**Nota:** La **miscela di reazione completa** può essere utilizzata entro **7 ore** se mantenuta in blocco freddo (per 2 sessioni di 3 ore ciascuna e per il tempo necessario per iniziare la terza sessione). La miscela di reazione completa **non** può essere conservata per essere riutilizzata.

**Nota:** La **miscela di reazione completa** è fotosensibile per cui non esporla alla luce diretta.

Per impostare uno dei quattro tipi di sessione, procedere come segue facendo riferimento alle istruzioni visualizzate sulla GUI:

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

	A. Corsa dei campioni (Extract + PCR)	B. Corsa dei campioni estratti (PCR Only)
1	<b>Identificare i campioni</b> e, ne necessario, scongelare a temperatura ambiente, agitare delicatamente, centrifugare per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenere su ghiaccio o su blocco freddo. Per questo test trasferire 600 µL di campione in una provetta Sarstedt da 2 mL (non fornita) precedentemente etichettata. ELITE BeGenius lascerà il volume eccedente nella provetta Sarstedt da 2 mL. <b>Scongela</b> le <b>provette di CPE</b> necessarie a temperatura ambiente per 30 minuti. Agitare delicatamente le provette, centrifugarle per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerle su ghiaccio o su blocco freddo.	Se necessario, <b>scongela</b> a temperatura ambiente la <b>provetta di eluizione</b> contenente gli acidi nucleici estratti. Agitare delicatamente la provetta, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo.
2	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".
3	Rimuovere tutti i Rack dalla "Cooler Unit" e posizionarli sul tavolo di preparazione.	Rimuovere i "Rack" dalle "Lane 1, 2 e 3" (L1, L2, L3) della "Cooler Unit" e posizionarli sul tavolo di preparazione.
4	Selezionare il "run mode": "Extract + PCR".	Selezionare il "run mode": "PCR Only".
5	<b>Caricare i campioni</b> nel "Sample Rack". ( <b>Nota:</b> quando si caricano tubi secondari "2 mL Tubes", utilizzare gli adattatori blu per il "Sample Rack").	Caricare i campioni nell'"Elution Rack".
6	<b>Inserire il "Sample Rack"</b> nella "Cooler Unit" a partire dalla "Lane 5" (L5). Inserire il "Sample ID" (SID) per ogni "Position" utilizzata. (Se si caricano tubi secondari, contrassegnare "2 mL Tube". Se i tubi secondari non hanno codice a barre, digitare manualmente il "Sample ID").	Inserire l'"Elution Rack" nella "Cooler Unit" a partire dalla "Lane 3" (L3). Per ogni "Position" inserire il "Sample ID", la "Sample matrix", l'"Extraction kit" e l'"Extracted eluate vol." (volume eluato).
7	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
8	Verificare che "Extraction Input Volume" sia 600 µL e che "Extracted Elute Volume" sia 50 µL.	Verificare che "Extraction Input Volume" sia 600 µL e che "Extracted Elute Volume" sia 50 µL.
9	Nella colonna "Assay" selezionare l' <b>Assay Protocol</b> da utilizzare (vedere "Campioni e controlli").	Nella colonna "Assay" selezionare l' <b>Assay Protocol</b> da utilizzare (vedere "Campioni e controlli").
10	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
11	Quando si processano più di 12 campioni, ripetere la procedura dal punto 6.	Quando si processano più di 12 campioni, ripetere la procedura dal punto 6.
12	<b>Caricare</b> le <b>"Elution tubes"</b> nell'"Elution Rack" (le provette di eluizione possono essere etichettate con il codice a barre per migliorarne la tracciabilità).	Non applicabile.
13	Inserire l'"Elution Rack" nella "Cooler Unit" a partire dalla "Lane 3" (L3). Quando si processano più di 12 campioni, ripetere la procedura utilizzando la "Lane 2" (L2).	Non applicabile.
15	Fare clic su "Next" per proseguire.	Non applicabile.
16	<b>Caricare il CPE e la miscela di reazione completa</b> nel "Reagent/Elution Rack".	<b>Caricare la miscela di reazione completa</b> nel "Reagent/Elution Rack".
17	Inserire il "Reagent/Elution Rack" nella "Cooler Unit" nella "Lane 2" (L2) se disponibile o nella "Lane 1" (L1). Per ogni PCR Mix e/o CPE, inserire "S/N" (numero di serie), "Lot No." (numero di lotto), "Exp. Date" (data di scadenza) e "T/R" (numero di reazioni).	Inserire il "Reagent/Elution Rack" nella "Cooler Unit" nella "Lane 2" (L2) se disponibile o nella "Lane 1" (L1). Per ogni PCR Mix, inserire "S/N" (numero di serie), "Lot No." (numero di lotto), "Exp. Date" (data di scadenza) e "T/R" (numero di reazioni).
18	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
19	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" e sostituire i rack se necessario.	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" e sostituire i rack se necessario.
20	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
21	<b>Caricare il "PCR Rack"</b> con la <b>"PCR Cassette"</b> nell'"Inventory Area".	<b>Caricare il "PCR Rack"</b> con la <b>"PCR Cassette"</b> nell'"Inventory Area".
22	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
23	<b>Caricare l'"Extraction Rack"</b> con le cartucce di estrazione "ELITE InGenius SP 1000" e i materiali di consumo per l'estrazione richiesti.	Non applicabile.
24	Chiudere lo sportello dello strumento.	Chiudere lo sportello dello strumento.
25	Premere "Start".	Premere "Start".

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

	<b>C. Corsa di Calibrazione (PCR Only)</b>	<b>D. Sessione con il controllo positivo e il controllo negativo (Solo PCR)</b>
1	<b>Scongelare le provette di Q-PCR Standard</b> necessarie (Cal1: Q-PCR Standard 10 <sup>2</sup> , Cal2: Q-PCR Standard 10 <sup>3</sup> , Cal3: Q-PCR Standard 10 <sup>4</sup> , Cal4: Q-PCR Standard 10 <sup>5</sup> ) per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare delicatamente le provette, centrifugarle per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerle su ghiaccio o su blocco freddo.	<b>Scongelare le provette di controllo positivo</b> a temperatura ambiente per 30 minuti. Agitare delicatamente la provetta, centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo e mantenerla su ghiaccio o su blocco freddo. <b>Preparare il controllo negativo</b> trasferendo almeno 50 µL di acqua per biologia molecolare in una provetta di eluizione, fornita in dotazione con l'ELITE InGenius SP 1000 Consumable Set.
2	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".	Nella schermata Home, selezionare "Perform Run".
3	Rimuovere i "Rack" dalle "Lane 1, 2 e 3" (L1, L2, L3) della "Cooler Unit" e posizzionarli sul tavolo di preparazione.	Rimuovere i "Rack" dalle "Lane 1, 2 e 3" (L1, L2, L3) della "Cooler Unit" e posizzionarli sul tavolo di preparazione.
4	Selezionare il "run mode": PCR Only".	Selezionare il "run mode": "PCR Only".
5	<b>Caricare le provette di Q-PCR Standard</b> nell'"Elution Rack".	<b>Caricare le provette di controllo positivo e controllo negativo</b> nell'"Elution Rack".
6	<b>Inserire l'"Elution Rack"</b> nella "Cooler Unit" a partire dalla "Lane 3" (L3). Se necessario, per ogni "Position" inserire "Reagent name" e "S/N" (numero di serie), "Lot No." (numero di lotto), "Exp. Date" (data di scadenza) e "T/R" (numero di reazioni).	<b>Inserire l'"Elution Rack"</b> nella "Cooler Unit" a partire dalla "Lane 3" (L3). Se necessario, per ogni "Position" inserire "Reagent name" e "S/N" (numero di serie), "Lot No." (numero di lotto), "Exp. Date" (data di scadenza) e "T/R" (numero di reazioni).
7	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
8	Verificare l'"Extraction Input Volume" (600 µL) e l'"Extracted Elute Volume" (50 µL).	Verificare l'"Extraction Input Volume" (600 µL) e l'"Extracted Elute Volume" (50 µL).
9	Nella colonna "Assay" selezionare l' <b>Assay Protocol</b> da utilizzare (vedere "Campioni e controlli).	Nella colonna "Assay" selezionare l' <b>Assay Protocol</b> da utilizzare (vedere "Campioni e controlli).
10	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
11	<b>Caricare la miscela di reazione completa</b> nel "Reagent/Elution Rack".	<b>Caricare la miscela di reazione completa</b> nel "Reagent/Elution Rack".
12	<b>Inserire il "Reagent/Elution Rack"</b> nella "Cooler Unit" nella "Lane 2" (L2). Per ogni PCR Mix, inserire "S/N" (numero di serie), "Lot No." (numero di lotto), "Exp. Date" (data di scadenza) e "T/R" (numero di reazioni).	Inserire il "Reagent/Elution Rack" nella "Cooler Unit" a partire dalla "Lane 2" (L2). Per ogni PCR Mix, inserire "S/N" (numero di serie), "Lot No." (numero di lotto), "Exp. Date" (data di scadenza) e "T/R" (numero di reazioni).
13	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
14	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" (area reagenti) e sostituire i rack se necessario.	Controllare i puntali negli appositi "Tip Racks" dell'"Inventory Area" (area reagenti) e sostituire i rack se necessario.
15	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
16	<b>Caricare il "PCR Rack"</b> con la " <b>PCR Cassette</b> " nell'Inventory Area.	<b>Caricare il "PCR Rack"</b> con la " <b>PCR Cassette</b> " nell'Inventory Area.
17	Fare clic su "Next" per proseguire.	Fare clic su "Next" per proseguire.
18	Chiudere lo sportello dello strumento.	Chiudere lo sportello dello strumento.
19	Premere "Start".	Premere "Start".

Una volta completata la sessione, **ELITE BeGenius** consente all'operatore di visualizzare, approvare, salvare i risultati, stampare e salvare il report.

**Nota:** Alla fine della sessione, rimuovere dallo strumento il campione estratto residuo presente nella **provetta di eluizione**, tapparlo, identificarlo e conservarlo a -20 ± 10 °C per non più di un mese. Evitare di provocare la fuoriuscita del campione estratto.

**Nota:** La **miscela di reazione completa** può essere conservata a bordo nel blocco freddo per un massimo di 7 ore (per 2 sessioni di 3 ore ciascuna e per il tempo necessario per iniziare una terza sessione). Agitare delicatamente la provetta, quindi centrifugarla per 5 secondi per riportare il contenuto sul fondo prima di cominciare la successiva sessione. La miscela di reazione completa **non** può essere conservata per essere riutilizzata.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Nota:** Alla fine della sessione, rimuovere dallo strumento il **Q-PCR Standard** residuo, tapparlo e conservarlo a -20° C o a temperatura inferiore. Evitare la fuoriuscita del Q-PCR Standard.

**Nota:** Alla fine della sessione, rimuovere dallo strumento il **controllo positivo** residuo, tapparlo e conservarlo a -20° C o a temperatura inferiore. Evitare la fuoriuscita del controllo positivo. Smaltire il controllo negativo residuo.

**Nota:** Alla fine della sessione, smaltire la **PCR Cassette** e gli altri materiali di consumo secondo le disposizioni legali e ambientali vigenti. Evitare di provocare la fuoriuscita dei prodotti di reazione.

### FASE 3 - Esame ed approvazione dei risultati

Lo strumento **ELITE BeGenius** monitora i segnali di fluorescenza del target e del controllo interno per ciascuna reazione e applica automaticamente i parametri dell'Assay Protocol per generare le curve della PCR che vengono poi interpretate ed espresse nei risultati.

Al termine della sessione, viene visualizzata automaticamente la schermata "Results Display". In questa schermata, sono mostrati i risultati e i dati relativi alla sessione analitica. Da questa schermata è possibile approvare i risultati, stampare o salvare i report ("Sample Report" o "Track Report"). Consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per maggiori dettagli.

**Nota:** Lo strumento **ELITE BeGenius** può essere collegato al "Laboratory Information System" (LIS) che consente di caricare i risultati della sessione nel centro elaborazione dati del laboratorio. Consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per maggiori dettagli.

Lo strumento **ELITE BeGenius** utilizza il prodotto **HCV ELITE MGB Kit** per generare i risultati tramite la seguente procedura:

- A. Validazione della curva di calibrazione
- B. Validazione dei risultati del Controllo Positivo e del Controllo Negativo
- C. Validazione dei risultati del campione
- D. Refertazione dei risultati del campione

**Nota:** Per i dettagli, fare riferimento allo stesso paragrafo della **Procedura ELITE InGenius**.

## CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

### Limite di rilevazione (LoD)

Il limite di rilevazione (LoD) del saggio è stato determinato sullo strumento ELITE InGenius mediante analisi di un pannello di campioni di plasma negativo per HCV raccolto in ACD, positivizzato con un materiale di riferimento per HCV (6<sup>th</sup> WHO HCV International Standard, NIBSC). È stata eseguita l'analisi di regressione con modello Probit sui risultati ed è stato stimato il LoD come la concentrazione del campione che ha una probabilità del 95% di risultare positivo.

I risultati sono illustrati nelle tabelle seguenti.

Limite di rilevazione (IU/mL) per campioni di plasma in ACD ed ELITE InGenius			
Target	LoD	Intervallo di confidenza 95%	
		Limite inferiore	Limite superiore
HCV	26	19	48

Il LoD inteso come copie/mL per campioni di plasma in ACD è stato calcolato applicando lo specifico fattore di conversione indicato (2,4 IU/copie). Si riporta di seguito la sensibilità analitica espressa in copie/mL.

Limite di rilevazione (copie/mL) per campioni di plasma in ACD ed ELITE InGenius			
Target	LoD	Intervallo di confidenza 95%	
		Limite inferiore	Limite superiore
HCV	11	8	20

Il valore calcolato di LoD è stato verificato mediante analisi su ELITE InGenius e ELITE BeGenius di un pool di plasma in ACD, di un pool di plasma in EDTA e di un pool di siero positivizzati con materiale di riferimento certificato per HCV alla concentrazione dichiarata.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

I risultati ottenuti hanno confermato la concentrazione dichiarata per il target di HCV ELITE MGB Kit su entrambi gli strumenti ELITE InGenius e ELITE BeGenius.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Equivalenza delle matrici: Plasma con EDTA a confronto con plasma con ACD e siero**

L'equivalenza delle matrici di HCV ELITE MGB Kit è stata verificata utilizzando campioni appaiati (stesso donatore) di plasma in EDTA e in ACD, e di plasma in EDTA e di siero su ELITE InGenius.

Per 30 campioni testati negativi per HCV con un saggio immunoenzimatico CE IVD, è stata valutata la percentuale di concordanza negativa (NPA) e il coefficiente di variabilità (%CV) dei valori di Ct del controllo interno.

I risultati sono illustrati nelle tabelle seguenti.

Campione	N	Positivi	Negativi	NPA	%CV Ct IC	%CV totale Ct IC
Plasma in EDTA	30	0	30	100%	0,89	0,95
Plasma in ACD	30	0	30		1,02	

Campione	N	Positivi	Negativi	NPA	Ct di HCV %CV	%CV totale Ct HCV
Plasma in EDTA	30	30	0	100%	0,90	1,11
Siero	30	30	0		1,28	

Per 30 campioni positivizzati con materiale di riferimento certificato (6<sup>th</sup> WHO HCV International Standard, NIBSC) è stata valutata la percentuale di concordanza positiva (PPA) e il coefficiente di variabilità (%CV) dei valori di Ct di HCV.

I risultati sono illustrati nelle tabelle seguenti.

Campione	N	Positivi	Negativi	PPA	Ct di HCV %CV	%CV totale Ct HCV
Plasma in EDTA	30	30	0	100%	1,96	1,79
Plasma in ACD	30	30	0		1,60	

Campione	N	Positivi	Negativi	PPA	Ct di HCV %CV	%CV totale Ct HCV
Plasma in EDTA	30	30	0	100%	1,84	1,81
Siero	30	30	0		1,77	


In queste analisi, i 30 campioni appaiati di plasma in EDTA e di plasma in ACD e i 30 campioni appaiati di plasma in EDTA e di siero hanno evidenziato prestazioni equivalenti quando analizzati con il prodotto HCV ELITE MGB® Kit in associazione con ELITE InGenius.

Ulteriori analisi sull'equivalenza delle matrici sono state eseguite nell'ambito dello studio riguardante l'intervallo di misurazione lineare riportato nella sezione seguente.

**Intervallo di misurazione lineare**

L'intervallo di misurazione lineare del saggio è stato determinato in associazione a campioni di plasma su ELITE InGenius ed ELITE BeGenius utilizzando un pannello di diluizioni del materiale di riferimento di HCV (AcroMetrix) in campioni negativi di plasma in EDTA.

I risultati sono illustrati nelle figure seguenti.

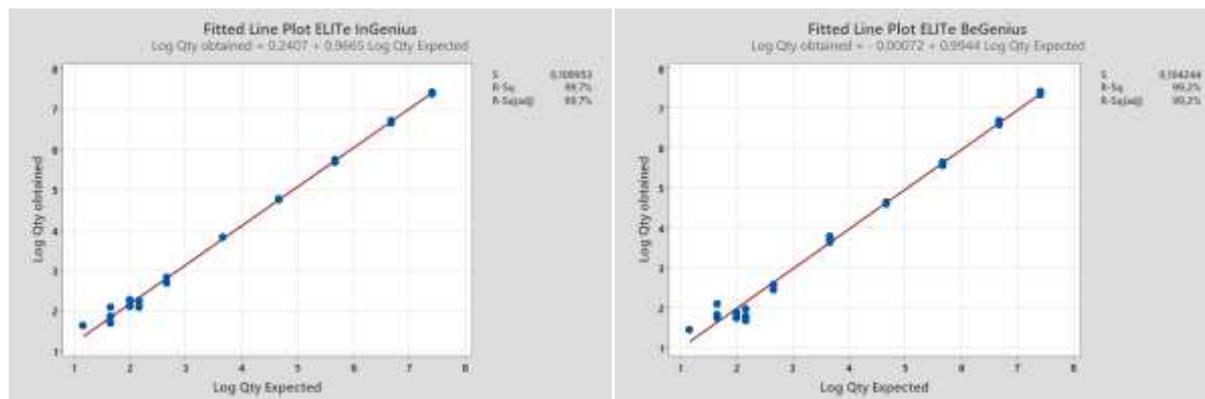

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

L'intervallo di misurazione lineare in copie/mL per campioni di plasma in EDTA è stato calcolato applicando lo specifico fattore di conversione riportato nella sezione seguente.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR


REF RTK601ING

I risultati finali sono illustrati nella tabella seguente.

Intervallo di misurazione lineare per HCV ELITE MGB Kit ed ELITE InGenius e ELITE BeGenius	
Limite inferiore	Limite superiore
26 IU/mL	25.000.001 IU/mL
11 copie/ml	10.416.667 copie/ml

Per i genotipi principali di HCV (1, 2, 3, 4, 5, 6), la linearità di quantificazione è stata verificata mediante analisi di campioni negativi di plasma in EDTA positivamente con materiale di riferimento per HCV (SeraCare).


I risultati sono illustrati nella figura seguente.

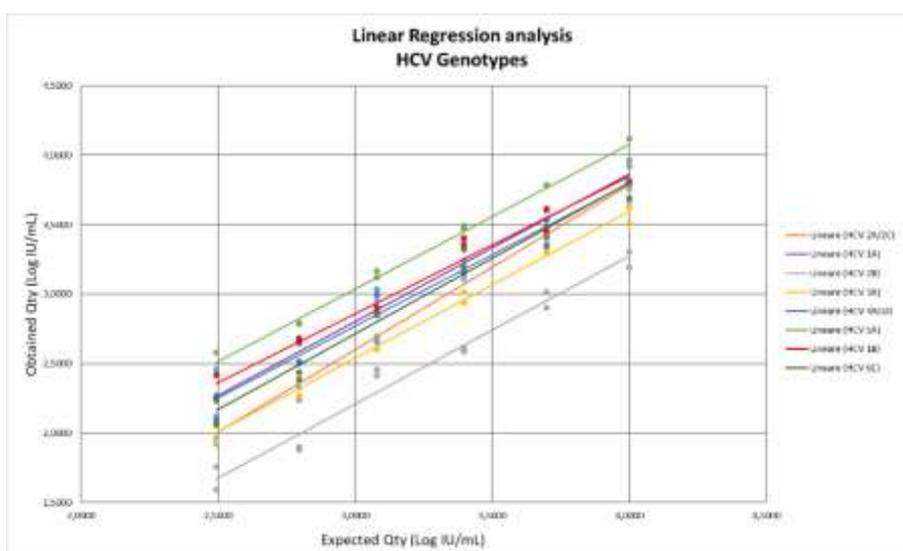

La linearità del saggio è stata confermata per i genotipi principali di HCV (1, 2, 3, 4, 5, 6): il valore R2 è compreso tra 0,950 e 0,992 e i risultati quantitativi sono risultati compresi entro  $\pm 0,5$  Log IU/mL, ad eccezione del genotipo 2B di HCV che è stato sottostimato di circa 0,8 Log IU/mL rispetto al valore teorico. Tuttavia, gli stessi campioni sono stati sottostimati da "cobas® HCV for use on the 6800 Systems" (Roche Diagnostics).

La linearità del saggio è stata verificata analizzando campioni negativi di plasma in EDTA, campioni negativi di plasma in ACD e campioni negativi di siero positivamente con materiale di riferimento per HCV (6<sup>th</sup> WHO International Standard, NIBSC).

I risultati sono illustrati nella figura seguente.

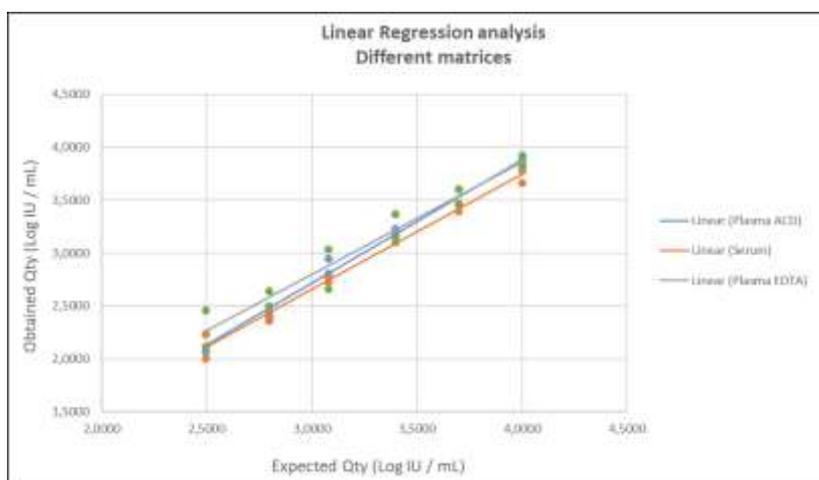

La linearità del saggio è stata verificata per campioni di plasma in EDTA, di plasma in ACD e di siero dando risultati quantitativi entro  $\pm 0,5$  Log IU/mL e R2 rispettivamente di 0,950, 0,984 e 0,987.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Incertezza della curva dello standard**

Il valore di incertezza della curva dello standard è stato calcolato combinando gli errori casuali (SD) delle quantificazioni di tutti i livelli e moltiplicando per il fattore di copertura  $k = 2$  (incertezza combinata estesa) ed è pari a 0,1416 Log copie/reazione.

Livelli della curva dello standard	Teorico	SD	Incertezza combinata estesa
	Log c/rxn		
HCV Standard 10 <sup>5</sup>	5,0000	0,0652	0,1416
HCV Standard 10 <sup>4</sup>	4,0000	0,0641	
HCV Standard 10 <sup>3</sup>	3,0000	0,0489	
HCV Standard 10 <sup>2</sup>	2,0000	0,0964	

**Inclusività: Efficienza della rilevazione e della quantificazione su differenti genotipi**

L'inclusività del saggio, come efficienza della rilevazione per differenti genotipi di HCV, è stata valutata mediante analisi *in silico* delle sequenze disponibili nei database dei nucleotidi. L'analisi ha dimostrato la conservazione della sequenza e l'assenza di mutazioni significative. Pertanto, si prevede una rilevazione efficiente di differenti ceppi o isolati.

L'inclusività del saggio è stata verificata testando tre pannelli di materiali di riferimento per HVC (Seracare, AccuTrak, Qnostics) a 3x LoD.

I risultati sono illustrati nelle tabelle seguenti.

AccuTrak HCV RNA Genotype Performance Panel (SeraCare)		
ID campione	Pos./Rep.	Esito
HCV 1a	3 / 3	HCV rilevato
HCV 1b	3 / 3	HCV rilevato
HCV 2a/2c	3 / 3	HCV rilevato
HCV 2b	3 / 3	HCV rilevato
HCV 3a	3 / 3	HCV rilevato
DHCV 4acd	3 / 3	HCV rilevato
HCV 5a	3 / 3	HCV rilevato
HCV 6c	3 / 3	HCV rilevato
HCV Genotype Evaluation Panel (Qnostics)		
ID campione	Pos./Rep.	Esito
HCV 1a	3/3	HCV rilevato
HCV 1b	3/3	HCV rilevato
HCV 2b	3/3	HCV rilevato
HCV 3a	3/3	HCV rilevato
HCV 4a	3/3	HCV rilevato
HCV 5a	3/3	HCV rilevato
HCV 6a	3/3	HCV rilevato
Non WHO Reference Material 4th HCV RNA Genotype Panel (NIBSC)		
ID campione	Pos./Rep.	Esito
HCV 1a	3/3	HCV rilevato
HCV 1b	3/3	HCV rilevato
HCV 2i	3/3	HCV rilevato
HCV 3a	3/3	HCV rilevato
HCV 4r	3/3	HCV rilevato
HCV 5a	3/3	HCV rilevato
HCV 6l	3/3	HCV rilevato

Tutti i campioni sono stati correttamente rilevati come positivi e quantificati entro  $\pm 0,5$  Log utilizzando HCV ELITE MGB® Kit su ELITE InGenius.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Marcatori potenzialmente interferenti: Crossreattività**

La potenziale crossreattività con altri microrganismi che si possono rilevare nei campioni clinici di plasma è stata valutata per il saggio mediante analisi *in silico*. L'analisi non ha evidenziato omologie significative con altri organismi diversi da quello di interesse (virus, batteri, protozoi e funghi). Pertanto, non si prevede nessuna crossreattività.

L'assenza di crossreattività con altri organismi è stata verificata anche mediante l'analisi di un pannello di organismi diversi da quello di interesse (ATCC, NIBSC e ZeptoMetrix) ad alto titolo.

I risultati sono illustrati nella tabella seguente.

ID campione	Pos./Rep.	Esito
HIV1	0 / 3	Nessuna crossreattività
HIV2	0 / 3	Nessuna crossreattività
HTLVI	0 / 3	Nessuna crossreattività
HTLVII	0 / 3	Nessuna crossreattività
CMV	0 / 3	Nessuna crossreattività
EBV	0 / 3	Nessuna crossreattività
HBV	0 / 3	Nessuna crossreattività
HEV	0 / 3	Nessuna crossreattività
HSV1	0 / 3	Nessuna crossreattività
HSV2	0 / 3	Nessuna crossreattività
HHV6	0 / 3	Nessuna crossreattività
VZV	0 / 3	Nessuna crossreattività
Flu A	0 / 3	Nessuna crossreattività
Flu B	0 / 3	Nessuna crossreattività
RSV	0 / 3	Nessuna crossreattività
ADV	0 / 3	Nessuna crossreattività
WNV	0 / 12	Nessuna crossreattività
DV3	0 / 3	Nessuna crossreattività
EV	0 / 3	Nessuna crossreattività
PVB19	0 / 3	Nessuna crossreattività
<i>Staphylococcus aureus</i>	0 / 3	Nessuna crossreattività
<i>Candida albicans</i>	0 / 3	Nessuna crossreattività

Tutti i marcatori potenzialmente interferenti analizzati non hanno evidenziato alcuna crossreattività per l'amplificazione del target HCV quando analizzati con HCV ELITE MGB Kit.

**Marcatori potenzialmente interferenti: Inibizione**

La potenziale inibizione di organismi diversi da quello di interesse che si possono rilevare nei campioni clinici è stata valutata per il saggio mediante l'analisi di pannelli di organismi diversi da quello di interesse (ATCC, NIBSC, ZeptoMetrix) a 3x LoD.

I risultati sono illustrati nella tabella seguente.

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

ID campione	HCV Pos. / Rep.	Esito
HIV1	3 / 3	Nessuna interferenza
HIV2	3 / 3	Nessuna interferenza
HTLVI	3 / 3	Nessuna interferenza
HTLVII	3 / 3	Nessuna interferenza
CMV	3 / 3	Nessuna interferenza
EBV	3 / 3	Nessuna interferenza
HBV	3 / 3	Nessuna interferenza
HEV	3 / 3	Nessuna interferenza
HSV1	3 / 3	Nessuna interferenza
HSV2	3 / 3	Nessuna interferenza
HHV6	3 / 3	Nessuna interferenza
VZV	3 / 3	Nessuna interferenza
Flu A	3 / 3	Nessuna interferenza
Flu B	3 / 3	Nessuna interferenza
RSV	3 / 3	Nessuna interferenza
ADV	3 / 3	Nessuna interferenza
WNV	3 / 3	Nessuna interferenza
DV3	3 / 3	Nessuna interferenza
EV	3 / 3	Nessuna interferenza
PVB19	3 / 3	Nessuna interferenza
<i>Staphylococcus aureus</i>	3 / 3	Nessuna interferenza
<i>Candida albicans</i>	3 / 3	Nessuna interferenza

Tutti gli organismi potenzialmente interferenti analizzati non hanno evidenziato alcuna inibizione dell'amplificazione del target HCV quando analizzati con HCV ELITe MGB Kit.

**Sostanze potenzialmente interferenti: Inibizione**

La potenziale inibizione di sostanze interferenti (endogene ed esogene) che potrebbero essere presenti nei campioni clinici è stata valutata per il saggio mediante l'analisi di un pannello di sostanze a concentrazioni rilevanti in campioni di plasma positivi per il target.

I risultati sono illustrati nella tabella seguente.

Campione	HCV Pos. / Rep.	Esito
Bilirubina	3 / 3	Nessuna interferenza
Trigliceridi	3 / 3	Nessuna interferenza
Emoglobina elevata	1 / 3	Interferenza
Emoglobina media	3 / 3	Interferenza
Emoglobina bassa	3 / 3	Nessuna interferenza
Eparina	0 / 3	Interferenza
EDTA	3 / 3	Nessuna interferenza
Ganciclovir	3 / 3	Nessuna interferenza
Azitromicina	3 / 3	Nessuna interferenza
Sofosbuvir	3 / 3	Nessuna interferenza
Pibrentasvir	3 / 3	Nessuna interferenza
Glecaprevir	3 / 3	Nessuna interferenza
Ribavirina	3 / 3	Nessuna interferenza
Velpatasvir	3 / 3	Nessuna interferenza

La maggior parte delle sostanze testate non interferisce con l'amplificazione del target HCV o del controllo interno.

## HCV ELITe MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Nota:** L'emoglobina a concentrazione media (1,7 – 2,3 g/dL) è considerata interferente e non quantifica il target HCV con valori di quantità logaritmica medi del target compresi nell'intervallo richiesto dalle linee guida internazionali dopo l'aggiunta o la sottrazione del valore di SEM come errore di misurazione.

È stato confermato che l'eparina e l'emoglobina ad alte concentrazioni (3,4 – 4,6 g/dL) sono in grado di inibire l'amplificazione di HCV, tuttavia grazie al limite di Ct per il controllo interno (Ct IC <31), in molti casi si sono ottenuti risultati dei campioni "non validi" e non "falsi negativi".

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Contaminazione crociata**

La possibile contaminazione crociata durante l'analisi è stata valutata analizzando 30 campioni di plasma negativi per l'RNA di HCV alternati a 30 campioni di plasma positivamente con materiale di riferimento certificato per HCV (Zeptomatrix) ad alto titolo.

I risultati sono illustrati nella tabella seguente.

Campioni	N	Positivi	Negativi
Plasma con ACD inoculato a $1 \times 10^6$ HCV IU/mL	30	30	0
Plasma con ACD negativo per HCV	30	0	30

In questo test con HCV ELITE MGB Kit, non sono state rilevate crosscontaminazioni tra le sessioni, né al loro interno.

**Tasso totale di errore di sistema**

Il tasso totale di errore di sistema per il saggio è stato valutato sugli strumenti ELITE InGenius e ELITE BeGenius analizzando un pannello di campioni positivamente con un materiale di riferimento certificato (6<sup>th</sup> WHO HBV International Standard, NISBC) alla concentrazione di 3 x LoD (circa 78 IU/mL).

I risultati sono sintetizzati nelle tabelle seguenti.

ELITE InGenius - Tasso totale di errore di sistema					
Campioni	N	Teorico UI/mL	Positivi	Negativi	Tasso totale di errore di sistema
Plasma in EDTA positivamente con HCV	100	78	100	0	0%
Plasma in ACD positivamente con HCV	30	78	30	0	0%
Siero positivamente con HCV	30	78	30	0	0%

ELITE BeGenius - Tasso totale di errore di sistema					
Matrice	N	Teorico UI/mL	Positivi	Negativi	Tasso totale di errore di sistema
Plasma in EDTA positivamente con HCV	100	78	100	0	0%

In questo test con HCV ELITE MGB Kit, nessuno dei campioni positivi per l'RNA di HCV ha fornito risultati falsi negativi. In questo test, il tasso totale di errore di sistema è stato pari allo 0%.

**Ripetibilità**

La ripetibilità intra-sessione e inter-sessione del saggio è stata valutata sugli strumenti ELITE InGenius e ELITE BeGenius analizzando un pannello di campioni di plasma, inclusi un campione negativo e due campioni positivamente con materiale di riferimento certificato per HCV (6<sup>th</sup> WHO International Standard, NIBSC).

Un esempio dei risultati di ripetibilità intra-sessione (in un giorno) è illustrato nelle tabelle seguenti.

Ripetibilità intra-sessione con ELITE InGenius (Giorno 1)								
Campione	N	HCV				Controllo interno		
		Ct media	Ct media	Ct media	% Concordanza	Ct media	SD	%CV
Negativi	8	-	-	-	100%	27,43	0,21	0,78
3X LOD	8	37,28	0,34	0,92	100%			
10X LOD	8	35,37	0,43	1,23	100%			

Ripetibilità intra-sessione con ELITE BeGenius (Giorno 1)								
Campione	N	HCV				Controllo interno		
		Ct media	Ct media	Ct media	% Concordanza	Ct media	SD	%CV
Negativi	8	-	-	-	100%	27,87	0,30	1,08
3X LOD	8	37,83	1,15	3,05	100%			
10X LOD	8	35,45	0,30	0,85	100%			

Un esempio dei risultati di ripetibilità inter-sessione (in due giorni) è illustrato nelle tabelle seguenti.

Ripetibilità inter-sessione con ELITE InGenius (Giorno1 + Giorno2)								
Campione	N	HCV				Controllo interno		
		Ct media	Ct media	Ct media	% Concordanza	Ct media	SD	%CV

**HCV ELITe MGB® Kit**reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR**REF** RTK601ING

		<b>Ct media</b>	<b>Ct media</b>	<b>Ct media</b>	<b>% Concordanza</b>	<b>Ct media</b>	<b>SD</b>	<b>%CV</b>
Negativi	16	-	-	-	100%	27,41	0,18	0,66
3X LOD	16	37,37	0,67	1,78	100%			
10X LOD	16	35,40	0,43	1,22	100%			

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

**Ripetibilità inter-sessione con ELITE BeGenius (Giorno1 + Giorno2)**

Campione	N	HCV				Controllo interno		
		Ct media	Ct media	Ct media	% Concordanza	Ct media	SD	%CV
Negativi	16	-	-	-	100%	27,89	0,31	1,10
3X LOD	16	37,68	0,25	2,31	100%			
10X LOD	16	35,54	0,10	0,96	100%			

Nel test di ripetibilità, HCV ELITE MGB Kit ha rilevato correttamente il target e mostrato una variabilità massima dei valori di Ct del target espressa come %CV pari a 3,05%.

**Riproducibilità**

La riproducibilità inter-sito del saggio è stata valutata sullo strumento ELITE InGenius analizzando un pannello di campioni di plasma negativi o positivizzati con HCV (6<sup>th</sup> WHO International Standard, NIBSC).

Le tabelle sottostanti riportano una sintesi della riproducibilità inter-sito (su due siti).

**Riproducibilità inter-sito con ELITE InGenius**

Campione	HCV					Controllo interno		
	N	Ct media	SD	%CV	% Concordanza	Media Ct IC	SD Ct IC	%CV Ct IC
Negativi	24	Indet.	-	-	100%	28,15	0,58	2,06
3X LoD	24	36,89	0,55	1,48	100%			
10X LoD	24	35,03	0,46	1,32	100%			

Nel test di riproducibilità inter-sito, HCV ELITE MGB Kit ha rilevato il target e mostrato una variabilità massima dei valori di Ct del target espressa come %CV pari a 1,48%.

La riproducibilità del saggio è stata valutata sugli strumenti ELITE BeGenius e ELITE InGenius analizzando un pannello di campioni di plasma negativi o positivizzati con HCV (6<sup>th</sup> WHO International Standard, NIBSC).

Le tabelle sottostanti riportano una sintesi della riproducibilità inter-strumento (su tre strumenti).

**Riproducibilità inter-strumento con ELITE InGenius**

Campione	HCV					Controllo interno		
	N	Ct media	SD	% CV	% Concordanza	Ct media	SD	% CV
Negativi	24	Indet.	-	-	100%	27,69	0,34	1,24
3x LoD	24	37,03	0,53	1,44	100%			
10x LoD	24	33,97	0,38	1,11	100%			

**Riproducibilità inter-strumento con ELITE BeGenius**

Campione	HCV					Controllo interno		
	N	Ct media	SD	% CV	% Concordanza	Ct media	SD	% CV
Negativi	24	Indet.	-	-	100%	28,52	0,61	2,13
3 x LoD	23	38,00	0,71	1,86	100%			
10 x LoD	24	36,44	0,67	1,84	100%			

Le tabelle sottostanti riportano una sintesi della riproducibilità inter-lotto (su tre lotti).

**Riproducibilità inter-lotto con ELITE InGenius**

Campione	HCV					Controllo interno		
	N	Ct media	SD	% CV	% Concordanza	Ct media	SD	% CV
Negativi	48	Indet.	-	-	100%	27,70	0,33	1,20
3x LoD	48	37,32	0,64	1,72	100%			
10x LoD	48	35,44	0,38	1,07	100%			

**Riproducibilità inter-lotto con ELITE BeGenius**

Campione	HCV					Controllo interno		
	N	Ct media	SD	% CV	% Concordanza	Ct media	SD	% CV
Negativi	48	Indet.	-	-	100%	28,20	0,40	1,41
3 x LoD	48	37,60	0,71	1,88	100%			
10 x LoD	48	35,78	0,48	1,33	100%			

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time  
PCR

**REF** RTK601ING

Nel test di riproducibilità inter-strumento e inter-lotto, HCV ELITe MGB Kit ha rilevato correttamente tutti i campioni come previsto e ha mostrato una variabilità massima dei valori di Ct del target espressa come %CV pari a 1,88%.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

### Fattore di conversione alle Unità Internazionali

Il fattore di conversione per riportare i risultati quantitativi in unità internazionali/mL a partire da copie/mL è stato calcolato utilizzando il materiale di riferimento calibrato certificato "6<sup>th</sup> WHO HCV International Standard" (NIBSC).

Il fattore di conversione è stato determinato pari a 2,4 IU/copie.


Le tabelle sottostanti riportano una sintesi dei risultati.

Fattore di conversione alle Unità Internazionali, Fc = 2,4 IU/copie						
Campione			Risultato			Differenza log (rif. - test)
UI/ml	Log IU/mL	N	C./ml media	UI/ml media	Log UI/ml media	
31.623	4,5000	27	13.233	31.254	4,4807	+0,0193
10000	4,0000	27	4.482	10.595	4,0133	+0,0133
3162	3,5000	27	1414	3.342	3,5091	-0,0091
1000	3,0000	27	439	1036	2,9969	+0,0031

Essendo stata precedentemente dimostrata l'equivalenza tra campioni di plasma in EDTA, di plasma in ACD e di siero, il fattore di conversione può essere applicato alle tre matrici.

Il fattore di conversione per riportare i risultati quantitativi in unità internazionali/mL a partire da copie/mL è stato verificato sugli **strumenti ELITE BeGenius** ed **ELITE InGenius** utilizzando il materiale di riferimento calibrato certificato ("6<sup>th</sup> WHO International Standard" (NIBSC).

I risultati ottenuti sono stati analizzati tramite regressione ortogonale e lineare allo scopo di calcolare la loro correlazione.

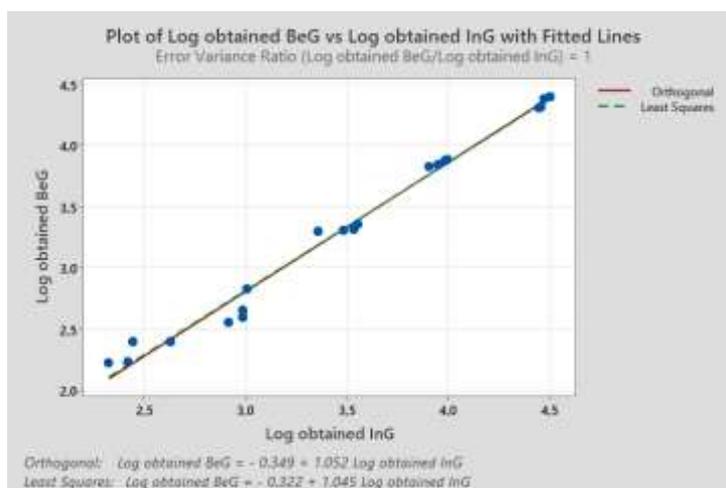

L'analisi di regressione ortogonale ha generato un'intercetta pari a - 0,3494 (95% IC: - 0,5546; - 0,1442) e una pendenza pari a 1,0523 (95% CI: 0,9943; 1,1103). L'analisi di regressione lineare ha generato un R<sup>2</sup> di 0,985.

### Sensibilità diagnostica: correlazione metodologica

La sensibilità diagnostica del saggio, valutata mediante analisi di correlazione di diversi metodi, è stata valutata in tre laboratori diversi sullo strumento **ELITE InGenius** analizzando campioni clinici positivi per l'RNA di HCV di pazienti sottoposti a terapia antivirale, con carico virale compreso nell'intervallo di misurazione di HCV ELITE MBG Kit e dei metodi di riferimento di diagnostica molecolare marcati CE IVD. I risultati ottenuti con HCV ELITE MBG Kit e con il metodo di riferimento sono stati sottoposti ad analisi di regressione di Deming e lineare.


Lo studio di correlazione è stato eseguito in un laboratorio su 95 campioni clinici di plasma in EDTA positivi per l'RNA di HCV utilizzando come metodo di riferimento il "cobas® HCV for use on the 6800 System".

I risultati sono sintetizzati nelle figure sottostanti.

## HCV ELITe MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR


REF RTK601ING

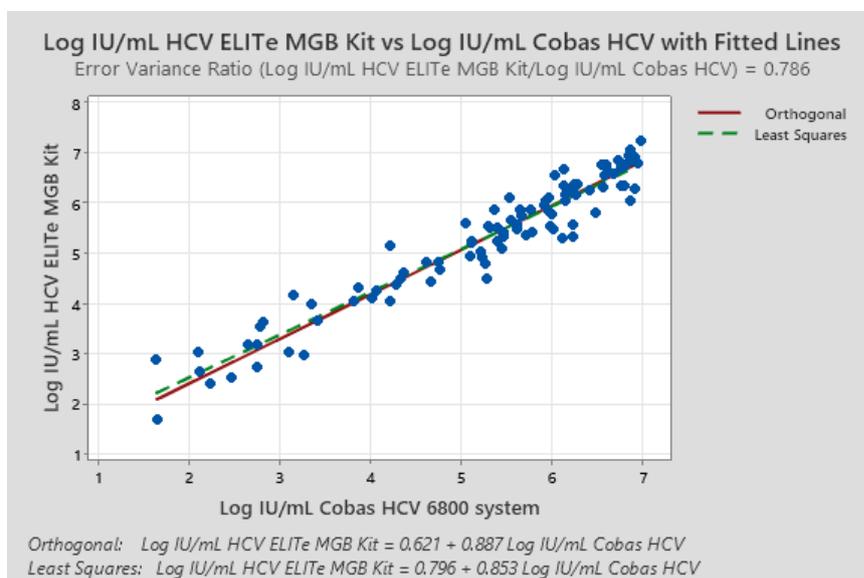

In questo test, l'analisi di regressione di Deming ha generato una pendenza pari a 0,887 (CI 95%: 0,836; 0,938) e un'intercetta pari a 0,621 (95% CI: 0,345; 0,896). L'analisi di regressione lineare ha generato un  $R^2$  di 0,926.

Lo studio di correlazione è stato eseguito in due altri siti su 184 campioni clinici di plasma in EDTA e di siero positivi per l'RNA di HCV utilizzando come metodo di riferimento il "cobas® HCV for use on the 4800 System".

I risultati sono sintetizzati nelle figure sottostanti.

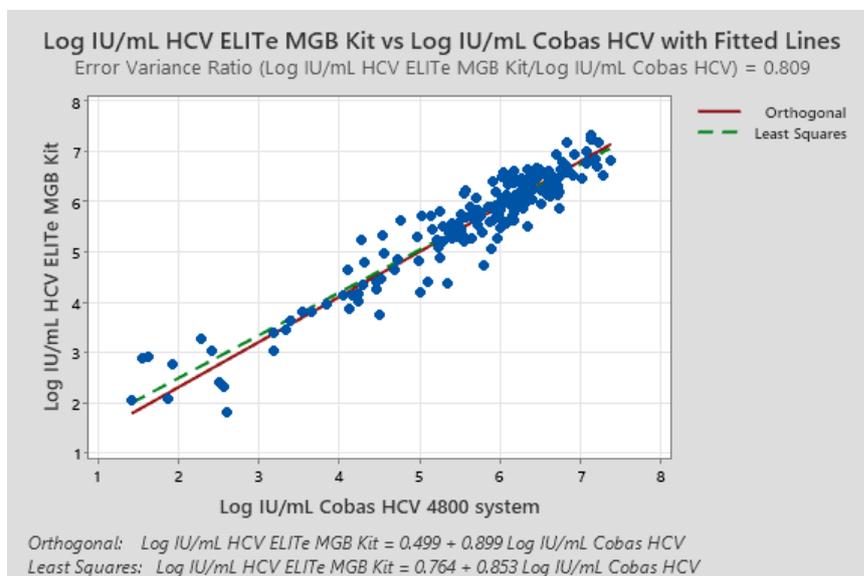

In questo test, l'analisi di regressione di Deming ha generato una pendenza pari a 0,899 (CI 95%: 0,856; 0,943) e un'intercetta pari a 0,499 (95% CI: 0,245; 0,753). L'analisi di regressione lineare ha generato un  $R^2$  di 0,899.


Poiché i due metodi di riferimento ("cobas® HCV for use on the 4800 System" e "cobas® HCV for use on the 6800 System", Roche Diagnostics) hanno prestazioni equivalenti, lo studio di correlazione è stato eseguito anche sui risultati combinati dei tre diversi siti.

I risultati sono sintetizzati nelle figure sottostanti.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

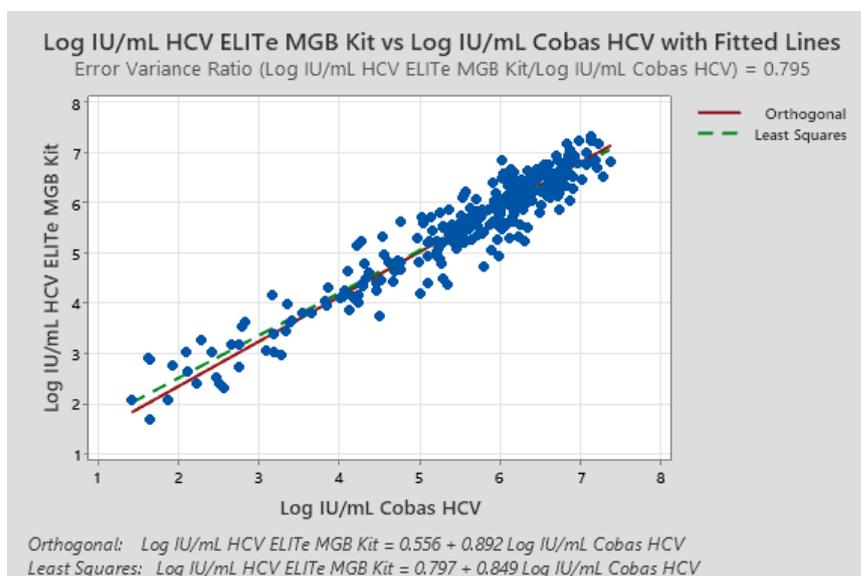

In questo test, l'analisi di regressione di Deming ha generato una pendenza pari a 0,892 (CI 95%: 0,858; 0,926) e un'intercetta pari a 0,556 (95% CI: 0,363; 0,749). L'analisi di regressione lineare ha generato un R<sup>2</sup> di 0,905.

Poiché **ELITE BeGenius** ha prestazioni analitiche equivalenti a **ELITE InGenius**, anche le prestazioni diagnostiche del saggio eseguito sui due strumenti sono considerate equivalenti. Pertanto, la sensibilità diagnostica del saggio ottenuta su **ELITE InGenius** è applicabile anche a **ELITE BeGenius**.

### Specificità diagnostica: conferma di campioni negativi

La specificità diagnostica del saggio, valutata mediante percentuale di concordanza negativa, è stata valutata in tre siti differenti su **ELITE InGenius** analizzando campioni clinici negativi per l'RNA di HCV testati con metodi di riferimento di diagnostica molecolare marcati CE IVD.

I risultati dello studio di specificità diagnostica, dopo l'analisi di discrepanza, sono sintetizzati nella tabella seguente, entrambi differenziati mediante il metodo di riferimento ("cobas® HCV for use on the 4800 System" e "cobas® HCV for use on the 6800 System", Roche Diagnostics) e combinati, in quando offrono prestazioni equivalenti.

Campioni di plasma in EDTA e di siero negativi per l'RNA di HCV	N	Positivi	Negativi	Specificità diagnostica
Riferimento: cobas HCV for use on the 6800 Systems	100	0	100	100%
Riferimento: cobas HCV for use on the 4800 Systems	222	5	217	97,7%
Risultati combinati	322	5	317	98,4%

Cinque campioni hanno dato risultati positivi discordanti con un titolo basso (4 campioni su 5 con un titolo più basso rispetto al LoD di HCV ELITE MGB Kit e dei metodo di riferimenti); questi campioni possono casualmente generare risultati positivi.

Poiché **ELITE BeGenius** ha prestazioni analitiche equivalenti a **ELITE InGenius**, anche le prestazioni diagnostiche del saggio eseguito sui due strumenti sono considerate equivalenti. Pertanto, la specificità diagnostica del saggio ottenuta su **ELITE InGenius** è applicabile anche a **ELITE BeGenius**.

**Nota:** I dati e i risultati completi dei test eseguiti per la valutazione delle caratteristiche delle prestazioni del prodotto con le matrici e gli strumenti sono registrati nel Fascicolo Tecnico del prodotto "HCV ELITE MGB® Kit", FTP601ING.

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

### BIBLIOGRAFIA

- P. Halfon et al. (2006) *J Clin Microbiology* 44: 2507 – 2511  
K. Linnet et al. (2004) *Clin. Chem.* 50: 732 - 740.  
E. A. Lukhtanov et al. (2007) *Nucleic Acids Res.* 35: e30.  
WHO Prequalification of In Vitro Diagnostics Public Report (WHO PQ Public Report), number PQDx 0465-118-00, 03/2021, version 1,0.  
<https://ltd.aruplab.com> (test number 3000572).  
<https://mayocliniclabs.com> (Test ID: HCVQN).  
H. H. Kessler et al. (2001) *J. Clin. Microb.* 39: 1788 - 1790.  
K. Sener et al. (2010) *J. Clin. Lab. Analysis* 24: 134 - 138.  
C. Baleriola et al. (2011) *J. Clin. Microbiol.* 49: 3163 – 3167  
WHO (World Health Organization), 2018, Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection.  
CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 2020, CDC Recommendations for Hepatitis C Screening Among Adults — United States, 2020.  
AASLD (American Association for the study of liver diseases) and IDSA (The Infectious Diseases Society of America), 2022, HCV Guidance: Recommendations for testing, managing and treating Hepatitis C.  
EASL (European Association for the Study of the Liver), 2020, EASL recommendations on treatment of Hepatitis C 2020”, *Journal of Hepatology*.  
Ministero della Salute, 2022, Linee di indirizzo Nazionali sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per l'infezione da virus dell'epatite C.

### LIMITI DELLA PROCEDURA

Utilizzare questo prodotto soltanto con i seguenti campioni clinici: Plasma o in provette con EDTA o ACD, siero.

Il plasma in EDTA o in ACD e il siero essere ottenuti da sangue intero conservato a temperatura ambiente o a 2/8 °C per un massimo di 24 ore.

Non utilizzare questo prodotto con plasma raccolto in provette contenenti eparina, perché l'eparina inibisce la reazione di amplificazione degli acidi nucleici e può quindi invalidare i risultati.

Non utilizzare questo prodotto con plasma emolizzato, perché l'eparina inibisce la reazione di amplificazione degli acidi nucleici e può quindi invalidare i risultati.

Al momento non sono disponibili dati riguardanti le prestazioni del prodotto con altri campioni clinici quale il sangue intero.

Il prodotto non è destinato all'uso come test di screening o per rilevare la presenza o l'esposizione ad agenti trasmissibili nel sangue, negli emoderivati, nelle cellule, nei tessuti, negli organi o in qualsiasi dei loro derivati al fine di valutarne l'idoneità per la trasfusione, il trapianto o la terapia cellulare.

Il prodotto non è destinato all'uso come test diagnostico per confermare la presenza di un'infezione da HCV.

I risultati ottenuti con questo prodotto dipendono dalla corretta identificazione, raccolta, trasporto, conservazione e preparazione dei campioni. Per evitare risultati errati è necessario, pertanto, procedere con cautela durante queste fasi e seguire attentamente le istruzioni per l'uso riportate nel manuale fornito con il prodotto.

La metodica PCR real time utilizzata in questo prodotto ha un'elevata sensibilità analitica che la rende soggetta a contaminazioni da campioni clinici positivi, da controlli positivi e dai prodotti della PCR. Le contaminazioni crociate possono produrre risultati falsi positivi. Il formato del prodotto è progettato per limitare le contaminazioni crociate. Comunque, questi fenomeni possono essere evitati solo attenendosi alle buone prassi di laboratorio e seguendo attentamente le istruzioni riportate nel presente manuale.

Questo prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato e addestrato alla manipolazione di campioni biologici potenzialmente in grado di trasmettere agenti infettivi e di preparati chimici classificati

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

come pericolosi al fine di evitare incidenti con conseguenze potenzialmente gravi per l'utilizzatore o altre persone.

Questo prodotto richiede l'uso di dispositivi di protezione individuale e la disponibilità di aree idonee alla lavorazione di campioni biologici potenzialmente in grado di trasmettere agenti infettivi e di preparati chimici classificati come pericolosi al fine di evitare incidenti con conseguenze potenzialmente gravi per l'utilizzatore o altre persone.

Questo prodotto richiede l'uso di dispositivi di protezione individuale e di strumenti dedicati alla preparazione delle sessioni di lavoro per evitare risultati falsi positivi.

Questo prodotto deve essere utilizzato da professionisti qualificati e addestrati all'uso di tecniche di biologia molecolare, quali estrazione, PCR e rilevazione di acidi nucleici, per evitare risultati errati.

È necessario disporre di aree separate per la preparazione della miscela di reazione completa e dell'estrazione/amplificazione/rilevazione dei prodotti della reazione di amplificazione per prevenire risultati falso-positivi.

A causa di differenze intrinseche tra tecnologie, si raccomanda agli utilizzatori di eseguire studi di correlazione al fine di valutare le differenze a livello tecnologico prima di cambiare prodotto.

Un risultato negativo ottenuto con questo prodotto indica che l'RNA del target non è stato rilevato nell'RNA estratto dal campione, ma non si può escludere che l'RNA del target abbia un titolo più basso del limite di rilevazione del prodotto (vedere "Caratteristiche delle prestazioni"). In questo caso il risultato potrebbe essere un falso negativo.

Talvolta, i risultati ottenuti con questo prodotto possono non essere validi per via di un difetto del controllo interno. In questo caso il campione dovrà essere analizzato di nuovo, a cominciare dall'estrazione, con conseguente possibile ritardo nel conseguimento dei risultati finali.

Possibili polimorfismi, inserimenti o delezioni nella regione dell'RNA del coperta dai primer e dalle sonde del prodotto potrebbero compromettere la rilevazione e la quantificazione del RNA del target.

Come per qualunque altro dispositivo medico-diagnostico, i risultati ottenuti con questo prodotto devono essere interpretati in combinazione con tutte le osservazioni cliniche e i risultati di laboratorio pertinenti.

Come per qualunque altro dispositivo medico-diagnostico, vi è un rischio residuo di ottenere con questo prodotto risultati non validi o errati. Tale rischio residuo non può essere eliminato né ulteriormente ridotto. In taluni casi, potrebbe indurre decisioni sbagliate con effetti potenzialmente pericolosi per il paziente. Tuttavia, tale rischio residuo associato all'uso previsto del prodotto è stato ponderato a fronte dei potenziali benefici per il paziente ed è stato ritenuto accettabile.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Reazione con Q-PCR Standard, curva dello standard o reazione con il controllo positivo non valida	
Possibili cause	Soluzioni
Errata impostazione dello strumento.	Controllare la posizione della miscela di reazione completa, di Q-PCR Standard e del controllo positivo. Controllare i volumi della miscela di reazione completa, di Q-PCR standard e del controllo positivo.
Errore di preparazione della miscela di reazione completa.	Controllare i volumi dei reagenti utilizzata durante la preparazione della miscela di reazione completa.
Degradazione della miscela di reazione completa o dei suoi componenti.	Non utilizzare la miscela di reazione completa per più di 3 sessioni consecutive (7 ore nel blocco refrigerante dell'Inventory Area o nella Cooler Unit). Non lasciare il PCR Mix a temperatura ambiente per più di 30 minuti. Non lasciare il prodotto RT EnzymeMix a temperature superiori a -20 °C per più di 10 minuti. Preparare di nuovo la miscela di reazione completa. Utilizzare una nuova aliquota dei componenti.

**HCV ELITe MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

**REF** RTK601ING

Degradazione dei Q-PCR Standard o del controllo positivo.	Non utilizzare il Q-PCR Standard per più di 2 sessioni indipendenti (2 ore ciascuna nell'area di estrazione o nella Cooler Unit). Non utilizzare il controllo positivo per più di 4 sessioni indipendenti (3 ore ciascuna nell'area di estrazione o nella Cooler Unit). Utilizzare nuove aliquote dei Q-PCR Standard o del controllo positivo.
Errore dello strumento.	Contattare l'assistenza tecnica di ELITechGroup.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

**REF** RTK601ING

<b>Reazione del controllo negativo non valida</b>	
<b>Possibili cause</b>	<b>Soluzioni</b>
Errata impostazione dello strumento.	Controllare la posizione della miscela di reazione completa e del controllo negativo. Controllare i volumi della miscela di reazione completa e del controllo negativo.
Contaminazione del controllo negativo.	Non utilizzare il controllo negativo per più di 1 sessione. Utilizzare una nuova aliquota di acqua per biologia molecolare.
Contaminazione della miscela di reazione completa o dei suoi componenti.	Preparare di nuovo la miscela di reazione completa. Utilizzare una nuova aliquota dei componenti.
Contaminazione dell'area di estrazione, dei rack, dell'Inventory Block o della Cooler Unit.	Pulire le superfici con detergenti acquosi, lavare i camici, sostituire le provette e i puntali in uso.
Errore dello strumento.	Contattare l'assistenza tecnica di ELITechGroup.

<b>Reazione del campione non valida</b>	
<b>Possibili cause</b>	<b>Soluzioni</b>
Errata impostazione dello strumento.	Controllare la posizione della miscela di reazione completa, del controllo interno e del campione. Controllare i volumi della miscela di reazione completa, del controllo interno e del campione.
Errore di preparazione della miscela di reazione completa.	Controllare i volumi dei reagenti utilizzata durante la preparazione della miscela di reazione completa.
Degradazione della miscela di reazione completa o dei suoi componenti.	Non utilizzare la miscela di reazione completa per più di 3 sessioni consecutive (7 ore nel blocco refrigerante dell'Inventory Area o nella Cooler Unit). Non lasciare il PCR Mix a temperatura ambiente per più di 30 minuti. Non lasciare il prodotto RT EnzymeMix a temperature superiori a -20 °C per più di 10 minuti. Preparare di nuovo la miscela di reazione completa. Utilizzare una nuova aliquota dei componenti.
Degradazione del template di Internal Control.	Utilizzare una nuova aliquota di Internal Control.
Inibizione dovuta a sostanze interferenti nel campione.	Ripetere la reazione di amplificazione del campione con una diluizione 1:2 in acqua per biologia molecolare del campione eluito in una sessione in modalità "PCR Only". Ripetere l'estrazione con una diluizione 1:2 in acqua per biologia molecolare del campione eluito in una sessione in modalità "Extract + PCR" (estrazione + PCR).
Errore dello strumento.	Contattare l'assistenza tecnica di ELITechGroup.

<b>Curva di dissociazione anomala</b>	
<b>Possibili cause</b>	<b>Soluzioni</b>
Assenza di un picco definito. Picco definito, ma Tm differente rispetto a quello di altri campioni e degli standard o del controllo positivo.	Controllare che il valore Ct del target sia inferiore a 30. La grande quantità di prodotti della reazione di amplificazione alla fine della reazione può interferire con l'analisi della curva di melting. Ripetere la reazione di amplificazione del campione per confermare la presenza del target con una possibile mutazione. Il target nel campione deve essere sequenziato per confermare la mutazione.

**HCV ELITE MGB® Kit**

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

**REF** RTK601ING

<b>Errore nel calcolo di Ct</b>	
<b>Possibili cause</b>	<b>Soluzioni</b>
Concentrazione troppo elevata del target nel campione o campione con segnale di fluorescenza anomalo.	<p>Se nel tracciato della PCR appare un'amplificazione significativa, selezionare il tracciato relativo al campione e approvare manualmente il risultato come positivo.</p> <p>Se nel tracciato della PCR no appare nessuna amplificazione, selezionare il tracciato relativo al campione e approvare manualmente il risultato come negativo o lasciarlo come non valido.</p> <p>Se è richiesto un valore di Ct:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ripetere la reazione di amplificazione del campione eluito con una diluizione 1:10 in acqua per biologia molecolare in una sessione in modalità "PCR Only";</li> <li>- ripetere l'estrazione del campione primario con una diluizione 1:10 in acqua per biologia molecolare in una sessione in modalità "Extract + PCR".</li> </ul>

<b>Anomala percentuale elevata di risultati positivi nella stessa sessione (reazioni con valori tardivi di Ct comparabili)</b>	
<b>Possibili cause</b>	<b>Soluzioni</b>
Contaminazione tra campioni nei passaggi pre-analitici.	<p>Pulire la micropipetta con soluzione fresca di ipoclorito di sodio (candeggina) al 3% o con un detergente per DNA/RNA dopo aver pipettato ogni campione.</p> <p>Non utilizzare le pipette Pasteur. Utilizzare pipette a spostamento positivo oppure munirle di puntali con filtro per aerosol.</p> <p>Introdurre i campioni nelle ultime posizioni degli strumenti, come indicato nella GUI. Seguire la sequenza di caricamento indicata dal software.</p>
Contaminazione ambientale del laboratorio.	<p>Pulire tutte le superfici che vengono a contatto con l'operatore e i campioni (incluse le pipette) con soluzione fresca di ipoclorito di sodio (candeggina) al 3% o detergente per DNA/RNA.</p> <p>Eseguire un ciclo di decontaminazione con U.V.</p> <p>Preparare di nuovo la miscela di reazione completa e/o utilizzare una nuova aliquota di CPE.</p>

## HCV ELITE MGB® Kit

reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR

REF RTK601ING

### LEGENDA DEI SIMBOLI

REF

Numero di catalogo



Limite superiore di temperatura.

LOT

Codice del lotto.



Da utilizzare prima del (ultimo giorno del mese).

IVD

Dispositivo medico-diagnostico *in vitro*.



Conforme ai requisiti del Regolamento IVDR 2017/746\CE relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. Certificato rilasciato da TÜV SÜD Product Service GmbH, Germania.

UDI

Numero Unico Identificativo del dispositivo



Contenuto sufficiente per "N" test.



Consultare le istruzioni per l'uso.

CONT

Contenuto.



Tenere lontano dalla luce solare



Fabbricante.

### AVVISO PER L'UTILIZZATORE

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utilizzatore e/o il paziente. Al momento della revisione corrente delle Istruzioni per l'uso, non si è verificato nessun grave incidente né alcun richiamo, aventi un impatto sulle prestazioni del prodotto e la sicurezza del dispositivo.

Verrà resa disponibile al pubblico una "Sintesi della Sicurezza e delle Prestazioni" tramite il database europeo dei dispositivi medici (Eudamed) non appena questo sistema informatico sarà funzionante. Prima che sia pubblicato l'avviso della piena funzionalità di Eudamed, verrà tempestivamente resa disponibile al pubblico la "Sintesi della Sicurezza e delle Prestazioni" richiedendola via email all'indirizzo [emd.support@elitechgroup.com](mailto:emd.support@elitechgroup.com).

**HCV ELITE MGB® Kit****reagenti per la trascrizione inversa dell'RNA e la Real-Time PCR****REF** RTK601ING**AVVISO PER L'ACQUIRENTE LICENZA LIMITATA**

Questo prodotto contiene reagenti fabbricati da Thermo Fisher Scientific e venduti sulla base di accordi di licenza stipulati tra EG SpA e le sue affiliate e Thermo Fisher Scientific. Il prezzo d'acquisto di questo prodotto include diritti non trasferibili, limitati a utilizzare solo questa quantità di prodotto esclusivamente per attività dell'acquirente direttamente correlate alla diagnostica umana. Per informazioni sulla licenza d'acquisto per questo prodotto per fini diversi da quelli dichiarati sopra, rivolgersi a Licensing Department, Thermo Fisher Scientific. Email: [outlicensing@thermofisher.com](mailto:outlicensing@thermofisher.com).

I reagenti di rilevazione ELITE MGB® sono coperti da uno o più brevetti USA numero 7319022, 7348146, 7381818, 7541454, 7671218, 7718374, 7723038, 7759126, 7767834, 8008522, 8067177, 8163910, 8389745, 8969003, 9056887, 9085800, 9169256, 9328384, 10677728, 10738346, 10890529, e da brevetti EP numero 1687609, 1781675, 1789587, 2689031, 2714939, 2736916, 2997161. Sono state presentate domande di brevetto attualmente in attesa di approvazione.

Le tecnologie ELITE InGenius® ed ELITE BeGenius® sono coperte da brevetti e da domande di brevetti in attesa di approvazione.

Questa licenza limitata permette all'individuo o alla persona giuridica alla quale il prodotto è stato fornito di utilizzarlo unitamente ai dati generati dal suo utilizzo solo per la diagnostica umana. Né ELITechGroup S.p.A. né i suoi licenziatari concedono altre licenze, esplicite o implicite, per altri scopi.

cobas® è un marchio registrato di Roche Diagnostics.

MGB®, Eclipse Dark Quencher®, AquaPhluor®, ELITE MGB®, il logo di ELITE MGB®, ELITE InGenius® ed ELITE BeGenius® sono marchi registrati di ELITechGroup nell'Unione Europea.

# HCV ELITE MGB® Kit utilizzato in associazione agli strumenti della serie Genius®



Attenzione, il presente documento è una versione sintetica del manuale di istruzioni ufficiale. Fare riferimento al documento completo prima dell'uso: [www.elitechgroup.com](http://www.elitechgroup.com)

## Usò previsto

Il prodotto **HCV ELITE MGB® Kit** è un dispositivo medico-diagnostico in vitro destinato all'uso da parte degli operatori sanitari come saggio di trascrizione inversa e real-time PCR quantitativa degli acidi nucleici per la rilevazione e la quantificazione dell'RNA del virus dell'epatite C (HCV), estratto da campioni clinici.

Il saggio è validato in associazione agli strumenti ELITE InGenius® e ELITE BeGenius®, sistemi integrati e automatizzati per l'estrazione, la trascrizione inversa, la real-time PCR e l'interpretazione dei risultati a partire da campioni di plasma umano in provette con EDTA o con ACD.

Il prodotto è destinato all'uso come ausilio nella gestione di pazienti HCV-positivi sottoposti a terapia antivirale.

I risultati devono essere interpretati in associazione a tutte le osservazioni cliniche rilevanti e gli esiti degli esami di laboratorio.

Il prodotto non è destinato all'uso come test di screening o per rilevare la presenza di o l'esposizione ad agenti trasmissibili nel sangue, negli emoderivati, nelle cellule, nei tessuti, negli organi o in qualsiasi dei loro derivati al fine di valutarne l'idoneità per la trasfusione, il trapianto o la terapia cellulare. Il prodotto non è destinato all'uso come test di screening per la presenza di HCV nel sangue o negli emoderivati né come test diagnostico per confermare la presenza di un'infezione da HCV.

## Sequenza amplificata

Sequenza	Gene	Fluoroforo	Canale
Target	Regione 5' UTR di HCV	FAM	HCV
Controllo interno	MS2	AP525	IC

## Matrici validate

› Plasma in EDTA o Plasma in ACD

› Siero

## Contenuto del kit

HCV ELITE MGB Mix		HCV ELITE Standard		HCV - ELITE Positive Control	HCV Internal Control
 X 4	 X 2	    X 1		 X 2	 X 8
HIV PCR Mix 4 provette da 600 µL 24 reazioni per provetta 96 reazioni per kit 5 cicli di congelamento/scongela-mento	RT EnzymeMix 2 provette da 20 µL 48 reazioni per provetta 96 reazioni per kit 10 cicli di congelamento/scongela-mento	Calibratori pronti per l'uso: 4 livelli 1 set di 4 provette da 160 µL 2 reazioni per provetta 2 reazioni per kit 2 cicli di congelamento/scongela-mento		Controllo positivo pronto all'uso 2 provette da 160 µL 4 reazioni per provetta 8 reazioni per kit 4 cicli di congelamento/scongela-mento	Controllo interno pronto all'uso 8 provette da 160 µL 12 estrazioni per provetta 96 estrazioni per kit 6 cicli di congelamento/scongela-mento

Validità massima: **18 mesi**

Temperatura di conservazione: **-20 °C**

## Altri prodotti richiesti ma non forniti nel kit

- › Strumento ELITE InGenius: INT030
- › Strumento ELITE BeGenius: INT040
- › Cartuccia per estrazione ELITE InGenius SP 1000: INT033SP1000
- › Cassetta per PCR ELITE InGenius: INT035PCR
- › Set di materiali di consumo ELITE InGenius SP200: INT032CS
- › Contenitore per rifiuti ELITE InGenius: F2102-000
- › Puntali con filtro 300 µL Axigen: TF-350-L-R-S (solo ELITE InGenius)
- › Puntali con filtro 1000 µL Tecan: 30180118 (solo ELITE BeGenius)

## Protocollo ELITE InGenius e ELITE BeGenius

› Volume del campione	600 µL	› Unità di risultati quantitativi	Unità Internazionali: IU/mL
› Volume di HCV CPE	10 µL		Copie: Copie/mL
› Volume eluizione totale	50 µL	› Fattore di conversione in IU	2,4 IU/copie
› Volume eluizione PCR	20 µL	› Frequenza dei controlli	15 giorni
› Volume miscela PCR completa	20 µL	› Frequenza di calibrazione	60 giorni



## Prestazioni di ELITE InGenius e ELITE BeGenius

Matrice	Limite di rilevazione	Sensibilità diagnostica: Correlazione tra i metodi	Specificità diagnostica
Plasma/siero	26 IU/mL 11 copie/ml	<b>R<sup>2</sup> = 0,905</b> <i>279 campioni quantificati</i>	<b>98,4%</b> <i>317 campioni confermati/322 campioni testati</i>

Metodi di riferimento:  
 "cobas® HCV for use on the 4800 Systems" e  
 "cobas® HCV for use on the 6800 Systems", Roche Diagnostics.

### Preparazione dei campioni

Questo prodotto è inteso per l'uso su **ELITE InGenius** e **ELITE BeGenius** con i seguenti campioni clinici, identificati secondo le linee guida del laboratorio e raccolti, trasportati e conservati nelle condizioni indicate di seguito.

Tipo di campione	Condizioni di trasporto/conservazione			
	16/26 °C (temperatura ambiente)	2/8 °C	-20 ±10 °C	-70 ±15 °C
Plasma raccolto in provette con EDTA	≤1 giorno	≤3 giorni	≤1 mese	≤6 mesi
Siero	≤1 giorno	≤5 giorni	≤1 mese	≤6 mesi

Non utilizzare il plasma raccolto in provette con eparina per prevenire l'inibizione della reazione di amplificazione e frequenti risultati non validi.

Non utilizzare plasma emolitico, perché l'emoglobina inibisce la reazione della PCR.

### Procedure ELITE InGenius

L'interfaccia grafica utente del programma ELITE InGenius software fornisce istruzioni passo-passo per configurare la sessione. Tutti i passaggi di estrazione, trascrizione inversa, Real-Time PCR e l'interpretazione dei risultati vengono eseguiti in automatico. Sono disponibili due modalità operative: sessione completa (Extract + PCR) o solo PCR (PCR Only).

#### Prima dell'analisi

1. Accendere ELITE InGenius. Inserire username e password. Selezionare la modalità "Closed"	2. Verificare i calibratori: <b>Q-PCR Standard</b> nel menu "Calibration". Verificare i controlli: <b>Positive Control</b> e <b>Negative Control</b> nel menu "Controls". <i>Nota: Tutti devono essere eseguiti, approvati e non scaduti</i>	3. Scongellare la <b>PCR Mix</b> e le provette <b>CTRCPE</b> . Mescolare delicatamente con agitatore vortex. Centrifugare per 5 s. Tenere la <b>RT EnzymeMix</b> in ghiaccio o nel blocco freddo.
4. Preparare la miscela di reazione completa come segue		5. Mescolare delicatamente con agitatore vortex. Centrifugare per 5 s. Tenere la miscela di reazione completa in ghiaccio o nel blocco freddo. Non esporre alla luce diretta.

Numero di campioni (N)	HCV PCR Mix	RT EnzymeMix
1 ≤ N ≤ 5	(N + 1) x 20 µL	(N + 1) x 0,3 µL
6 ≤ N ≤ 11	(N + 2) x 20 µL	(N + 2) x 0,3 µL
N = 12	290 µL	4,4 µL

#### Procedura 1 - Sessione completa: Extract + PCR (ad es. campioni)

1. Selezionare "Perform Run" sul touch screen	2. Verificare i volumi di estrazione: Ingresso: "1000 µL", eluizione: "50 µL"	3. Scansionare il codice a barre con l'apposito lettore manuale o digitare l'ID del campione
4. Selezionare l'"Assay Protocol" di interesse: HCV ELITE_PL_600_50 o HCV ELITE_Se_600_50	5. Selezionare il metodo "Extract + PCR" e la posizione del campione: Provetta contenente la soluzione di estrazione	6. Caricare la miscela di reazione completa e il controllo interno nell'Inventory Block
7. Caricare: PCR Cassette, cartuccia di estrazione, provetta di eluizione, cassetta puntali, rack provette di estrazione	8. Chiudere lo sportello. Avviare la sessione	9. Visualizzare, approvare e archiviare i risultati

**Nota:** Se è richiesta la modalità Extract Only, consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per la procedura.

## Procedura 2 - PCR Only (ad es. eluati, standard, controlli)

<b>1 - 4:</b> Seguire la Procedura 1 descritta sopra (selezionare gli Assay Protocol: HCV ELITE_PC e HCV ELITE_NC o HCV ELITE_STD)	<b>5.</b> Selezionare il metodo "PCR Only" e impostare la posizione del campione "Elution Tube"	<b>6.</b> Caricare la miscela di reazione completa nell'Inventory Block
<b>7.</b> Caricare: rack PCR Cassette e rack provette di eluizione con gli acidi nucleici estratti, standard o controlli	<b>8.</b> Chiudere lo sportello Avviare la sessione	<b>9.</b> Visualizzare, approvare e archiviare i risultati

## Procedure ELITE BeGenius

L'interfaccia grafica utente di ELITE BeGenius software fornisce istruzioni passo-passo per configurare la sessione. Tutti i passaggi di estrazione, Real-Time PCR e interpretazione dei risultati vengono eseguiti in automatico. Sono disponibili due modalità operative: sessione completa (Extract + PCR) o solo PCR (PCR Only).

### Prima dell'analisi

<b>1.</b> Accendere lo strumento ELITE BeGenius. Inserire username e password Selezionare la modalità "Closed"	<b>2.</b> Verificare i calibratori: <b>Q-PCR Standard</b> nel menu "Calibration" Verificare i controlli: <b>Positive Control</b> e <b>Negative Control</b> nel menu "Controls" <i>Nota:</i> Tutti devono essere eseguiti, approvati e non scaduti	<b>3.</b> Scongela la <b>PCR Mix</b> e le provette <b>CTRPE</b> Mescolare delicatamente con agitatore vortex Centrifugare per 5 s Tenere la <b>RT EnzymeMix</b> in ghiaccio o nel blocco freddo.
--	---	---

**4.** Preparare la miscela di reazione completa come segue

Numero di campioni (N)	HCV PCR Mix	RT EnzymeMix
$1 \leq N \leq 5$	$(N + 1) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 1) \times 0,3 \mu\text{L}$
$6 \leq N \leq 11$	$(N + 2) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 2) \times 0,3 \mu\text{L}$
$N = 12$	290 $\mu\text{L}$	4,4 $\mu\text{L}$
$13 \leq N \leq 18$	$(N + 3) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 3) \times 0,3 \mu\text{L}$
$19 \leq N \leq 23$	$(N + 4) \times 20 \mu\text{L}$	$(N + 4) \times 0,3 \mu\text{L}$
$N = 24$	580 $\mu\text{L}$	8,7 $\mu\text{L}$

**5.** Mescolare delicatamente con agitatore vortex  
Centrifugare per 5 s  
Tenere la miscela di reazione completa in ghiaccio o nel blocco freddo. Non esporre alla luce diretta.

### Procedura 1 - Sessione completa: Extract + PCR (ad es. campioni)

<b>1.</b> Selezionare "Perform Run" sul touch screen e fare clic sulla modalità di esecuzione «Extract+ PCR»	<b>2.</b> Inserire il rack campioni con i campioni con il codice a barre nella Cooler Unit. Il lettore di codici a barre è già attivo	<b>3.</b> Verificare i volumi di estrazione: Ingresso: "600 $\mu\text{L}$ ", Eluato: "50 $\mu\text{L}$ "
<b>4.</b> Selezionare l'"Assay Protocol" di interesse: HCV ELITE_Be_PL_600_50 oppure HCV ELITE_Be_Se_600_50  <b>Nota:</b> se si esegue una seconda estrazione, ripetere i passaggi da 2 a 4	<b>5.</b> Stampare le etichette per identificare con il codice a barre le provette di eluizione vuote. Caricare le provette nel rack di eluizione e inserirlo nella Cooler Unit.	<b>6.</b> Caricare la miscela di reazione completa e il <b>CPE</b> nel rack reagenti/di eluizione e inserirlo nella Cooler Unit.
<b>7.</b> Caricare il "PCR Rack" con la "PCR Cassette" e l'"Extraction Rack" con le cartucce di estrazione "ELITE InGenius SP 1000" e i materiali di consumo per l'estrazione richiesti.	<b>8.</b> Chiudere lo sportello. Avviare la sessione	<b>9.</b> Visualizzare, approvare e archiviare i risultati

**Nota:** Se è richiesta la modalità Extract Only, consultare il manuale d'istruzioni dello strumento per la procedura.

## Procedura 2 - PCR Only (ad es. eluati, standard, controlli)

1. Selezionare "Perform Run" sul touch screen e fare clic sulla modalità di esecuzione «PCR Only»	2. Caricare le provette di acidi nucleici estratti o standard o controlli nel rack di eluizione e inserirlo nella Cooler Unit	3. Verificare i volumi di estrazione: Ingresso: "600 µL", Eluato: "50 µL"
4. Selezionare l'"Assay Protocol" di interesse (HCV ELITe_Be_PC e HCV ELITe_Be_NC o HCV ELITe_Be_STD)	5. Caricare la miscela di reazione completa nel rack del reagente e inserirlo nella Cooler Unit	6. Caricare il "PCR Rack" con la "PCR Cassette".
7. Chiudere lo sportello. Avviare la sessione	8. Visualizzare, approvare e archiviare i risultati	