Instructions for use

EBV ELITe MGB® Kit

Reagenzien für die DNA-Real-Time-PCR

REF RTS020PLD

UDI 08033891483579

CE 0123

IVD

ÄNDERUNGSVERLAUF

Rev.	Änderungsvermerk	Datum (TT.MM. JJJJ)
24–R	Erweiterung der Verwendung des Produkts in Verbindung mit den Geräten ELITe InGenius® und ELITe BeGenius® und der Matrix Liquor. Abschnitt „Hinweis an den Käufer: eingeschränkte Lizenz“ aktualisiert. Assay-Protokolle für die Geräte ELITe InGenius® (Art.-Nr. INT030) und ELITe BeGenius® (Art.-Nr. INT040) auf „Model 2 Version 4.0.2“ aktualisiert.	03/03/ 2026
23–R	Verwendung des Produkts in Verbindung mit dem Gerät MyGenius PRO (Art.-Nr. INT050) mit Vollblut-Matrix erweitert.	08/10/ 2025
22–R	Aufnahme des Extraktionskits ELITe InGenius SP 1000 (Art.-Nr. INT033SP1000) und der zugehörigen Daten im Zusammenhang mit Plasma und ELITe InGenius mit dem Protokoll „1000 in 100“. Aktualisierung der analytischen und diagnostischen Leistung im Abschnitt „LEISTUNGSMERKMALE“ (LoD linearer Messbereich, diagnostische Sensitivität und Spezifität) Aktualisierung des Abschnitts „Symbole“ mit dem Symbol „Gebrauchsanweisung beachten“	04/03/ 2025
21–R	Aktualisierung zur Einhaltung der Anforderungen der IVD-Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-Diagnostika. Aktualisierung der verbesserten analytischen und diagnostischen Leistungen im Abschnitt „LEISTUNGSMERKMALE“. Aktualisierung des Verwendungszwecks. Neue grafische und inhaltliche Gestaltung der Gebrauchsanweisung.	29/08/ 2024
20	Beschreibung des IC-Grenzwerts im Abschnitt: Diagnostische Spezifität	22/12/ 2022
19	Änderung des ULoQ-Werts bei Vollblutproben in Verbindung mit dem Gerät ELITe InGenius.	01/04/ 2022
18	Erweiterte Verwendung auf dem automatisierten und integrierten Gerät ELITe BeGenius	30/09/ 2021
17	Hinzufügung von in Verbindung mit dem Roche cobas z 480 analyzer erhaltenen Analysedaten (LoD, Linearität usw.)	07/05/ 2020
00 — 16	Neuproduktentwicklung und nachfolgende Änderungen	-

INHALTSVERZEICHNIS

1 VERWENDUNGSZWECK. 4
2 TESTPRINZIP 4
3 BESCHREIBUNG DES PRODUKTS 4
4 MIT DEM PRODUKT BEREITGESTELLTE MATERIALIEN 5
5 ERFORDERLICHE, ABER NICHT MITGELIEFERTE MATERIALIEN 5
6 ANDERE ERFORDERLICHE PRODUKTE 5
7 WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN 7
8 PROBEN UND KONTROLLEN bei ELITe InGenius, ELITe BeGenius UND MyGenius PRO 9
9 VERFAHREN BEI ELITe InGenius 14
10 VERFAHREN BEI ELITe BeGenius 21
11 VERFAHREN BEI MyGenius PRO 27
12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO 33
13 PROBEN UND KONTROLLEN BEI ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument 47
14 VERFAHREN BEIM ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument 48
15 LEISTUNGSMERKMALE BEI ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument 53
16 REFERENZEN 56
17 GRENZEN DES VERFAHRENS 57
18 FEHLERBEHEBUNG 58
19 SYMBOLE 65
20 ANWENDERHINWEISE 65
21 HINWEIS FÜR DEN KÄUFER: EINGESCHRÄNKTE LIZENZ 66
Appendix A QUICK START GUIDE 67
Appendix B QUICK START GUIDE 72
Appendix C QUICK START GUIDE 75

1 VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt **EBV ELITe MGB® Kit** ist ein *In-vitro*-Diagnostikum, das für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal als quantitativer Nukleinsäure- und Real-Time-PCR-Assay zum Nachweis und zur Quantifizierung der **DNA des Epstein-Barr-Virus (EBV)**, die aus klinischen Proben extrahiert wurde, bestimmt ist.

Dieser Assay ist in Verbindung mit den Geräten **ELITe InGenius®** und**ELITe BeGenius®**, automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut, in EDTA entnommenem Plasma und Liquor, validiert.

Dieser Assay ist auch in Verbindung mit dem Gerät **MyGenius PRO®** (eingetragener Name: ELIVERSE®), einem automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen, in EDTA entnommenen Vollblutproben, validiert.

Außerdem ist der Assay in Verbindung mit **ELITe GALAXY**, einem System für die automatische Extraktion und PCR-Einstellung, und dem **7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument**, einer Real-Time PCR-Plattform, für die Verwendung von humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut validiert.

Das Produkt ist zur Verwendung als Hilfsmittel bei der Diagnose und Überwachung von EBV-Infektionen bei Patienten bestimmt, bei denen Verdacht auf eine EBV-Infektionen besteht oder die auf EBV-Infektionen überwacht werden.

Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen alle relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunde herangezogen werden.

2 TESTPRINZIP

Der Assay ist eine quantitative Real-Time-PCR für den Nachweis von EBV-DNA, die aus Proben isoliert und mit dem Testreagenz **EBV Q - PCR Mix**, das Primer und ELITe MGB®-Technologie-Sonden enthält, amplifiziert wurde.

Die ELITe MGB-Sonden werden aktiviert, wenn sie mit den jeweiligen PCR-Produkten hybridisieren. **ELITe InGenius**, die Geräte **ELITe BeGenius** und **MyGenius PRO** überwachen den Fluoreszenzanstieg und berechnen die Schwellenwertzyklen (Ct) sowie die Schmelztemperaturen (Tm). Die Berechnung der EBV-Menge erfolgt auf der Grundlage einer gespeicherten Kalibrationskurve.

7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument misst den Anstieg der Fluoreszenzemission und zeichnet ihn auf. Die anschließende Datenverarbeitung ermöglicht den Nachweis und die Quantifizierung von EBV in der Primärprobe.

Bei den ELITe MGB-Sonden werden die Fluorophore im spiralförmig gefalteten, einzelsträngigen Zustand der Sonde gequencht. Die Fluorophore sind in der Sonden/Amplicon-Duplex aktiv, da der Quencher räumlich von dem Fluorophor getrennt ist. Es ist zu beachten, dass das Fluorophor während der PCR nicht abgespalten wird und für die Dissoziationsanalyse und die Berechnung der Schmelztemperatur verwendet werden kann.

3 BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Das **EBV ELITe MGB Kit** enthält das Assay-Reagenz **EBV Q-PCR Mix**, ein optimiertes und stabilisiertes PCR-Gemisch, das die spezifischen Primer und Sonden enthält für:

- eine Region des **EBNA-1-Gens** von EBV, nachgewiesen in Kanal **EBV**; die Sonde ist durch den MGB stabilisiert, mit dem Eclipse Dark Quencher® gequencht und mit einem FAM-Farbstoff markiert.
- Die Internal Control, die für die **Promoter- und 5'-UTR-Region** des **humanen beta-Globin-Gens** spezifisch ist, nachgewiesen in Kanal **IC**; die Sonde ist durch den MGB stabilisiert, mit dem Eclipse Dark Quencher gequencht und mit dem Farbstoff AquaPhluor® 525 (AP525) markiert.

Der **EBV Q-PCR Mix** enthält außerdem Puffer, Magnesiumchlorid, Triphosphatnukelotide, AP593-Fluorophor (anstelle von ROX oder Cy5 als Passivreferenz für die Fluoreszenz-Normalisierung verwendet), das Enzym Uracil-N-Glycosidase (UNG) zur Inaktivierung der Kontamination durch das Amplifikationsprodukt sowie das „Warmstart“-DNA-Polymerase-Enzym.

Das Produkt **EBV ELITe MGB Kit** enthält ausreichend Reagenzien für **96 Tests** mit **ELITe InGenius**, **ELITe BeGenius** und **MyGenius PRO**, wobei **20** µl pro Reaktion verwendet werden.

Das Produkt **EBV ELITe MGB Kit** enthält ausreichend Material für **100 Tests auf anderen Systemen**, wobei **20** µl pro Reaktion verwendet werden.

HINWEIS!
Ein Umrechnungsfaktor wird benötigt, um die Ergebnisse der quantitativen EBV-Analyse in internationalen Einheiten gemäß dem „1st WHO International Standard for Human Epstein Barr Virus for Nucleic Acid Amplification Techniques“ (NIBSC-Code 09/260, Vereinigtes Königreich) auszudrücken.

4 MIT DEM PRODUKT BEREITGESTELLTE MATERIALIEN

Tabelle 1

Komponente	Beschreibung	Menge	Gefahrenklasse
EBV Q-PCR Mix Art.-Nr. RTS020PLD	Gemisch aus Reagenzien für die Real-Time-PCR in Röhrchen mit NATURFARBENEM Verschluss	**4 x 540 µl**	**-**

5 ERFORDERLICHE, ABER NICHT MITGELIEFERTE MATERIALIEN

- Laminar-Flow-Haube.
- Puderfreie Einweghandschuhe aus Nitril oder einem ähnlichen Material.
- Vortex-Mixer.
- Tischzentrifuge (~5.000 U/min).
- Tisch-Mikrozentrifuge (~13.000 U/min).
- Mikropipetten und sterile Spitzen mit Aerosolfilter oder sterile Direktverdrängerspitzen (Volumenbereich: 0,5–1000 µl).
- Sterile 2,0-ml-Röhrchen mit Schraubverschluss (Sarstedt, Deutschland, Art.-Nr. 72.694.005).
- Sterile 0,5-ml-Röhrchen mit Schraubverschluss (Sarstedt, Deutschland, Art.-Nr. 72.730.005)
- Hochreines Wasser für die Molekularbiologie.

6 ANDERE ERFORDERLICHE PRODUKTE

Die Reagenzien für die Extraktion der Proben-DNA, die interne Extraktions- und Inhibitionskontrolle, die Amplifikations-Positiv- und Negativkontrolle, die DNA-Standards und die Verbrauchsmaterialien **sind nicht** in diesem Produkt enthalten.

Für die Nukleinsäureextraktion, Echtzeit-PCR und Ergebnisinterpretation von Proben werden die folgenden Produkte benötigt:

Tabelle 2

Geräte und Software	Produkte und Reagenzien
ELITe InGenius (ELITechGroup S.p.A., EG SpA, Art.-Nr. INT030) **ELITe InGenius Software**, Version 1.3.0.19 (oder später) **EBV ELITe_STD**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Kalibratorenanalyse **EBV ELITe _PC**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Positive Control-Analyse **EBV ELITe _NC**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Negative Control-Analyse **EBV ELITe_STD_1000_100** , Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Kalibratorenanalyse (nur für Plasmaproben, Probenvolumen 1000 µl) **EBV ELITe _PC_1000_100**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Positive Control-Analyse (nur für Plasmaproben, Probenvolumen 1000 µl) **EBV ELITe _NC_1000_100**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Negative Control-Analyse (nur für Plasmaproben, Probenvolumen 1000 µl) **EBV ELITe_WB_200_100** , Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Vollblutproben-Analyse **EBV ELITe_PL_200_100** , Assay Protocols (Assay-Protokolle) mit Parameter für die Plasmaproben-Analyse **EBV ELITe_PL_1000_100** , Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parameter für die Plasmaproben-Analyse **EBV ELITe_CSF_200_100**, Assay Protocols (Assay-Protokolle) mit Parametern für die Liquorproben-Analyse	**EBV ELITe Standard** (EG SpA, Art.-Nr. STD020PLD) **EBV - ELITe Positive Control** (EG SpA, Art.-Nr. CTR020PLD) **CPE - Internal Control** (EG SpA, Art.-Nr. CTRCPE) **ELITe InGenius SP 200** (EG SpA, Art.-Nr. INT032SP200) **ELITe InGenius SP1000** (EG SpA., Art.-Nr. INT033SP1000) **ELITe InGenius** und **ELITe BeGenius** Verbrauchsmaterialien (siehe ELITe InGenius und ELITe BeGenius Gebrauchsanweisung)
ELITe BeGenius (EG SpA, Art.-Nr. INT040) **ELITe BeGenius Software**, Version 2.3.0 (oder später) **EBV ELITe_Be_STD**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Kalibratorenanalyse **EBV ELITe_Be_PC**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Positive Control-Analyse **EBV ELITe_Be_NC**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Negative Control-Analyse **EBV ELITe_Be_WB_200_100**,Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Vollblutproben-Analyse **EBV ELITe_Be_PL_200_100**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Plasmaproben-Analyse **EBV ELITe_Be_CSF_200_100**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Liquorproben-Analyse	

Tabelle 2 (continued)

Geräte und Software	Produkte und Reagenzien
MyGenius PRO (EG SpA Art.-Nr.: INT050). **MyGenius PRO** Software, Version BB-04 (oder später) **EBV ELITe_My_STD**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Kalibratorenanalyse **EBV ELITe_My_PC**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Positive Control-Analyse **EBV ELITe_My_NC**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Negative Control-Analyse **EBV ELITe_My_WB_IU_200_100**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Vollblutproben-Analyse und Ergebnissen in IU/ml **EBV ELITe_My_WB_cmL_200_100**, Assay Protocol (Assay-Protokoll) mit Parametern für die Vollblutproben-Analyse und Ergebnissen in Kopien/ml	**EBV ELITe Standard** (EG SpA, Art.-Nr. STD020PLD) **EBV - ELITe Positive Control** (EG SpA, Art.-Nr. CTR020PLD) **Negative Control** (EG SpA, Art.-Nr. CTRNEG) **Internal Control Maxi** (EG SpA, Art.-Nr. ICMAXI) **MyGenius PRO** Verbrauchsmaterialien (siehe MyGenius PRO Gebrauchsanweisung)
7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument (ThermoFisher Scientific, Art.-Nr. 4406985) **ELITe GALAXY** (EG SpA, Art.-Nr. INT020) mit **Software, Version 1.3.1** (oder später). Extraktionsprotokoll für ELITe GALAXY, xNA Extraction (Universal)	**EBV ELITe Standard** (EG SpA, Art.-Nr. STD020PLD) **EBV - ELITe Positive Control** (EG SpA, Art.-Nr. CTR020PLD) **CPE - Internal Control** (EG SpA, Art.-Nr. CTRCPE) **ELITe GALAXY 300 Extraction Kit** (EG SpA, Art.-Nr. INT021EX) **ELITe GALAXY** Verbrauchsmaterialien (siehe ELITe GALAXY Gebrauchsanweisung) **MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL** (Life Technologies, Art.-Nr. 4346906), Mikrotiterplatten mit 0,1-ml-Vertiefungen und selbsthaftenden Dichtungsfolien für die Echtzeit-Amplifikation.

7 WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt ist nur für den In-vitro-Gebrauch bestimmt.

7.1 Allgemeine Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Alle biologischen Proben sind so zu handhaben und zu entsorgen, als wären sie infektiös. Direkten Kontakt mit biologischen Proben vermeiden. Verspritzen und Aerosolbildung vermeiden. Röhrchen, Spitzen und andere Materialien, die mit den biologischen Proben in Kontakt kommen, müssen vor der Entsorgung mindestens 30 Minuten lang mit 3%igem Natriumhypochlorit (Bleiche) behandelt oder eine Stunde lang bei 121 °C autoklaviert werden.

Alle zur Durchführung des Tests verwendeten Reagenzien und Materialien sind so zu handhaben und zu entsorgen, als wären sie infektiös. Direkten Kontakt mit den Reagenzien vermeiden. Verspritzen und Aerosolbildung vermeiden. Abfall ist unter Einhaltung angemessener Sicherheitsstandards zu handhaben und zu entsorgen. Brennbares Einwegmaterial muss verbrannt werden. Saurer und basischer Flüssigabfall muss vor der Entsorgung neutralisiert werden. Extraktionsreagenzien dürfen nicht mit Natriumhypochlorit (Bleiche) in Kontakt kommen.

- Geeignete Schutzkleidung und Handschuhe zum Schutz der Augen und des Gesichts tragen.
- Lösungen niemals mit dem Mund pipettieren,
- Essen, Trinken, Rauchen und Schminken sind in den Arbeitsbereichen verboten.
- Die Hände nach der Handhabung von Proben und Reagenzien gründlich waschen.
- Übrig gebliebene Reagenzien und Abfälle gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.
- Vor der Durchführung des Assays alle bereitgestellten Anweisungen aufmerksam lesen.

- Bei der Durchführung des Tests die bereitgestellten Produktanweisungen befolgen.
- Das Produkt darf nach Ablauf des angegebenen Ablaufdatums nicht mehr verwendet werden.
- Es dürfen nur mit dem Produkt bereitgestellte und vom Hersteller empfohlene Reagenzien verwendet werden.
- Reagenzien von anderen Chargen dürfen nicht verwendet werden.
- Keine Reagenzien anderer Hersteller verwenden.

7.2 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Molekularbiologie

Molekularbiologische Verfahren dürfen nur von qualifizierten und geschulten Fachkräften durchgeführt werden, um fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden, insbesondere im Hinblick auf den Nukleinsäureabbau in den Proben oder die Probenkontamination durch PCR-Produkte.

Bei manueller Einrichtung des Amplifikationslaufs ist eine räumliche Trennung von Extraktion/Vorbereitung der Amplifikationsreaktionen und Amplifikation/Detektion von Amplifikationsprodukten zu beachten. Niemals ein Amplifikationsprodukt in den für die Extraktion/Vorbereitung von Amplifikationsreaktionen vorbehaltenen Bereich einführen.

Bei manueller Einrichtung des Amplifikationslaufs müssen Laborkittel, Schutzhandschuhe und Hilfsmittel vorhanden sein, die ausschließlich für die Extraktion/Vorbereitung der Amplifikationsreaktionen und für die Amplifikation/Detektion von Amplifikationsprodukten verwendet werden.

Niemals Laborkittel, Schutzhandschuhe oder Hilfsmittel aus dem für die Amplifikation / den Nachweis von Amplifikationsprodukten vorbehaltenen Bereich in den für die Extraktion/Vorbereitung der Amplifikationsreaktionen vorbehaltenen Bereich bringen.

Es werden Laborkittel, Handschuhe und Werkzeuge benötigt, die speziell für den jeweiligen Arbeitslauf vorgesehen sind.

Die Proben müssen geeignet und möglichst für diese Art der Analyse bestimmt sein. Proben müssen unter einer Laminar-Flow-Haube gehandhabt werden. Die zur Verarbeitung der Proben verwendeten Pipetten dürfen ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden. Die Pipetten müssen entweder Direktverdrängungspipetten sein oder zusammen mit Aerosolfilterspitzen verwendet werden. Die verwendeten Spitzen müssen steril und sowohl DNase- und RNase-frei als auch DNA- und RNA-frei sein.

Die Reagenzien müssen unter einer Sicherheitswerkbank gehandhabt werden. Die Pipetten, die für die Handhabung der Reagenzien verwendet werden, dürfen nur für diesen Zweck verwendet werden. Die Pipetten müssen entweder Direktverdrängungspipetten sein oder zusammen mit Aerosolfilterspitzen verwendet werden. Die verwendeten Spitzen müssen steril, frei von DNasen und RNasen sowie frei von DNA und RNA sein.

Die Extraktionsprodukte müssen so verwendet werden, dass eine Freisetzung in die Umgebung verhindert und eine Kontamination des Arbeitsbereichs des Geräts vermieden wird.

Die PCR-Kassette (PCR Cassette) muss vorsichtig behandelt werden und darf niemals geöffnet werden, um eine Diffusion von PCR-Produkten in die Umgebung und eine Verschleppungskontamination zu verhindern.

7.3 Komponentenspezifische Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Tabelle 3

Komponente	Umgebungs-temperatur bei Lagerung	Haltbarkeit nach Anbruch	Gefrier- und Auftauzyk-len	On-Board-Stabilität (ELITe InGenius und ELITe BeGenius)	On-Board-Stabilität (MyGenius PRO)
EBV Q-PCR Mix	-20°C oder darunter (lichtgeschützt)	einen Monat	bis zu fünf	bis zu fünf separate* Läufe von je drei Stunden oder bis zu 7 aufeinanderfolgende Stunden (2 Läufe von je 3 Stunden und die Zeit, die für den Beginn eines dritten Laufs benötigt wird)	bis zu 7 aufeinanderfolgende Stunden oder fünfmal für bis zu 3 aufeinanderfolgende Stunden*

* mit zwischenzeitlichem Gefrierzyklus

8 PROBEN UND KONTROLLEN bei ELITe InGenius, ELITe BeGenius UND MyGenius PRO

8.1 Proben und Assay-Protokolle

Dieses Produkt ist zur Verwendung mit dem **ELITe InGenius**, **ELITe BeGenius** und **MyGenius PRO** mit den folgenden validierten klinischen Proben, die gemäß den Laborrichtlinien identifiziert und gehandhabt und unter den folgenden Bedingungen entnommen, transportiert und aufbewahrt wurden, bestimmt:

Probe	**Anforderungen an die Entnahme**	**Transport-/Lagerbedingungen**			
		+16 / +26 °C (Raumtemperatur)	**+2 / +8 °C**	**-20 ± 10 °C**	**-70 ± 15 °C**
Vollblut	EDTA	≤ 1 d	≤ 3 d	≤ 30 d	≤ 30 d
Plasma	EDTA	≤ 1 d	≤ 3 d	≤ 30 d	≤ 30 d
Liquor	Minimale Patienten-blut-Kontamination	≤ 1 d	≤ 2 d	≤ 30 d	≤ 30 d

EDTA, Ethylendiamintetraessigsäure; CSF, Liquor; d, Tag.

Auch wenn eine länger Aufbewahrung bei -70 °C möglich ist, wie in der wissenschaftlichen Literatur ausführlich berichtet, sollte eine derartige Anwendung intern von den Endbenutzern des Produkts beurteilt werden.

Es wird empfohlen, die Proben vor dem Einfrieren in Aliquote aufzuteilen, um wiederholten Gefrier- und Auftauzyklen vorzubeugen. Bei Verwendung von gefrorenen Proben müssen die Proben vor der Extraktion aufgetaut werden, um einen möglichen Nukleinsäureabbau zu vermeiden.

Zum Testen von Proben mit dem **ELITe InGenius** und dem **ELITe BeGenius** müssen die folgenden Assay-Protokolle (Assay Protocol) verwendet werden. Diese IVD-Protokolle wurden speziell mit ELITe MGB Kits und **ELITe InGenius** bzw. **ELITe BeGenius** mit den angegebenen Matrizes validiert.

Tabelle 4 Assay-Protokolle (Assay Protocols) für EBV ELITe MGB Kit und ELITe InGenius und ELITe BeGenius

Probe	Instrument	Name des Assay-Protokolls	Melden Sie	Eigenschaften
Vollblut in EDTA	ELITe InGenius	EBV ELITe_WB_200_100	Kopien/ml oder IU/ml	Extraktion Eingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Beschallung: KEINE Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl
	ELITe BeGenius	EBV ELITe_Be_WB_200_100	Kopien/ml oder IU/ml	Extraktion Eingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl
Plasma in EDTA	ELITe InGenius	EBV ELITe_PL_200_100	Kopien/ml oder IU/ml	Extraktion Eingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Beschallung: KEINE Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl
	ELITe InGenius	EBV ELITe_PL_1000_100	Kopien/ml oder IU/ml	Extraktionseingangsvolumen: 1000 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Beschallung: KEINE Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl
	ELITe BeGenius	EBV ELITe_Be_PL_200_100	Kopien/ml oder IU/ml	Extraktion Eingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl

Tabelle 4 Assay-Protokolle (Assay Protocols) für EBV ELITe MGB Kit und ELITe InGenius und ELITe BeGenius (continued)

Probe	Instrument	Name des Assay-Protokolls	Melden Sie	Eigenschaften
Liquor	ELITe InGenius	EBV ELITe_CSF_200_100	Kopien/ml oder IU/ml	Extraktionseingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Beschallung: KEINE Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl
	ELITe BeGenius	EBV ELITe_Be_CSF_200_100	Kopien/ml oder IU/ml	Extraktionseingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl

IU: internationale Einheiten

Zum Testen von Proben mit dem **MyGenius PRO** müssen die folgenden Assay-Protokolle (Assay Protocol) verwendet werden. Diese IVD-Protokolle wurden speziell mit ELITe MGB Kits und **MyGenius PRO** mit den angegebenen Matrizes validiert.

Tabelle 5 Assay-Protokolle (Assay Protocols) für EBV ELITe MGB Kit und MyGenius PRO

Probe	Instrument	Name des Assay-Protokolls	Melden Sie	Eigenschaften
Vollblut in EDTA	MyGenius PRO	EBV ELITe_My_WB_IU_200_100	IU/ml	Extraktionseingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Beschallung: KEINE Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl
Vollblut in EDTA	MyGenius PRO	EBV ELITe_My_WB_cmL_200_100	Kopien/ml	Extraktionseingangsvolumen: 200 µl Extrahiertes Elutionsvolumen: 100 µl Interne Kontrolle: 10 µl Verdünnungsfaktor: 1 Volumen PCR-Mix: 20 µl Eingangsvolumen Proben-PCR: 20 µl

HINWEIS!

Überprüfen Sie, ob das Primärröhrchen und das Probenvolumen mit ELITe InGenius, ELITe BeGenius oder MyGenius PRO kompatibel sind, und befolgen Sie dabei die Gebrauchsanweisung der Geräte.

Das Volumen der Probe in einem Primärröhrchen variiert je nach Art des geladenen Röhrchens. Weitere Informationen zur Einrichtung und Durchführung des Extraktionsverfahrens sind der Gebrauchsanweisung des Extraktionskits zu entnehmen.

Falls erforderlich, müssen 200 µl Probe in ein Extraction Tube (Extraktionsröhrchen) (bei ELITe InGenius) oder ein 2-ml-Sarstedt-Röhrchen (bei ELITe BeGenius) und 260 µl Probe in ein 2-ml-Sarstedt-Röhrchen (bei MyGenius PRO) überführt werden.

HINWEIS!

Das Pipettieren in das **Extraction Tube** (Extraktionsröhrchen) oder das **2-ml-Sarstedt-Röhrchen** kann **Kontamination verursachen.** Die geeigneten Pipetten verwenden und alle unter 7 WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN page 7 aufgeführten Empfehlungen befolgen.

Aufgereinigte Nukleinsäuren können bei Raumtemperatur 16 Stunden und bei -20 °C oder darunter höchstens einen Monat aufbewahrt werden.

Daten zu störenden Substanzen sind im Abschnitt „12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO page 33“ unter „Potenziell interferierende Substanzen“ aufgeführt.

HINWEIS!

Keine Proben verwenden, die in Heparin entnommen wurden, da dieses bekanntlich die reverse Transkription und PCR hemmt.

8.2 PCR-Kalibratoren und -Kontrollen

Für jede Charge des PCR-Reagenzes muss die Kalibrationskurve erstellt und genehmigt werden.

- Für die Kalibrationskurve die vier Konzentrationen des Produkts **EBV ELITe Standard** (nicht im Lieferumfang dieses Kits enthalten) mit dem Assay-Protokoll **EBV ELITe_STD**, **EBV ELITe_STD_1000_100**, **EBV ELITe_Be_STD** oder **EBV ELITe_My_STD** verwenden.

HINWEIS!

Die Konzentrationen der Q – PCR Standards sind in Kopien/Reaktion (10^5 Kopien/Reaktion, 10^4 Kopien/Reaktion, 10^3 Kopien/Reaktion, 10^2 Kopien/Reaktion) ausgedrückt. Siehe „Unsicherheit der Standardkurve“ in Abschnitt 12,12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe page 33.

Die Ergebnisse der PCR-Kontrollen müssen für jede Charge des PCR-Reagenzes erstellt und genehmigt werden.

- Für die Positive Control das Produkt **EBV - ELITe Positive Control** (nicht in diesem Kit enthalten) mit dem Assay-Protokoll **EBV ELITe_PC**, **EBV ELITe_PC_1000_100, EBV ELITe_Be_PC** oder **EBV ELITe_My_PC** verwenden.
- Für die Negative Control hochreines Wasser für die Molekularbiologie (nicht in diesem Kit enthalten) mit den Assay-Protokollen **EBV ELITe_NC**, **EBV ELITe_NC_1000_100** und **EBV ELITe_Be_NC** verwenden oder **Negative Control** (nicht im Lieferumfang dieses Kits enthalten) mit den Assay-Protokollen **EBV ELITe_My_NC** verwenden.

HINWEIS!

ELITe InGenius, **ELITe BeGenius** und **MyGenius PRO** ermöglichen die Erstellung und Speicherung der Kalibrationskurve und die Validierung der PCR-Kontrollen für jede PCR-Reagenziencharge.

Kalibrierungskurven verfallen nach **60 Tagen**, danach muss die Kalibration erneut durchgeführt werden.

Die Ergebnisse der PCR-Kontrollen verfallen nach **15 Tagen**, danach müssen die Positive Control und die Negative Control erneut durchgeführt werden.

Die Kalibratoren und PCR-Kontrollen müssen erneut generiert werden, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- eine neue Reagenziencharge wird verwendet,
- die Ergebnisse der Qualitätskontrollanalyse (siehe nächster Abschnitt) liegen außerhalb der Spezifikation,
- eine größere Wartungs- oder Instandhaltungsmaßnahme an den Geräten **ELITe InGenius**, **ELITe BeGenius** und **MyGenius PRO** durchgeführt wird.

8.3 Qualitätskontrollen

Es wird empfohlen, das Extraktions- und PCR-Verfahren zu überprüfen. Es können archivierte Proben oder zertifiziertes Referenzmaterial verwendet werden. Externe Kontrollen sind gemäß den einschlägigen Anforderungen der lokalen, staatlichen und föderalen Akkreditierungsorganisationen zu verwenden.

9 VERFAHREN BEI ELITe InGenius

Das beim Gebrauch des **EBV ELITe MGB Kit** mit dem **ELITe InGenius** anzuwendende Verfahren besteht aus drei Schritten:

Tabelle 6

SCHRITT 1	Prüfung der Systembereitschaft	
SCHRITT 2	Einrichtung des Laufs	A) Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])
		B) Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR])
		C) Kalibrationslauf (PCR Only [nur PCR])
		D) Lauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR])
SCHRITT 3	Überprüfung und Genehmigung der Ergebnisse	1) Validierung der Kalibrationskurve
		2) Validierung der Ergebnisse der Positive Control und Negative Control
		3) Validierung der Probenergebnisse
		4) Ausgabe des Probenergebnisberichts

9.1 SCHRITT 1 – Prüfung der Systembereitschaft

Vor Beginn des Laufs:

- **ELITe InGenius** einschalten und den Modus „**CLOSED**“ (geschlossen) auswählen,
- auf der Startseite im Menü „Calibration“ (Kalibration) bestätigen, dass die Kalibratoren (**Q - PCR Standard**) für die zu verwendende Charge des **PCR Mix** genehmigt und gültig (Status) sind. Wenn keine gültigen Kalibratoren für die Charge **PCR Mix** verfügbar sind, Kalibration wie in den folgenden Abschnitten beschrieben durchführen,
- auf der Startseite im Menü „Controls“ (Kontrollen) bestätigen, dass die PCR-Kontrollen (**Positive Control**, **Negative Control**) für die zu verwendende Charge des **PCR Mix** genehmigt und gültig (Status) sind. Wenn keine gültigen PCR-Kontrollen für die Charge **PCR Mix** verfügbar sind, die PCR-Kontrollen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben durchführen,
- Den Typ des Laufs auswählen, dazu die Anweisungen auf der grafischen Benutzeroberfläche zur Einrichtung des Laufs befolgen und die von EG SpA bereitgestellten Assay-Protokolle verwenden (siehe „Proben und Kontrollen“).

Falls das betreffende Assay Protokoll nicht im System geladen ist, wenden Sie sich an Ihren ELITechGroup Kundendienstvertreter vor Ort.

9.2 SCHRITT 2 – Einrichtung des Laufs

Das **EBV ELITe MGB Kit** kann auf **ELITe InGenius** für die folgenden Läufe verwendet werden:

A. Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR]),

B. Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR]),

C. Kalibrationslauf (PCR Only [nur PCR]),

D. Lauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR]).

Alle benötigten Parameter sind in den auf dem Gerät verfügbaren Assay Protokollen enthalten und werden bei Auswahl des Assay Protokolls automatisch geladen.

HINWEIS!
ELITe InGenius kann mit dem „Laboratory Information System“ (Laborinformationssystem – LIS) verbunden werden, worüber die Laufinformationen heruntergeladen werden können. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

Vor dem Einrichten eines Laufs:

Die benötigten **PCR Mix**-Röhrchen 30 Minuten auf Raumtemperatur auftauen. Jedes Röhrchen reicht aus für **24 Tests**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.

HINWEIS!
Den **PCR Mix** lichtgeschützt auftauen lassen, da dieses Reagenz lichtempfindlich ist.

Zum Einrichten eines der vier Lauftypen die folgenden Schritte unter Beachtung der grafischen Benutzeroberfläche ausführen:

	A. Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])	**B. Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR])**
1	**Proben identifizieren** und, falls erforderlich, auf Raumtemperatur auftauen, vorsichtig mischen, den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Falls erforderlich, 200 µl oder 1000 µl Probe in ein zuvor etikettiertes Extraction Tube (Extraktionsröhrchen) überführen. Die benötigten **CPE-Röhrchen** 30 Minuten auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Jedes Röhrchen reicht aus für 12 Extraktionen.	**Elution Tube** (Elutionsröhr) mit den extrahierten Nukleinsäuren auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.
2	Auf der Startseite „**Perform Run**“ (Lauf durchführen) auswählen.	Auf der Startseite „**Perform Run**“ (Lauf durchführen) auswählen.
3	Sicherstellen, dass das „Extraction Input Volume“ (Extraktion Eingangsvolumen) 200 µl bzw. 1000 µl und das „Extracted Elute Volume“ (Extrahiertes Eluatvolumen) 100 µl beträgt.	Sicherstellen, dass das „Extraction Input Volume“ (Extraktion Eingangsvolumen) 200 µl bzw. 1000 µl und das „Extracted Elute Volume“ (Extrahiertes Eluatvolumen) 100 µl beträgt.
4	Für jede Probe eine Spur zuweisen und unter „SampleID“ (SID) die Proben-ID eingeben oder den Proben-Barcode einscannen.	Für jede Probe eine Spur zuweisen und unter „SampleID“ (SID) die Proben-ID eingeben oder den Proben-Barcode einscannen.
5	Das **Assay Protocol** (Assay-Protokoll) in der Spalte „Assay“ (Prüfung) **auswählen** (siehe „Proben und Kontrollen“).	Das **Assay Protocol** (Assay-Protokoll) in der Spalte „Assay“ (Prüfung) auswählen (siehe „Proben und Kontrollen“).
6	Sicherstellen, dass unter „Protocol“ (Protokoll) Folgendes angezeigt wird: „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR).	In der Spalte „Protocol“ (Protokoll) „PCR Only“ (nur PCR) auswählen.
7	Als Proben-Ladeposition „Primary Tube“ (Primärröhrchen) oder „Extraction Tube“ (Extraktionsröhrchen) in der Spalte „Sample Position“ (Probenposition) auswählen. Sicherstellen, dass der Verdünnungsfaktor (**Dilution factor**) „**1**“ beträgt.	Sicherstellen, dass die Ladeposition der Probe in der Spalte „Sample Position“ (Probenposition) „Elution Tube (bottom row)“ (Elutionsröhr [untere Reihe]) lautet. Sicherstellen, dass der Verdünnungsfaktor (**Dilution factor**) „**1**“ beträgt.
8	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
9	**CPE** und den **PCR Mix** gemäß der „Load List“ (Liste Laden) auf den „Inventory Block“ (Bestandsmanager) **laden** und die Chargennummer und das Ablaufdatum des CPE und PCR Mix sowie die Anzahl der Reaktionen für jedes Röhrchen eingeben.	Den **PCR Mix** gemäß der „Load List“ (Liste Laden) auf den „Inventory Block“ (Bestandsmanager) **laden** und die Chargennummer und das Ablaufdatum des PCR Mix sowie die Anzahl der Reaktionen für jedes Röhrchen eingeben.

	A. Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])	B. Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR])
10	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
11	Die Spitzen in den „Tip Racks“ (Spitzenständer) im „Inventory Area“ (Inventarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.	Die Spitzen in den „Tip Racks“ (Spitzenständer) im „Inventory Area“ (Inventarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.
12	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
13	PCR-Kassette, ELITe InGenius SP 200 oder SP1000 Extraktionskartuschen und alle benötigten Verbrauchsmaterialien und zu extrahierenden Proben **laden**.	PCR-Kassette und Elution Tube (Elutionsröhr) mit extrahierten Proben **laden**.
14	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
15	Schließen Sie die Gerätetür.	Schließen Sie die Gerätetür.
16	„Start“ (Starten) drücken.	„Start“ (Starten) drücken.

	C. Kalibrationslauf (PCR Only [nur PCR])	D. Lauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR])
1	Die benötigten **Q-PCR Standard -Röhrchen** (Cal1: Q-PCR Standard 10^2, Cal2: Q-PCR Standard 10^3, Cal3: Q-PCR Standard 10^4, Cal4: Q-PCR Standard 10^5) 30 Minuten auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.	**Positive Control-Röhrchen** 30 Minuten auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Die **Negative Control vorbereiten**: dazu mindestens 50 µl hochreines Wasser für die Molekularbiologie in ein Elutionsröhrchen überführen, das im Lieferumfang des ELITe InGenius SP 200 Consumable Set enthalten ist.
2	Auf der Startseite „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen.	Auf der Startseite „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen.
3	Sicherstellen, dass das „Extraction Input Volume“ (Extraktion Eingangsvolumen) 200 µl bzw. 1000 µl und das extrahierte „Extracted Elute Volume“ (Extrahiertes Eluatvolumen) 100 µl beträgt.	Sicherstellen, dass das „Extraction Input Volume“ (Extraktion Eingangsvolumen) 200 µl bzw. 1000 µl und das extrahierte „Extracted Elute Volume“ (Extrahiertes Eluatvolumen) 100 µl beträgt.
4	Für den Q-PCR Standard die Spur („Track“) zuweisen, das **Assay Protocol** (Assay-Protokoll) (siehe „Proben und Kontrollen“) in der Spalte „Assay“ **auswählen** und die Reagenzien-Chargennummer und das Verfallsdatum eingeben.	Das **Assay Protocol** (Assay-Protokoll) in der Spalte „Assay“ (Prüfung) **auswählen** (siehe „Proben und Kontrollen“). Die Chargennummer und das Ablaufdatum der Positive Control und des hochreinen Wassers für die Molekularbiologie eingeben.
5	Sicherstellen, dass in der Spalte „Protocol“ (Protokoll) „PCR Only“ (nur PCR) ausgewählt ist.	Sicherstellen, dass in der Spalte „Protocol“ (Protokoll) „PCR Only“ (nur PCR) ausgewählt ist.
6	Sicherstellen, dass die Ladeposition der Probe in der Spalte „Sample Position“ (Probenposition) „Elution Tube (bottom row)“ (Elutionsröhr [untere Reihe]) lautet.	Sicherstellen, dass die Ladeposition der Probe in der Spalte „Sample Position“ (Probenposition) „Elution Tube (bottom row)“ (Elutionsröhr [untere Reihe]) lautet.
7	Den **PCR Mix** gemäß der „Load List“ (Liste Laden) auf den „Inventory Block“ (Bestandsmanager) **laden** und die Chargennummer und das Ablaufdatum des PCR Mix sowie die Anzahl der Reaktionen für jedes Röhrchen eingeben.	Den **PCR Mix** gemäß der „Load List“ (Liste Laden) auf den „Inventory Block“ (Bestandsmanager) **laden** und die Chargennummer und das Ablaufdatum des PCR Mix sowie die Anzahl der Reaktionen für jedes Röhrchen eingeben.
8	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
9	Die Spitzen in dem/den Spitzenständer/n („Tip Rack (s)“) im Inventory Area (Inventarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.	Die Spitzen in dem/den Spitzenständer/n („Tip Rack(s)“) im Inventory Area (Inventarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.
10	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
11	Die PCR-Kassette und die Q-PCR-Standard-Röhrchen **laden**.	PCR-Kassette, Positive Control und Negative Control **laden**.
12	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
13	Schließen Sie die Gerätetür.	Schließen Sie die Gerätetür.
14	„Start“ (Starten) drücken.	„Start“ (Starten) drücken.

Nach Beendigung des Laufs ermöglicht **ELITe InGenius** es dem Benutzer, die Ergebnisse anzuzeigen, zu genehmigen und zu speichern und den Bericht auszudrucken und zu speichern.

HINWEIS!
Am Ende des Laufs muss die übrige extrahierte Probe im **Elution Tube** (Elutionsröhr.) aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen, gekennzeichnet und maximal einen Monat bei -20 ±10 °C aufbewahrt werden. Ein Verschütten der extrahierten Probe vermeiden.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs kann der **PCR Mix** aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt oder bis zu 7 Stunden (2 Läufe von jeweils 3 Stunden sowie die zum Starten eines dritten Laufs nötige Zeit) im gekühlten Block aufbewahrt werden; vorsichtig mischen und den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren, bevor der nächste Lauf beginnt.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs kann der übrige **Q - PCR Standard** aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter gelagert werden. Verschütten des Q - PCR Standard vermeiden.

HINWEIS!

Der **Q - PCR Standard** kann für 4 separate Läufe von jeweils 2 Stunden verwendet werden.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs kann die übrige **Positive Control** aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt werden. Ein Verschütten der Positive Control vermeiden. Die übrige **Negative Control** muss entsorgt werden.

HINWEIS!

Die **Positive Control** kann für 4 separate Läufe von jeweils 3 Stunden verwendet werden.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs müssen die **PCR Cassette** und die anderen Verbrauchsmaterialien unter Berücksichtigung sämtlicher gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorschriften entsorgt werden. Ein Verschütten der Reaktionsprodukte vermeiden.

9.3 SCHRITT 3 – Überprüfung und Genehmigung der Ergebnisse

ELITe InGenius überwacht die Fluoreszenzsignale der Zielsequenz und der Internal Control für jede Reaktion und wendet die Assay-Protokoll-Parameter automatisch an, um PCR-Kurven zu erstellen, anhand derer anschließend die Ergebnisse interpretiert werden.

At the end of the run, the “Results Display” screen is automatically shown. Auf diesem Bildschirm werden die Ergebnisse und Laufdaten angezeigt. Über diesen Bildschirm können die Ergebnisse genehmigt und die Berichte („Sample Report“ (Probenbericht) oder „Track Report“ (Spurbericht)) ausgedruckt oder gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

HINWEIS!

ELITe InGenius kann mit dem „Laboratory Information System“ (Laborinformationssystem – LIS) verbunden werden, worüber die Laufinformationen heruntergeladen werden können. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

ELITe InGenius generiert Ergebnisse mithilfe des **EBV ELITe MGB Kit** und geht dabei folgendermaßen vor:

1. Validierung der Kalibrationskurve,
2. Validierung der Ergebnisse der Positive Control und Negative Control,
3. Validierung der Probenergebnisse,
4. Ausgabe des Probenergebnisberichts.

9.3.1 Validierung der Kalibrationskurve

Die **ELITe InGeniusSoftware** interpretiert die PCR-Ergebnisse für die Zielsequenzen der Kalibratorreaktionen mit den Parametern des Assay-Protokolls **EBV ELITe_STD** oder **EBV ELITe STD_1000_100**. Die Kalibrationskurve ergibt sich aus dem resultierenden Ct-Wert bei der jeweiligen Konzentration.

Die für die PCR-Reagenziencharge spezifischen Kalibrationskurven werden in der Datenbank („Calibration“) gespeichert. Sie können von Mitarbeitern mit der Qualifikation „Administrator“ oder „Analyst“ unter Befolgung der Anweisungen auf der grafischen Benutzeroberfläche angezeigt und genehmigt werden.

Die Kalibrationskurve läuft **nach 60 Tagen** ab.

HINWEIS!
Erfüllt die Kalibrationskurve nicht die Annahmekriterien, wird die Meldung „Failed“ (nicht bestanden) auf dem Bildschirm „Calibration“ angezeigt. In diesem Fall können die Ergebnisse nicht genehmigt werden und die Kalibrator-Amplifikationsreaktionen müssen wiederholt werden. Außerdem werden Proben, die nicht in den Lauf einbezogen wurden, nicht quantifiziert und müssen ebenfalls wiederholt werden, um quantitative Ergebnisse zu generieren.

9.3.2 Validierung der Ergebnisse des Amplifikationslaufs für die Positivkontrolle und Negativkontrolle

Die **ELITe InGenius Software** interpretiert die PCR-Ergebnisse für die Zielsequenz der Reaktionen der Positive Control und der Negative Control mit den Parametern der Assay-Protokolle **EBV ELITe_PC** oder **EBV PC_1000_100** und **EBV ELITe_NC** oder **EBV NC_1000_100**. Die resultierenden Ct-Werte werden in Konzentrationswerte umgerechnet und zur Überprüfung des Systems (Reagenziencharge und Gerät) herangezogen.

Die Ergebnisse der Positive Control und Negative Control, die für die PCR-Reagenziencharge spezifisch sind, werden in der Datenbank („Controls“) gespeichert. Sie können vom „Administrator“ oder „Analyst“ unter Befolgung der Anweisung auf der grafischen Benutzeroberfläche angezeigt und genehmigt werden.

Die Ergebnisse der Positive Control und der Negative Control laufen **nach 15 Tagen** ab.

Die **ELITe InGenius Software** verarbeitet die Ergebnisse der Positive Control und Negative Control und generiert Kontrollendiagramme („Control Charts“). Die Genehmigung der Positive Control basiert auf der Auswertung der erhaltenen logarithmischen Größe, die innerhalb des erwarteten logarithmischen Größenbereichs (PC-Diagramm) liegen sollte. Dies stellt sicher, dass die Systemleistung innerhalb der Akzeptanzkriterien liegt. Das zweite Diagramm (L-J-Diagramm) dient ausschließlich der Überwachung des Trends der Positive Control im Zeitverlauf. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

HINWEIS!
Erfüllt das Ergebnis der Positive Control bzw. Negative Control nicht die Annahmekriterien, wird die Meldung „Failed“ (nicht bestanden) im Bildschirm „Controls“ (Kontrollen) angezeigt. In diesem Fall können die Ergebnisse nicht genehmigt werden und die Läufe der Positive Control oder Negative Control müssen wiederholt werden.

HINWEIS!
Ist das Ergebnis der Positive Control bzw. Negative Control ungültig und wurden die Proben in denselben Lauf einbezogen, können die Proben genehmigt werden; ihre Ergebnisse werden jedoch nicht validiert. In diesem Fall müssen alle fehlgeschlagenen Kontrollen und Proben wiederholt werden.

9.3.3 Validierung der Probenergebnisse

Die **ELITe InGenius Software** interpretiert die PCR-Ergebnisse für die Zielsequenz (Kanal **EBV**) und die Internal Control (Kanal **IC**) mit den Assay-Protokoll-Parametern **EBV ELITe_WB_200_100**, **EBV ELITe_PL_200_100, EBV ELITe PL_1000_100** oder **EBV ELITe_CSF_200_100** . Die resultierenden Ct-Zielwerte werden in Konzentrationswerte umgerechnet.

Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm „Results Display“ (Ergebnisanzeige) angezeigt.

Die Probenergebnisse können genehmigt werden, wenn die drei Bedingungen in der nachfolgenden Tabelle erfüllt sind.

1) Kalibrationskurve	**„Status“**
EBV Q-PCR Standard	APPROVED (Genehmigt)
2) Positivkontrolle	**„Status“**

EBV Positive Control	APPROVED (Genehmigt)
3) Negativkontrolle	**„Status“**
EBV Negative Control	APPROVED (Genehmigt)

Die Probenergebnisse werden von der **ELITe InGenius Software** anhand der Assay-Protokoll-Parameter automatisch interpretiert.

Die möglichen Ergebnismeldungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Für jede Probe meldet das System eine Kombination aus den folgenden Meldungen, die angeben, ob die Pathogen-DNA nachgewiesen wurden oder nicht.

Ergebnis des **Probenlaufs**	**Interpretation**
EBV:DNA Detected, quantity equal to XXXcopies/mL or IU/mL (EBV:DNA Erkannt, Menge gleich XXXKopien/ml oder IU/ml)	In der Probe wurde **EBV-DNA** innerhalb des Messbereichs des Assays **nachgewiesen**, ihre Konzentration wird angezeigt.
EBV:DNA Detected, quantity below LLoQcopies/mL or IU/mL (EBV:DNA Erkannt, Menge unter LLoQKopien/ml oder IU/ml)	In der Probe wurde **EBV-DNA nachgewiesen**, ihre Konzentration liegt unterhalb der unteren Bestimmungsgrenze des Assays.
EBV:DNA Detected, quantity beyond ULoQcopies/mL or IU/mL (EBV:DNA Erkannt, Menge über ULoQKopien/ml oder IU/ml)	In der Probe wurde **EBV-DNA nachgewiesen**, ihre Konzentration liegt oberhalb der oberen Bestimmungsgrenze des Assays.
EBV:DNA Not detected or below LoDcopies/mL or IU/mL (EBV:DNA Nicht erkannt oder unter LoDKopien/ml oder IU/ml)	In der Probe wurde **keine EBV-DNA nachgewiesen**. Die Probe wurde negativ auf EBV-DNA getestet oder die Konzentration liegt unter der Nachweisgrenze des Assays.
Invalid-Retest Sample (Ungültig – Probe erneut testen)	**Ungültiges Testergebnis** durch fehlerhafte Internal Control (z. B. aufgrund von falscher Extraktion oder Verschleppung von Inhibitoren). Der Test sollte wiederholt werden.

Als „Invalid-Retest Sample“ (Ungültig – Probe erneut testen) ausgegebene Proben: In diesem Fall wurde die Internal-Control-DNA möglicherweise aufgrund von Problemen beim Probenentnahme-, Extraktions- oder PCR-Schritt nicht effizient erkannt (z. B. falsche Probenahme, Abbau oder Verlust von DNA während der Extraktion oder Inhibitoren im Eluat), was zu falschen Ergebnissen führen kann.

Wenn ausreichend Eluatvolumen übrig bleibt, kann das Eluat (verdünnt oder unverdünnt) mithilfe eines Amplifikationslaufs im Modus „PCR Only“ (nur PCR) erneut getestet werden. Ist das zweite Ergebnis ungültig, muss die Probe beginnend mit der Extraktion einer neuen Probe im Modus „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) erneut getestet werden (siehe 18 FEHLERBEHEBUNG page 58).

Als „EBV: DNA Not Detected or below “LoD” copies/mL or IU/mL“ (EBV: DNA nicht erkannt oder unter „LoD“ Kopien/ml oder IU/ml) ausgegebene Proben sind für die Analyse geeignet, VZV wurde jedoch nicht nachgewiesen. In diesem Fall kann entweder die Probe für EBV-DNA negativ sein oder die EBV-DNA ist bei einer Konzentration unter der Nachweisgrenze des Tests vorhanden (siehe 12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO page 33).

EBV-DNA-positive Proben mit einer Konzentration unter der Nachweisgrenze (und der unteren Bestimmungsgrenze) des Assays werden, falls nachgewiesen, als „EBV: DNA Detected, quantity below “LLoQ” copies/mL or IU/mL“ (EBV: DNA erkannt, Menge unter „LLoQ“ Kopien/ml oder IU/ml) ausgegeben (siehe 12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO page 33).

EBV-DNA-positive Proben innerhalb des linearen Messbereichs werden erkannt und als „EBV: DNA Detected, quantity equal to “XXX” copies/mL or IU/mL“ (EBV: DNA erkannt, Menge gleich „XXX“ Kopien/ml oder IU/ml) ausgegeben (siehe 12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO page 33).

EBV-DNA-positive Proben, die oberhalb der oberen Bestimmungsgrenze liegen, werden als „EBV:DNA Detected, quantity beyond “ULoQ” copies/mL or IU/mL“ (EBV: DNA erkannt, Menge über „ULoQ“ Kopien/ml oder IU/ml) ausgegeben (siehe12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO page 33) und sind nicht zur Quantifizierung geeignet. Falls erforderlich muss die Probe vor der Extraktion oder dem PCR-Test verdünnt und erneut getestet werden, um Ergebnisse innerhalb des linearen Messbereichs des Assays zu erzielen.

HINWEIS!
Bei der Interpretation der mit dem Assay erhaltenen Ergebnisse müssen alle relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunde herangezogen werden.

Die Probenergebnisse werden in der Datenbank gespeichert und können, falls gültig, vom „Administrator“ oder „Analyst“ unter Befolgung der Anweisungen auf der grafischen Benutzeroberfläche unter „Results Display“ (Ergebnisanzeige) genehmigt werden. Über das Fenster „Results Display“ können die Ergebnisse des Probenlaufs als „Sample Report“ (Probenbericht) und „Track Report“ (Spurbericht) ausgedruckt und gespeichert werden.

9.3.4 Ausgabe des Probenergebnisberichts

Die Probenergebnisse werden in der Datenbank gespeichert, und Berichte können als „Sample Report“ (Probenbericht) und „Track Report“ (Spurbericht) exportiert werden.

Der „Sample Report“ zeigt die Ergebnisdetails sortiert nach ausgewählter Probe (SID, „Sample ID“) an.

Der „Track Report“ zeigt die Ergebnisdetails nach ausgewählter Spur an.

Der „Sample Report“ und der „Track Report“ können ausgedruckt und von autorisiertem Personal unterschrieben werden.

10 VERFAHREN BEI ELITe BeGenius

Das beim Gebrauch des **EBV ELITe MGB Kit** mit dem **ELITe BeGenius** anzuwendende Verfahren besteht aus drei Schritten:

Tabelle 7

SCHRITT 1	Prüfung der Systembereitschaft	
SCHRITT 2	Einrichtung des Laufs	A) Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])
		B) Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR])
		C) Kalibrationslauf (PCR Only [nur PCR])
		D) Lauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR])
SCHRITT 3	Überprüfung und Genehmigung der Ergebnisse	1) Validierung der Kalibrationskurve
		2) Validierung der Ergebnisse der Positive Control und Negative Control
		3) Validierung der Probenergebnisse
		4) Ausgabe des Probenergebnisberichts

10.1 SCHRITT 1 – Prüfung der Systembereitschaft

Vor Beginn des Laufs:

- **ELITe BeGenius** einschalten und den Modus „**CLOSED**“ (geschlossen) auswählen,
- auf der Startseite im Menü „Calibrations“ (Kalibrationen) bestätigen, dass die Kalibratoren (**Q - PCR Standard**) für die zu verwendende Charge des **PCR Mix** genehmigt und gültig (Status) sind. Wenn keine gültigen

Kalibratoren für die Charge **PCR Mix** verfügbar sind, Kalibration wie in den folgenden Abschnitten beschrieben durchführen,

- auf der Startseite im Menü „Controls“ (Kontrollen) bestätigen, dass die PCR-Kontrollen (**Positive Control, Negative Control**) für die zu verwendende Charge des **PCR Mix** genehmigt und gültig (Status) sind. Wenn keine gültigen PCR-Kontrollen für die Charge **PCR Mix** verfügbar sind, die PCR-Kontrollen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben durchführen,
- den Typ des Laufs auswählen, dazu die Anweisungen auf der grafischen Benutzeroberfläche zur Einrichtung des Laufs befolgen und die von EG SpA bereitgestellten Assay-Protokolle verwenden (siehe „Proben und Kontrollen“).

Falls das betreffende Assay Protokoll nicht im System geladen ist, wenden Sie sich an Ihren ELITechGroup Kundendienstvertreter vor Ort.

10.2 SCHRITT 2 – Einrichtung des Laufs

Das **EBV ELITe MGB Kit** kann auf **ELITe BeGenius** für die folgenden Läufe verwendet werden:

A. Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR]),

B. Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR]),

C. Kalibrationslauf (PCR Only [nur PCR]),

D. Lauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR]).

Alle benötigten Parameter sind in den auf dem Gerät verfügbaren Assay-Protokollen enthalten und werden bei Auswahl des Assay-Protokolls automatisch geladen.

HINWEIS!
ELITe BeGenius kann mit dem „Laboratory Information System“ (Laborinformationssystem – LIS) verbunden werden, worüber die Laufinformationen heruntergeladen werden können. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

Vor dem Einrichten eines Laufs:

Die benötigten **PCR Mix**-Röhrchen 30 Minuten auf Raumtemperatur auftauen. Jedes Röhrchen reicht aus für **24 Tests**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.

HINWEIS!
Den **PCR Mix** lichtgeschützt auftauen lassen, da dieses Reagenz lichtempfindlich ist.

Zum Einrichten eines der vier Lauftypen die folgenden Schritte unter Beachtung der grafischen Benutzeroberfläche ausführen:

	A. Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])	**B. Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR])**
1	**Proben identifizieren** und, falls erforderlich, auf Raumtemperatur auftauen, vorsichtig mischen, den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Falls erforderlich, 200 µl Probe in ein zuvor etikettiertes 2-ml-Sarstedt-Röhrchen überführen. Die benötigten **CPE-Röhrchen** 30 Minuten auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Jedes Röhrchen reicht aus für 12 Extraktionen.	**Elution Tube** (Elutionsröhr) mit den extrahierten Nukleinsäuren auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.
2	Auf der Startseite „**Perform Run**“ (Lauf durchführen) auswählen.	Auf der Startseite „**Perform Run**“ (Lauf durchführen) auswählen.
3	Alle Racks aus der „Cooler Unit“ entnehmen und auf den Zubereitungstisch stellen.	Die „Racks“ aus „Lane 1, 2 und 3 (L1, L2 und L3)“ der „Cooler Unit“ entnehmen und auf den Zubereitungstisch stellen.

	A. Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])	B. Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR])
4	Den Laufmodus („Run mode“) wählen: „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR).	Den Laufmodus („Run mode“) wählen: „PCR Only“ (Nur PCR).
5	Die Proben in das „Sample Rack“ (Probenständer) laden. (Hinweis: Wenn als Sekundärröhrchen „2 mL Tubes“ (2-ml-Röhrchen) geladen werden, verwenden Sie die blauen Adapter für das „Sample Rack“ [Probenständer]).	Die Proben in das „Elution Rack“ (Elutionsablage) laden.
6	**Das „Sample Rack“** in die „Cooler Unit“ **einsetzen**, beginnend mit „Lane 5“ (L5). Falls erforderlich unter „Sample ID“ (SID) die Proben-ID für jede verwendete „Position“ eingeben. (Beim Laden von Sekundärröhrchen „2-ml-Röhrchen“ angeben. Bei Sekundärröhrchen ohne Barcode die Proben-ID manuell eingeben.	**Das „Elution Rack“** in die „Cooler Unit“ **einsetzen**, beginnend mit „Lane 3“ (L3). Falls erforderlich, für jede „Position“ die Proben-ID („Sample ID“), die Probenmatrix („Sample Matrix“), das Extraktionskit („Extraction Kit“) und das extrahierte Eluatvolumen („Extracted eluate vol.“) eingeben.
7	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
8	Sicherstellen, dass das „Extraction Input Volume“ (Extraktion Eingangsvolumen) 200 µl und das extrahierte „Extracted Elute Volume“ (Extrahiertes Eluatvolumen) 100 µl beträgt.	Nicht anwendbar
9	Das Assay Protocol (Assay-Protokoll) in der Spalte „Assay“ (Prüfung) auswählen (siehe „Proben und Kontrollen“).	Das Assay Protocol (Assay-Protokoll) in der Spalte „Assay“ (Prüfung) auswählen (siehe „Proben und Kontrollen“).
10	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
11	Bei Verarbeitung von mehr als 12 Proben das Verfahren ab Punkt 6 wiederholen.	Bei Verarbeitung von mehr als 12 Proben das Verfahren ab Punkt 6 wiederholen.
12	Die „Elution tubes“ (Elutionsröhr) in das „Elution Rack“ (Elutionsablage) laden (Elutionsröhrchen können zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit mit einem Barcode etikettiert werden).	Nicht anwendbar
13	Das „Elution Rack“ in die „Cooler Unit“ einsetzen, beginnend mit „Lane 3“ (L3). Bei Verarbeitung von mehr als 12 Proben das Verfahren wiederholen und dabei „Lane 2“ (L2) verwenden.	Nicht anwendbar
14	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Nicht anwendbar
15	CPE und PCR Mix in das „Reagent/Elution Rack“ (Reagenz-/Elutionsablage) laden.	Den PCR Mix in das „Reagent/Elution Rack“ (Reagenz-/ Elutionsablage) laden.
16	Das „Reagent/Elution Rack“ in die „Cooler Unit“ in „Lane 2“ (L2), falls verfügbar, oder in „Lane 1“ (L1) einsetzen. Falls erforderlich, für jeden PCR Mix und/oder CPE unter „S/N“ die Seriennummer, unter „Lot No.“ die Chargennummer, unter „Exp. Date“ das Verfallsdatum und unter „T/R“ die Anzahl der Reaktionen eingeben.	Das „Reagent/Elution Rack“ in die „Cooler Unit“ in „Lane 2“ (L2), falls verfügbar, oder in „Lane 1“ (L1) einsetzen. Falls erforderlich, für jeden PCR Mix unter „S/N“ die Seriennummer, unter „Lot No.“ die Chargennummer, unter „Exp. Date“ das Verfallsdatum und unter „T/R“ die Anzahl der Reaktionen eingeben.
17	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
18	Die Spitzen in dem/den „Tip Rack(s)“ (Spitzenständer/ n) im „Inventory Area“ (Invetarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.	Die Spitzen in dem/den „Tip Rack(s)“ (Spitzenständer/n) im „Inventory Area“ (Invetarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.
19	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
20	Das „PCR Rack“ mit „PCR Cassette“ (PCR-Kassette) in den Inventory Area (Inventarbereich) laden.	Das „PCR Rack“ mit „PCR Cassette“ (PCR-Kassette) in den Inventory Area (Inventarbereich) laden.

	A. Probenlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])	B. Lauf mit eluierter Probe (PCR Only [nur PCR])
21	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
22	Den „Extraction Rack“ (Extraktionsrack) mit den „ELITe InGenius SP 200“ Extraktionskartuschen und die für die Extraktion erforderlichen Verbrauchsmaterialien laden.	Nicht anwendbar
23	Schließen Sie die Gerätetür.	Schließen Sie die Gerätetür.
24	„Start“ (Starten) drücken.	„Start“ (Starten) drücken.

	C. Kalibrationslauf (PCR Only [nur PCR])	D. Lauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR])
1	Die benötigten **Q-PCR Standard -Röhrchen** (Cal1: Q-PCR Standard 10^2, Cal2: Q-PCR Standard 10^3, Cal3: Q-PCR Standard 10^4, Cal4: Q-PCR Standard 10^5) 30 Minuten auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.	**Positive Control-Röhrchen** 30 Minuten auf Raumtemperatur **auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Die **Negative Control vorbereiten**: dazu mindestens 50 µl hochreines Wasser für die Molekularbiologie in ein Elutionsröhrchen überführen, das im Lieferumfang des ELITe InGenius SP 200 Consumable Set enthalten ist.
2	Auf der Startseite „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen.	Auf der Startseite „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen.
3	Die „Racks“ aus „Lane 1, 2 und 3 (L1, L2 und L3)“ der „Cooler Unit“ entnehmen und auf den Zubereitungstisch stellen.	Die „Racks“ aus „Lane 1, 2 und 3 (L1, L2 und L3)“ der „Cooler Unit“ entnehmen und auf den Zubereitungstisch stellen.
4	Den Rund Mode („run mode“) wählen: „PCR Only“ (Nur PCR).	Den Laufmodus („Run mode“) wählen: „PCR Only“ (Nur PCR).
5	Die **Q-PCR** Standard-Röhrchen in das „Elution Rack“ (Elutionsablage) **laden**.	Die **Röhrchen für die Positive Control und Negative Control** in das „Elution Rack“ (Elutionsablage) **laden**.
6	Das „**Elution Rack**“ in die „Cooler Unit“ **einsetzen**, beginnend mit „Lane 3“ (L3). Falls erforderlich, für jede „Position" unter „Reagent name" den Reagenznamen, unter „S/N" die Seriennummer, unter „Lot No." die Chargennummer, unter „Exp. Date“ das Verfallsdatum und unter „T/R“ die Anzahl der Reaktionen eingeben.	Das „**Elution Rack**“ in die „Cooler Unit“ **einsetzen**, beginnend mit „Lane 3“ (L3). Falls erforderlich, für jede „Position" unter „Reagent name" den Reagenznamen, unter „S/N" die Seriennummer, unter „Lot No." die Chargennummer, unter „Exp. Date“ das Verfallsdatum und unter „T/R“ die Anzahl der Reaktionen eingeben.
7	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
8	Das **Assay Protocol** (Assay-Protokoll) in der Spalte „Assay“ (Prüfung) auswählen (siehe „Proben und Kontrollen“).	Das **Assay Protocol** (Assay-Protokoll) in der Spalte „Assay“ (Prüfung) auswählen (siehe „Proben und Kontrollen“).
9	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
10	Den **PCR Mix** in das „Reagent/Elution Rack“ (Reagenz-/Elutionsablage) **laden**.	Den **PCR Mix** in das „Reagent/Elution Rack“ (Reagenz-/ Elutionsablage) **laden**.
11	Das „**Reagent/Elution Rack**“ in die „Cooler Unit“ in „Lane 2“ (L2) **einsetzen**. Falls erforderlich, für jeden PCR Mix unter „S/N“ die Seriennummer, unter „Lot No.“ die Chargennummer, unter „Exp. Date“ das Verfallsdatum und unter „T/R“ die Anzahl der Reaktionen eingeben.	Das „Reagent/Elution Rack“ in die „Cooler Unit“ in „Lane 2“ (L2) einsetzen. Falls erforderlich, für jeden PCR Mix unter „S/N“ die Seriennummer, unter „Lot No.“ die Chargennummer, unter „Exp. Date“ das Verfallsdatum und unter „T/R“ die Anzahl der Reaktionen eingeben.
12	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
13	Die Spitzen in den Spitzenständern („Tip Racks“) im „Inventory Area“ (Inventarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.	Die Spitzen in den Spitzenständern („Tip Racks“) im „Inventory Area“ (Inventarbereich) prüfen und Spitzenständer ggf. ersetzen.
14	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
15	Das „**PCR Rack**“ mit „**PCR Cassette**“ (PCR-Kassette) in den Inventory Area (Inventarbereich) **laden**.	Das „**PCR Rack**“ mit „**PCR Cassette**“ (PCR-Kassette) in den Inventory Area (Inventarbereich) **laden**.
16	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.	Auf „Next“ (Weiter) klicken, um fortzufahren.
17	Schließen Sie die Gerätetür.	Schließen Sie die Gerätetür.
18	„Start“ (Starten) drücken.	„Start“ (Starten) drücken.

Nach Beendigung des Laufs ermöglicht **ELITe BeGenius** es dem Benutzer, die Ergebnisse anzuzeigen, zu genehmigen und zu speichern und den Bericht auszudrucken und zu speichern.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs muss die übrige extrahierte Probe im **Elution Tube** (Elutionsröhr.) aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen, gekennzeichnet und maximal einen Monat bei -20 ±10 aufbewahrt werden. Ein Verschütten der extrahierten Probe vermeiden.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs kann der **PCR Mix** aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt oder bis zu 7 Stunden (2 Läufe von jeweils 3 Stunden sowie die zum Starten eines dritten Laufs nötige Zeit) im gekühlten Block aufbewahrt werden; vorsichtig mischen und den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren, bevor der nächste Lauf beginnt.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs kann der übrige**Q - PCR Standard**aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt werden. Verschütten des Q - PCR Standard vermeiden.

HINWEIS!

Der**Q - PCR Standard**kann für 4 separate Läufe von jeweils 2 Stunden verwendet werden.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs kann die übrige**Positive Control**aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt werden. Ein Verschütten der**Positive Control**vermeiden. Die übrige**Negative Control**muss entsorgt werden.

HINWEIS!

Die**Positive Control**kann für 4 separate Läufe von jeweils 3 Stunden verwendet werden.

HINWEIS!

Am Ende des Laufs müssen die**PCR Cassette**und die anderen Verbrauchsmaterialien unter Berücksichtigung sämtlicher gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorschriften entsorgt werden. Ein Verschütten der Reaktionsprodukte vermeiden.

10.3 SCHRITT 3 – Überprüfung und Genehmigung der Ergebnisse

ELITe BeGenius überwacht die Fluoreszenzsignale der Zielsequenz und der Internal Control für jede Reaktion und wendet die Assay-Protokoll-Parameter automatisch an, um PCR-Kurven zu erstellen, anhand derer anschließend die Ergebnisse interpretiert werden.

At the end of the run, the “Results Display” screen is automatically shown. Auf diesem Bildschirm werden die Ergebnisse und Laufdaten angezeigt. Über diesen Bildschirm können die Ergebnisse genehmigt und die Berichte („Sample Report“ (Probenbericht) oder „Track Report“ (Spurbericht)) ausgedruckt oder gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

HINWEIS!

ELITe BeGenius kann mit dem „Laboratory Information System“ (Laborinformationssystem – LIS) verbunden werden, worüber die Laufinformationen heruntergeladen werden können. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

ELITe BeGenius generiert die Ergebnisse mithilfe des **EBV ELITe MGB Kit** und geht dabei folgendermaßen vor:

1. Validierung der Kalibrationskurve,
2. Validierung der Ergebnisse der Positive Control und Negative Control,

3. Validierung der Probenergebnisse,
4. Ausgabe des Probenergebnisberichts.

HINWEIS!
Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt unter **Verfahren bei ELITe InGenius** zu entnehmen.

11 VERFAHREN BEI MyGenius PRO

Das beim Gebrauch des **EBV ELITe MGB Kit** mit dem **MyGenius PRO** anzuwendende Verfahren besteht aus drei Schritten:

Tabelle 8

SCHRITT 1	Prüfung der Systembereitschaft	
SCHRITT 2	Einrichtung des Laufs	A) Probentestlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])
		B) Kalibrationstestlauf (PCR Only [nur PCR])
		C) Testlauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR])
SCHRITT 3	Überprüfung und Genehmigung der Ergebnisse	1) Validierung der Kalibrationskurve
		2) Validierung der Ergebnisse der Positive Control und Negative Control
		3) Validierung der Probenergebnisse
		4) Ausgabe des Probenergebnisberichts

SCHRITT 1 – Prüfung der Systembereitschaft

Vor Beginn des Testlaufs:

- MyGenius PRO einschalten und einloggen; das Gerät startet im Standby-Modus.
- auf dem Bildschirm „Home“ (Start) im Menü „Calibrations“ (Kalibrationen) bestätigen, dass die Kalibratoren (**Q - PCR Standard**) für die zu verwendende Charge des**PCR Mix**genehmigt und gültig (Status) sind. Wenn keine gültigen Kalibratoren für die Charge**PCR Mix**verfügbar sind, Kalibration wie in den folgenden Abschnitten beschrieben durchführen,
- auf dem Bildschirm „Home“ (Start) im Menü „Controls“ (Kontrollen) bestätigen, dass die PCR-Kontrollen (**Positive Control, Negative Control**) für die zu verwendende Charge des**PCR Mix**genehmigt und gültig (Status) sind. Wenn keine gültigen PCR-Kontrollen für die Charge**PCR Mix**verfügbar sind, die PCR-Kontrollen wie in den folgenden Abschnitten beschrieben durchführen,
- die Anweisungen auf der grafischen Benutzeroberfläche zur Einrichtung des Laufs befolgen und die von EG SpA bereitgestellten Assay-Protokolle verwenden (siehe „Proben und Kontrollen“).

Falls das betreffende Assay Protokoll nicht im System geladen ist, wenden Sie sich an Ihren ELITechGroup Kundendienstvertreter vor Ort.

SCHRITT 2 – Einrichten des Arbeitsablaufs auf dem System

Das **EBV ELITe MGB Kit** kann auf **MyGenius PRO** für die folgenden Läufe verwendet werden:

A. Probentestlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR]),

B. Kalibrationstestlauf (PCR Only [nur PCR]),

C. Testlauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR]).

Alle benötigten Parameter sind in den auf dem Gerät verfügbaren Assay-Protokollen enthalten und werden bei Auswahl des Assay-Protokolls automatisch geladen.

HINWEIS!

MyGenius PRO kann mit dem „Laboratory Information System“ (Laborinformationssystem – LIS) verbunden werden, worüber die Informationen für den Arbeitsablauf heruntergeladen werden können. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

Vor der Einrichtung eines Testlaufs:

Die benötigten **PCR Mix**-Röhrchen 30 Minuten auf Raumtemperatur auftauen. Jedes Röhrchen reicht aus für **24 Tests**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.

HINWEIS!

Den **PCR Mix** lichtgeschützt auftauen lassen, da dieses Reagenz lichtempfindlich ist.

Zum Einrichten einer der drei Arten von Testläufen die folgenden Schritte unter Beachtung der grafischen Benutzeroberfläche ausführen.

	A. Probentestlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])	**B. Kalibrationstestlauf (PCR Only [nur PCR])**	**C. Testlauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR])**
1	Proben identifizieren und, falls erforderlich, auf Raumtemperatur auftauen, vorsichtig mischen, den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Wenn das Primärröhrchen mit MyGenius PRO-Racks kompatibel ist, Röhrchen mit Proben in die Racks einsetzen; ist dies nicht möglich,**260 µl Probe in ein zuvor etikettiertes Sekundärröhrchen (2 ml) überführen**. Die benötigtenInternal Control Maxi**IC MAXI-Röhrchen**30 Minuten auf Raumtemperatur**auftauen**. Vorsichtig mischen, den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren. Jedes Röhrchen reicht aus für 72 Tests.	Die benötigten**Q-PCR Standard-Röhrchen**(Cal1: Q-PCR Standard 102, Cal2: Q-PCR Standard 103, Cal3: Q-PCR Standard 104, Cal4: Q-PCR Standard 105) 30 Minuten auf Raumtemperatur**auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern.	**Positive Control-Röhrchen**30 Minuten auf Raumtemperatur**auftauen**. Vorsichtig mischen, danach den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren und Röhrchen auf Eis oder in einem Kühlblock lagern. Die**NegativeControl-Röhrchen**5 Sekunden lang herunterzentrifugieren.
2	Wenn das Gerät mit dem LIS verbunden ist, werden die Proben-Barcodes automatisch gelesen und von MyGenius PRO erkannt, wenn sie in den Probenbereich geladen werden. Wenn das Gerät nicht mit dem LIS verbunden ist, die Proben vor dem Laden in das Gerät manuell mithilfe der Funktion**ASSIGN TEST**(„Test zuweisen“) oder**ASSIGN SAMPLE** („Probe zuweisen“) auf der Seite „Sample List“ (Probenliste) der Benutzeroberfläche zuweisen. Außerdem kann über diese Funktionen jeder Probe das korrekte Testprotokoll zugewiesen werden.	Die PCR Mix- und die Q-PCR Standard-Röhrchen in das gekühlte Reagenzienkarussell laden.	Die PCR Mix- und die Positive und Negative Control-Röhrchen in das gekühlte Reagenzienkarussell laden.

	A. Probentestlauf (Extract + PCR [Extraktion + PCR])	B. Kalibrationstestlauf (PCR Only [nur PCR])	C. Testlauf für die Positive Control und Negative Control (PCR Only [nur PCR])
3	Im**STANDBY**-Modus kontrollieren, dass eine ausreichende Menge an Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des Tests vorhanden ist und die Fest- und Flüssigkeitsabfallstände den Betrieb des Geräts erlauben. Falls erforderlich, die benötigten Verbrauchsmaterialien in die entsprechenden Schubladen einsetzen und den Festabfallbehälter und den Flüssigabfalltank leeren. Die detaillierten Ladevorgänge sind dem Benutzerhandbuch des Geräts zu entnehmen.	Im**STANDBY**-Modus kontrollieren, dass eine ausreichende Menge an Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des Tests vorhanden ist und die Fest- und Flüssigkeitsabfallstände den Betrieb des Geräts erlauben. Falls erforderlich, die benötigten Verbrauchsmaterialien in die entsprechenden Schubladen einsetzen und den Festabfallbehälter und den Flüssigabfalltank leeren. Die detaillierten Ladevorgänge sind dem Benutzerhandbuch des Geräts zu entnehmen.	Im**STANDBY**-Modus kontrollieren, dass eine ausreichende Menge an Verbrauchsmaterialien für die Durchführung des Tests vorhanden ist und die Fest- und Flüssigkeitsabfallstände den Betrieb des Geräts erlauben. Falls erforderlich, die benötigten Verbrauchsmaterialien in die entsprechenden Schubladen einsetzen und den Festabfallbehälter und den Flüssigabfalltank leeren. Die detaillierten Ladevorgänge sind dem Benutzerhandbuch des Geräts zu entnehmen.
4	Auf der Seite „Home“ (Startseite) auf „Start“ (Starten) drücken und warten, bis das Gerät in den Status „Preparation“ (Vorbereitung) und dann nach „Operation“ (Betrieb) wechselt.	Auf der Seite „Home“ (Startseite) auf „Start“ (Starten) drücken und warten, bis das Gerät in den Status „Preparation“ (Vorbereitung) und dann nach „Operation“ (Betrieb) wechselt.	Auf der Seite „Home“ (Startseite) auf „Start“ (Starten) drücken und warten, bis das Gerät in den Status „Preparation“ (Vorbereitung) und dann nach „Operation“ (Betrieb) wechselt.
5	Den PCR Mix in das gekühlte Reagenzienkarussell laden.	Auf der Startseite die Schaltfläche „Calibration“ (Kalibration) auswählen.	Auf der Startseite die Schaltfläche „Controls“ (Kontrollen) auswählen.
6	Das Öffnen der Tür des Auto-Sampler-Bereichs anmelden und die Proben und IC MAXI laden.	Auf der Seite „Calibration“ (Kalibration) das in Schritt 2 geladene Q-PCR-Standard-Röhrchen auswählen und dann auf „Order“ (Auftrag) drücken.	Auf der Seite „Control“ (Kontrolle) die in Schritt 2 geladene Positive Control und Negative Control auswählen und dann auf „Order“ (Auftrag) drücken.
7	Die Auto-Sampler-Tür schließen, damit der Testlauf starten kann.		

HINWEIS!

Am Ende des Testlaufs kann der**PCRMix**aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt oder bis zu 7 Stunden im Reagenzienkarussell auf dem Gerät gelassen werden.

Sobald ein Ergebnis vorliegt, ermöglicht**MyGenius PRO**es dem Benutzer, die Ergebnisse anzuzeigen, zu genehmigen und zu speichern und den Endbericht zu speichern.

HINWEIS!

Am Ende des Testlaufs kann der übrige**Q - PCR Standard**aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt werden. Verschütten des Q - PCR Standard vermeiden.

HINWEIS!

Der**Q- PCRStandard**kann für 4 Kalibrationen verwendet werden, wobei er für jede Kalibration maximal 2 Stunden im Gerät verbleiben darf.

HINWEIS!

Am Ende des Testlaufs kann die übrige**Positive Control**aus dem Gerät herausgenommen, verschlossen und bei -20 °C oder darunter aufbewahrt werden. Ein Verschütten der**Positive Control**vermeiden. Die übrige**Negative Control**muss entsorgt werden.

HINWEIS!

Die**Positive Control**kann für 4 Kalibrationen verwendet werden, wobei sie für jede Kalibration maximal 3 Stunden im Gerät verbleiben darf.

HINWEIS!

Bei Bedarf oder wenn das Gerät es verlangt, die**PCR Cassette**aus der Schublade des Geräts entfernen; die anderen Verbrauchsmaterialien müssen unter Berücksichtigung sämtlicher gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorschriften entsorgt werden. Ein Verschütten der Reaktionsprodukte vermeiden.

HINWEIS!

MyGenius PROkann mit dem „Laboratory Information System“ (Laborinformationssystem – LIS) verbunden werden, worüber die Laufinformationen heruntergeladen werden können. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

SCHRITT 3 – Überprüfung und Genehmigung der Ergebnisse

MyGenius PRO überwacht die Fluoreszenzsignale der Zielsequenz und der Internal Control für jede Reaktion und wendet die Assay-Protokoll-Parameter automatisch an, um PCR-Kurven zu erstellen, anhand derer anschließend die Ergebnisse interpretiert werden.

Wenn die Analyse einer Probe abgeschlossen ist, können die Ergebnisse auf dem Bildschirm „Results“ (Ergebnisse) angezeigt werden, auf dem die Ergebnisse und Informationen zu den Proben erscheinen. Über diesen Bildschirm können die Ergebnisse genehmigt und Berichte gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

MyGenius PRO generiert die Ergebnisse mithilfe des **EBV ELITe MGB Kit** und geht dabei folgendermaßen vor:

1. Validierung der Kalibrationskurve,
2. Validierung der Ergebnisse der Positive Control und Negative Control,
3. Validierung der Probenergebnisse,
4. Ausgabe des Probenergebnisberichts.

Validierung der Kalibrationskurve

Die **MyGenius PRO Software** interpretiert die PCR-Ergebnisse für die Zielsequenzen der Kalibratorreaktionen mit den **EBV ELITe_My_STD** Assay-Protokoll-Parametern. Die Kalibrationskurve ergibt sich aus dem resultierenden Ct-Wert bei der jeweiligen Konzentration.

Die für die PCR-Reagenziencharge spezifischen Kalibrationskurven werden in der Datenbank („Calibrations“) gespeichert. Sie können vom Benutzer durch Auswahl der gewünschten Kalibration und des Bereichs „View chart“ (Diagramm anzeigen) angezeigt und genehmigt werden.

Die Kalibrationskurve läuft **nach 60 Tagen** ab.

HINWEIS!

Erfüllt die Kalibrationskurve nicht die Annahmekriterien, wird die Meldung „Error“ (Fehler) auf dem Bildschirm „Calibrations“ angezeigt. In diesem Fall können die Ergebnisse nicht genehmigt werden und die Kalibrator-Amplifikationsreaktionen müssen wiederholt werden. Außerdem werden Proben, die nicht in den Testlauf einbezogen wurden, nicht quantifiziert. In diesem Fall müssen alle Ergebnisse nach Wiederholung der Kalibration interpretiert und genehmigt werden (siehe Bereich für Probenergebnisse).

Validierung der Ergebnisse des Amplifikationslaufs für die Positivkontrolle und Negativkontrolle

Die **MyGenius PRO Software** interpretiert die PCR-Ergebnisse der Zielsequenzen der Reaktionen der Positive Control und der Zielsequenzen der Reaktionen der Internal Control (Kanal **IC**) der Negative Control mit den Assay-Protokoll-Parametern **EBV ELITe_My_PC** und **EBV ELITe_My_NC**. Die resultierenden Ct-Werte werden in Konzentrationswerte umgerechnet und zur Überprüfung des Systems (Reagenziencharge und Gerät) herangezogen.

Die Ergebnisse der Positive Control und Negative Control, die für die PCR-Reagenziencharge spezifisch sind, werden in der Datenbank („Controls“) gespeichert. Sie können vom Benutzer durch Auswahl der gewünschten Kontrolle und des Bereichs „View chart“ (Diagramm anzeigen) angezeigt und genehmigt werden.

Die Ergebnisse der Positive Control und der Negative Control laufen **nach 15 Tagen** ab.

Die **MyGenius PRO Software** verarbeitet die Ergebnisse der Positive Control und Negative Control und generiert Kontrollendiagramme („Control Charts“). Die Ergebnisse werden von der Software analysiert, um sicherzustellen, dass die Systemleistungen innerhalb der Akzeptanzkriterien liegen, die in den Kontrollendiagrammen angezeigt sind. Weitere Informationen finden Sie im Gerätehandbuch.

HINWEIS!

Erfüllt das Ergebnis der Positive Control bzw. Negative Control nicht die Annahmekriterien, wird die Meldung „Error“ (Fehler) im Bildschirm „Controls“ (Kontrollen) angezeigt. In diesem Fall können die Ergebnisse nicht genehmigt werden und die Positive Control bzw. Negative Control muss wiederholt werden.

HINWEIS!

Ist das Ergebnis der Positive Control bzw. Negative Control ungültig und wurden die Proben in denselben Testlauf einbezogen, können die Proben nicht genehmigt werden. In diesem Fall müssen alle Ergebnisse nach Wiederholung der Kontrollen interpretiert und genehmigt werden (siehe Bereich für Probenergebnisse).

Validierung der Probenergebnisse

Die **MyGenius PRO Software** interpretiert die PCR-Ergebnisse für die Zielsequenz (Kanal **EBV**) und die Internal Control (Kanal **IC**) mit den Assay-Protokoll-Parametern **EBV ELITe_My_WB_IU_200_100** und **EBV ELITe_My_WB_cmL_200_100**. Die resultierenden Ct-Zielwerte werden in Konzentrationswerte umgerechnet.

Die Ergebnisse werden im Bereich „Results“ (Ergebnisse) angezeigt.

Die Probenergebnisse können genehmigt werden, wenn die drei Bedingungen in der nachfolgenden Tabelle erfüllt sind.

1) Kalibrationskurve	**„Status“**
EBV Q-PCR Standard	APPROVED (Genehmigt)
2) Positivkontrolle	**„Status“**
EBV Positive Control	APPROVED (Genehmigt)
3) Negativkontrolle	**„Status“**
EBV Negative Control	APPROVED (Genehmigt)

Die Probenergebnisse werden von der **MyGenius PRO Software** automatisch anhand der Assay-Protokoll-Parameter interpretiert, wenn die Ergebnisse der zugehörigen Kalibration und Kontrollen genehmigt wurden. Wenn beim Erhalt der Probenergebnisse keine gültigen Kalibrationen und Kontrollen vorliegen und genehmigt wurden, können die Proben nicht interpretiert und genehmigt werden. In diesem Fall müssen die Kalibrationen und Kontrollen genehmigt und anschließend jede Probe im Bereich „Sample List“ (Probenliste) interpretiert und im Bereich „Results“ (Ergebnisse) über die entsprechenden Schaltflächen genehmigt werden.

Die möglichen Ergebnismeldungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Für jede Probe meldet das System eine Kombination aus den folgenden Meldungen, die angeben, ob die Pathogen-DNA nachgewiesen wurden oder nicht.

Ergebnis des Probenlaufs	Interpretation
EBV:DNA DETECTED, QUANTITY EQUAL TO XXXcopies/mL OR IU/ML (EBV:DNA ERKANNT, MENGE GLEICH XXXKopien/ml oder IU/ml)	In der Probe wurde **EBV-DNA** innerhalb des Messbereichs des Assays **nachgewiesen**, ihre Konzentration wird angezeigt.
EBV:DNA DETECTED, QUANTITY BELOW LLoQcopies/mL OR IU/mL (EBV:DNA ERKANNT, MENGE UNTER LLoQ)	In der Probe wurde **EBV-DNA nachgewiesen**, ihre Konzentration liegt unterhalb der unteren Bestimmungsgrenze des Assays.
EBV:DNA DETECTED, QUANTITY BEYOND ULoQ copies/mL OR IU/mL (EBV:DNA ERKANNT, MENGE GLEICH XXX)	In der Probe wurde **EBV-DNA nachgewiesen**, ihre Konzentration liegt oberhalb der oberen Bestimmungsgrenze des Assays.
EBV:DNA NOT DETECTED OR BELOW LoDcopies/mL OR IU/mL (EBV:DNA NICHT ERKANNT ODER UNTER LoD)	In der Probe wurde **keine EBV-DNA nachgewiesen**. Die Probe wurde negativ auf EBV-DNA getestet oder die Konzentration liegt unter der Nachweisgrenze des Assays.
INVALID - CHANGE REAGENTS (UNGÜLTIG - REAGENZIEN AUSWECHSELN)	**Ungültiges Testergebnis** durch fehlerhafte Internal Control (z. B. aufgrund von falscher Extraktion oder Verschleppung von Inhibitoren). Der Test sollte wiederholt werden.

Als „INVALID - CHANGE REAGENTS“ (UNGÜLTIG - REAGENZIEN AUSWECHSELN) ausgegebene Proben: In diesem Fall wurde die Internal-Control-DNA möglicherweise aufgrund von Problemen beim Probenentnahme-, Extraktions- oder PCR-Schritt nicht effizient erkannt (z. B. falsche Probenahme, Abbau oder Verlust von DNA während der Extraktion oder Inhibitoren im Eluat), was zu falschen Ergebnissen führen kann. In diesem Fall muss die Probe ab der Extraktion einer neuen Probe erneut getestet werden.

Als „EBV:DNA NOT DETECTED OR BELOW “LOD” COPIES/ML OR IU/ML“ (EBV:DNA nicht erkannt oder unter „LoD“ Kopien/ml oder IU/ml) ausgegebene Proben sind für die Analyse geeignet, EBV wurde jedoch nicht nachgewiesen. In diesem Fall kann entweder die Probe für EBV-DNA negativ sein oder die EBV-DNA ist bei einer Konzentration unter der Nachweisgrenze des Tests vorhanden (siehe Abschnitt 12, 12 LEISTUNGSMERKMALE BEI page 33).

EBV-DNA-positive Proben mit einer Konzentration unter der Nachweisgrenze (und der unteren Bestimmungsgrenze) des Assays werden, falls nachgewiesen, als „EBV:DNA DETECTED, QUANTITY BELOW “LLOQ” COPIES/ML“ (EBV: DNA erkannt, Menge unter „LLoQ“ Kopien/ml) ausgegeben (siehe Abschnitt 12, 12 LEISTUNGSMERKMALE page 33).

EBV-DNA-positive Proben innerhalb des linearen Messbereichs werden erkannt und als „EBV:DNA DETECTED, QUANTITY EQUAL TO “XXX” COPIES/ML OR IU/ML“ (EBV:DNA erkannt, Menge gleich „XXX“ Kopien/ml oder IU/ml) ausgegeben (siehe Abschnitt 12,12 LEISTUNGSMERKMALE BEI page 33).

EBV-DNA-positive Proben, die oberhalb der oberen Bestimmungsgrenze liegen, werden als „EBV: DNA DETECTED, QUANTITY BEYOND “ULOQ” COPIES/ML OR IU/ML“ (EBV: DNA erkannt, Menge über „ULoQ“ Kopien/ml oder IU/ml) ausgegeben (siehe Abschnitt 12, 12 LEISTUNGSMERKMALE BEI page 33) und sind nicht zur Quantifizierung geeignet. Falls erforderlich muss die Probe vor der Extraktion verdünnt und erneut getestet werden, um Ergebnisse innerhalb des linearen Messbereichs des Assays zu erzielen.

HINWEIS!

Bei der Interpretation der mit dem Assay erhaltenen Ergebnisse müssen alle relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunde herangezogen werden.

Die Probenergebnisse werden in der Datenbank gespeichert und können, falls gültig, durch Auswahl und Genehmigung im Bereich „Results“ (Ergebnisse) vom Benutzer genehmigt werden. Über das Fenster „Results“ können die Probenergebnisse durch Auswahl der gewünschten Proben und Drücken der entsprechenden Schaltfläche als „Summary Report“ (zusammenfassender Bericht) und „Details Report“ (Detailbericht) ausgedruckt und gespeichert werden.

Ausgabe des Probenergebnisberichts

Die Probenergebnisse werden in der Datenbank gespeichert, und Berichte können als „Summary Report“ (zusammenfassender Bericht) und „Details Report“ (Detailbericht) exportiert werden.

Der „Details Report“ zeigt die detaillierten Ergebnisse für jede ausgewählte Probe (SID, „Sample ID“) an.

Der „Summary Report“ zeigt die Interpretationsergebnisse für alle ausgewählten Proben (SID, „Sample ID“) an.

Der „Details Report“ und der „Summary Report“ können ausgedruckt und von autorisiertem Personal unterschrieben werden.

12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO

12.1 Nachweisgrenze (LoD)

Die Nachweisgrenze (LoD) des Assays in Verbindung mit den Matrizes in EDTA entnommenes Vollblut, EDTA-Plasma und Liquor wurde auf **ELITe InGenius**- oder **ELITe BeGenius**-Geräten durch Testen einer Reihe EBV-negativer Matrizes, die mit Referenzmaterial von EBV dotiert waren (1st WHO International Standard for Epstein-Barr Virus EBV for Nucleic Acid Amplification Techniques, NIBSC code 09/260, Vereinigtes Königreich), bestimmt. Die Ergebnisse wurden einer Probit-Regressionsanalyse unterzogen, und die LoD wurde als die Konzentration geschätzt, die einer 95 %igen Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses entspricht.

Die Ergebnisse für alle Matrizes sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

Tabelle 9 Nachweisgrenze (IU/ml)

Probenvolumen	Matrix	LoD	95 %-Konfidenzintervall	
			Untere Grenze	Obere Grenze
200 µl	EDTA-Vollblut	104 IU/ml	75 IU/ml	175 IU/ml
	EDTA-Plasma	124 IU/ml	77 IU/ml	290 IU/ml
	Liquor	176 IU/ml	112 IU/ml	346 IU/ml
1000 µl	EDTA-Plasma	18 IU/ml	13 IU/ml	28 IU/ml

Die analytische Sensitivität als Kopien/ml für jede Matrix wird unter Anwendung des spezifischen Umrechnungsfaktors berechnet, der im entsprechenden Abschnitt angegeben ist. 12.11 Faktor für die Umrechnung in internationale Einheiten page 43

Die analytische Sensitivität als Kopien/ml ist nachfolgend angegeben.

Tabelle 10 Nachweisgrenze (Kopien/ml)

Probenvolumen	Matrix	LoD	95 %-Konfidenzintervall	
			Untere Grenze	Obere Grenze
200 µl	EDTA-Vollblut	36 Kopien/ml	26 Kopien/ml	60 Kopien/ml
	EDTA-Plasma	65 Kopien/ml	41 Kopien/ml	153 Kopien/ml
	Liquor	80 Kopien/ml	51 Kopien/ml	157 Kopien/ml
1000 µl	EDTA-Plasma	11 Kopien/ml	8 Kopien/ml	17 Kopien/ml

Probenvolumen 200 µl: Zur Verifizierung des berechneten LoD-Werts für die einzelnen Matrizes wurde ein Matrixpool, der in der angegebenen Konzentration mit zertifiziertem EBV-Referenzmaterial dotiert war, auf ELITe InGenius und ELITe BeGenius getestet.

Die erhaltenen Ergebnisse für jede Matrix bestätigten die angegebene Konzentration für die Zielsequenz von EBV ELITe MGB Kit auf den Geräten ELITe InGenius und ELITe BeGenius.

Probenvolumen 1000 µl: Zur Verifizierung des berechneten LoD-Werts für die einzelnen Matrizes wurde ein Matrixpool, der in der angegebenen Konzentration mit zertifiziertem EBV-Referenzmaterial dotiert war, auf ELITe InGenius getestet. Die erhaltenen Ergebnisse bestätigten die behauptete Konzentration für das Zielgen des EBV ELITe MGB Kit sowohl bei ELITe InGenius.

Der auf ELITe InGenius und Vollblut-Matrix berechnete LoD-Wert ist auch für MyGenius PRO gültig.

12.2 Linearer Messbereich und Bestimmungsgrenzen

Zur Bestimmung des linearen Messbereichs des Assays wurde eine Reihe von EBV-Referenzmaterialien (Zeptometrix in Verbindung mit EDTA-Plasma und 1st WHO International Standard für Epstein-Barr Virus (EBV) zusammen mit EDTA-Vollblut und Liqour) in EBV-DNA-negativer Matrix in Verbindung mit **ELITe InGenius** und **ELITe BeGenius** verwendet.

Die Ergebnisse für jede Matrix sind in den folgenden Abschnitten angegeben.

Vollblut:

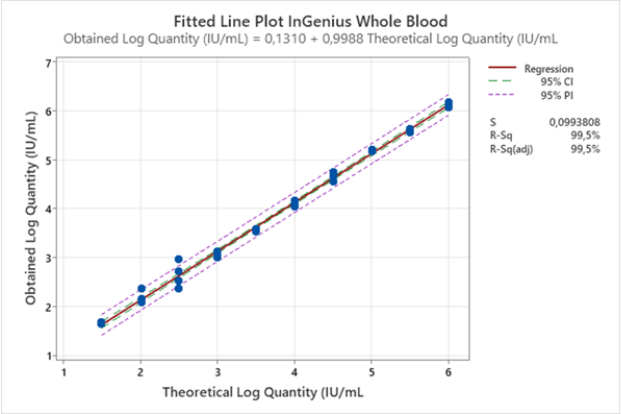

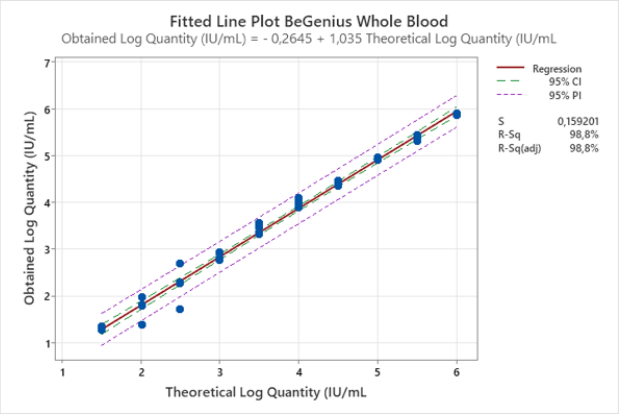

Der lineare Messbereich in Kopien/ml wird unter Anwendung des spezifischen Umrechnungsfaktors berechnet, der im entsprechenden Abschnitt angegeben ist. 12.11 Faktor für die Umrechnung in internationale Einheiten page 43

Die endgültigen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 11 Linearer Messbereich für Vollblutproben bei ELITe InGenius und ELITe BeGenius

Einheit	Untere Grenze	Obere Grenze
IU/ml	104	1.000.001
Kopien/ml	36	344.828

Der für ELITe InGenius und Vollblut-Matrix ermittelte lineare Messbereich ist auch für MyGenius PRO gültig.

Plasma:

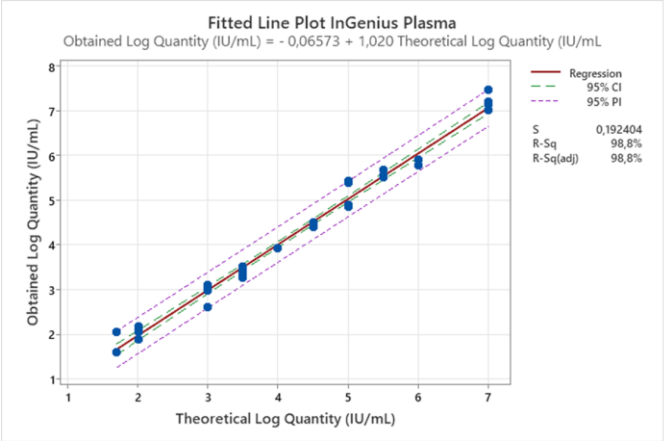

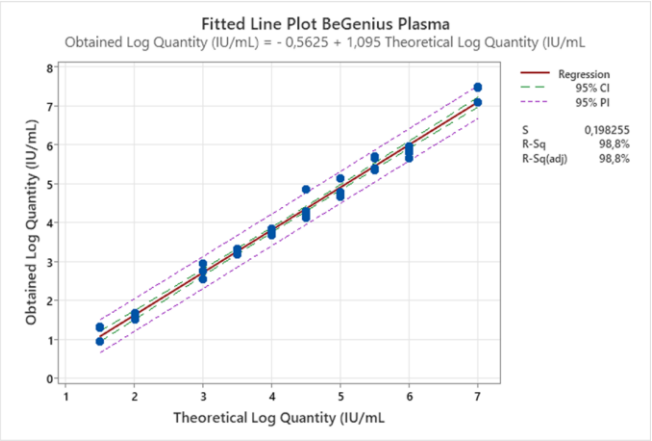

Der lineare Messbereich in gEq/ml für Plasma (Probenvolumen 200 µl) wird unter Anwendung des spezifischen Umrechnungsfaktors berechnet, der in Abschnitt angegeben ist. 12.11 Faktor für die Umrechnung in internationale Einheiten page 43

Die endgültigen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 12 Linearer Messbereich für Plasmaproben (200µL) und ELITe InGenius und ELITe BeGenius

Einheit	Untere Grenze	Obere Grenze
IU/ml	124	10.000.000
Kopien/ml	65	5.263.158

Der lineare Messbereich in Kopien/ml für Plasma (Probenvolumen 1000 µl) wird unter Anwendung des spezifischen Umrechnungsfaktors berechnet, der in Abschnitt 14.9 Umrechnung in internationale Einheiten Seite 55 angegeben ist.

Die endgültigen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 13 Linearer Messbereich für Plasmaproben (1000µL) und ELITe InGenius

Einheit	Untere Grenze	Obere Grenze
IU/ml	99	1000000
Kopien/ml	62	625000

Liquor:

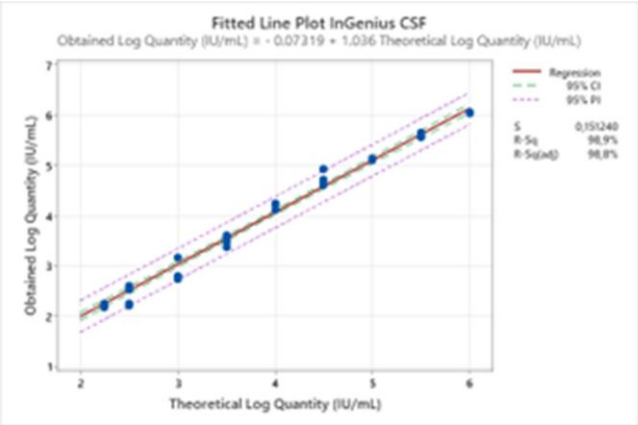

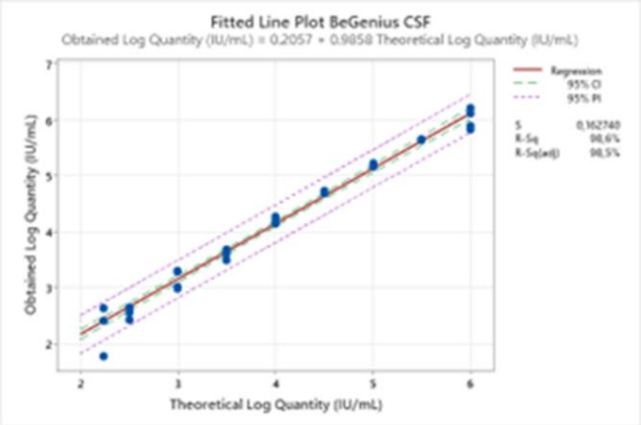

Der lineare Messbereich als Kopien/ml für Liquor wird unter Anwendung des spezifischen Umrechnungsfaktors berechnet, der im Abschnitt 12.11 12.10 Faktor zur Umrechnung in internationale Einheiten auf Seite 34 page 43 angegeben ist.

Die endgültigen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 14 Linearer Messbereich für Liqourproben (200 µl) und ELITe InGenius und ELITe BeGenius

Einheit	Untere Grenze	Obere Grenze
IU/ml	176	1000000
Kopien/ml	80	454545

12.3 Unsicherheit der Standardkurve

Der Unsicherheitswert der Standardkurve wurde durch Kombination der zufälligen Fehler (SD) aller Levelquantifizierungen und Multiplikation mit dem Abdeckungsfaktor k = 2 (erweiterte kombinierte Unsicherheit) berechnet und beträgt 0,2949 log Kopien/Reaktion.

Tabelle 15

Standardkurven-Levels	Theoretisch	Gemessen	SD	Erweiterte kombinierte Unsicherheit
	Log Kopien/ Reaktion	Log Kopien/ Reaktion		
EBV Q - PCR Standard 10^5	5,0000	5,0032	0,0636	0,2949
EBV Q - PCR Standard 10^4	4,0000	3,9860	0,0739	
EBV Q - PCR Standard 10^3	3,0000	3,0184	0,0654	
EBV Q - PCR Standard 10^2	2,0000	1,9924	0,0892	

12.4 Inklusivität: Nachweis- und Quantifizierungseffizienz bei verschiedenen Genotypen

Die Inklusivität des Assays als die Nachweiseffizienz für verschiedene Genotypen des EBV wurde mittels *In-silico*-Analyse der in den Nukleotid-Datenbanken verfügbaren Sequenzen bewertet. Die Analyse zeigte eine Sequenzerhaltung und ein Nichtvorhandensein signifikanter Mutationen. Daher wird ein effizienter Nachweis für die verschiedenen Stämme oder Isolate erwartet.

12.5 Potenziell interferierende Marker: Kreuzreaktivität

Die potenzielle Kreuzreaktivität mit unbeabsichtigten Organismen, die in klinischen Proben vorkommen können, wurde durch eine *In-silico*-Analyse bewertet. Die Analyse ergab keine signifikante Homologie mit anderen unbeabsichtigten Organismen (Viren, Bakterien, Protozoen und Pilze). Es dürfte daher keine Kreuzreaktivität zu erwarten sein.

Das Fehlen einer Kreuzreaktivität mit potenziell interferierenden Organismen wurde auch durch die Analyse des Panels unbeabsichtigter Organismen (ATCC, ZeptoMetrix) mit hohem Titer überprüft.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 16 Potenziell interferierender Organismus

Probe	Pos. / Wiederh.	Ergebnis
CMV	0/5	Keine Kreuzreaktivität
HHV6	0/5	Keine Kreuzreaktivität

Tabelle 16 Potenziell interferierender Organismus (continued)

HHV7	0/5	Keine Kreuzreaktivität
HHV8	0/5	Keine Kreuzreaktivität
HSV1	0/5	Keine Kreuzreaktivität
HSV2	0/5	Keine Kreuzreaktivität
VZV	0/5	Keine Kreuzreaktivität

Alle getesteten potenziell interferierenden Marker wiesen für die EBV-Zielamplifikation mit dem EBV ELITe MGB Kit keine Kreuzreaktivität auf.

12.6 Potenziell interferierende Marker: Inhibition

Die potenzielle Inhibition unbeabsichtigter Organismen, die in klinischen Proben vorkommen können, wurde für den Assay durch die Analyse eines Panels unbeabsichtigter Organismen in EBV-positiven Proben verschiedener Anbieter (ATCC, ZeptoMetrix) bewertet.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 17 Potenziell interferierender Organismus

Probe	Pos. / Wiederh.	Ergebnis
CMV	5/5	Keine Interferenz
HHV6	5/5	Keine Interferenz
HHV7	5/5	Keine Interferenz
HHV8	5/5	Keine Interferenz
HSV1	5/5	Keine Interferenz
HSV2	5/5	Keine Interferenz
VZV	5/5	Keine Interferenz

Bei allen getesteten potenziell interferierenden Organismen zeigte der Test mit dem EBV ELITe MGB Kit keine Interferenz des Nachweises und der Quantifizierung der EBV-Zielsequenz.

12.7 Potenziell interferierende Substanzen: Kreuzreaktivität

Die Kreuzreaktivität mit potenziell störenden (endogenen und exogenen) Substanzen, die in klinischen Proben vorkommen können, wurde für den Assay durch die Analyse einer Reihe von Substanzen in relevanten Konzentrationen bewertet.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 18 Vollblut

Proben	EBV Pos. / Wiederh.	Ergebnis
Bilirubin	0/3	Keine Kreuzreaktivität
EDTA	0/3	Keine Kreuzreaktivität
Ganciclovir	0/3	Keine Kreuzreaktivität
Azithromycin	0/3	Keine Kreuzreaktivität
Ribavirin	0/3	Keine Kreuzreaktivität

Tabelle 18 Vollblut (continued)

Proben	EBV Pos. / Wiederh.	Ergebnis
Abacavir-Sulfat	0/3	Keine Kreuzreaktivität
Cidofovir	0/3	Keine Kreuzreaktivität
Cyclosporin A	0/3	Keine Kreuzreaktivität
Heparin	0/3	Ungültige Proben
Vancomycin	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Ciprofloxacin	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Cefpodoxim	0/5	Keine Kreuzreaktivität

Der Test zeigte, dass bei Verwendung des EBV ELITe MGB Kit die meisten der Substanzen nicht mit dem Nachweis und der Quantifizierung der EBV-Zielsequenz kreuzreagieren. Es wurde bestätigt, dass Heparin in der Lage ist, die Amplifikation von EBV und der Internal Control zu hemmen.

Tabelle 19 Plasma

Proben	EBV Pos. / Wiederh.	Ergebnis
Bilirubin	0/5	Keine Kreuzreaktivität
EDTA	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Ganciclovir	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Azithromycin	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Ribavirin	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Abacavir-Sulfat	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Cidofovir	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Cyclosporin A	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Heparin	0/5	Ungültige Proben
Vancomycin	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Ciprofloxacin	0/5	Keine Kreuzreaktivität
Cefpodoxim	0/5	Keine Kreuzreaktivität

Der Test zeigte, dass bei Verwendung des EBV ELITe MGB Kit die meisten der Substanzen nicht mit dem Nachweis und der Quantifizierung der EBV-Zielsequenz kreuzreagieren. Es wurde bestätigt, dass Heparin in der Lage ist, die Amplifikation von EBV und der Internal Control zu hemmen.

12.8 Potenziell interferierende Substanzen: Inhibition

Die potenzielle Inhibition interferierender Substanzen (endogen und exogen), die in klinischen Proben vorkommen können, wurde für den Assay durch die Analyse einer Reihe von Substanzen in relevanten Konzentrationen in EBV-positiven Proben bewertet.

Die Ergebnisse für jede Matrix sind in den folgenden Abschnitten angegeben.

Tabelle 20 Vollblut

Proben	EBV Pos. / Wiederh.	Ergebnis
Bilirubin	3/3	Keine Interferenz
EDTA	3/3	Keine Interferenz
Ganciclovir	3/3	Keine Interferenz
Azithromycin	3/3	Keine Interferenz
Ribavirin	3/3	Keine Interferenz
Abacavir-Sulfat	3/3	Keine Interferenz
Cidofovir	3/3	Keine Interferenz
Cyclosporin A	3/3	Keine Interferenz
Heparin	3/3	Keine Interferenz
Vancomycin	5/5	Keine Interferenz
Ciprofloxacin	5/5	Keine Interferenz
Cefpodoxim	5/5	Keine Interferenz

Der Test zeigte, dass bei Verwendung des EBV ELITe MGB Kit keine der Substanzen mit dem Nachweis und der Quantifizierung der EBV-Zielsequenz interferiert.

Tabelle 21 Plasma

Probe	EBV Pos. / Wiederh.	Ergebnis
Bilirubin	5/5	Keine Interferenz
EDTA	5/5	Keine Interferenz
Ganciclovir	5/5	Keine Interferenz
Azithromycin	5/5	Keine Interferenz
Ribavirin	5/5	Keine Interferenz
Abacavir-Sulfat	5/5	Keine Interferenz
Cidofovir	5/5	Keine Interferenz
Cyclosporin A	5/5	Keine Interferenz
Heparin	0/5 ungültige Proben	Interferenz
Vancomycin	5/5	Keine Interferenz
Ciprofloxacin	5/5	Keine Interferenz
Cefpodoxim	5/5	Keine Interferenz

Der Test zeigte, dass bei Verwendung des EBV ELITe MGB Kit keine der Substanzen, mit Ausnahme von Heparin, mit dem Nachweis und der Quantifizierung der EBV-Zielsequenz interferiert.

Tabelle 22 Liquor

Probe	EBV Pos. / Wiederh.	Ergebnis
Glucose	5/5	Keine Interferenz
Lactat	5/5	Keine Interferenz
Albumin	5/5	Keine Interferenz
Immunglobulin	5/5	Keine Interferenz
Hämoglobin	5/5	Keine Interferenz
Weiße Blutkörperchen	5/5	Keine Interferenz
Vollblut	5/5	Keine Interferenz
Ethanol	5/5	Keine Interferenz
Cefpodoxim	5/5	Keine Interferenz
Ampicillin	5/5	Keine Interferenz
Azithromycin	5/5	Keine Interferenz
Vancomycin	5/5	Keine Interferenz
Gentamicin	5/5	Keine Interferenz
Meropenem	5/5	Keine Interferenz
Ganciclovir	5/5	Keine Interferenz
Acyclovir	5/5	Keine Interferenz
Fluconazol	5/5	Keine Interferenz
Ciclosporin	5/5	Keine Interferenz

Der Test zeigte, dass bei Verwendung des EBV ELITe MGB Kit keine der Substanzen mit dem Nachweis und der Quantifizierung der EBV-Zielsequenz interferiert.

12.9 Wiederholpräzision

Zur Bewertung der Wiederholpräzision innerhalb eines Laufs und der laufübergreifenden Wiederholpräzision des Assays wurde mit ELITe InGenius und ELITe BeGenius eine Reihe von in EDTA entnommenen Vollblutproben analysiert, einschließlich einer negativen Probe und zweier Proben, die mit zertifiziertem EBV-Referenzmaterial (1st WHO EBV International Standard, NIBSC) dotiert waren.

Ein Beispiel für die Ergebnisse der Wiederholpräzision innerhalb eines Laufs (an einem Tag) ist in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Tabelle 23 Wiederholpräzision innerhalb des Laufs auf ELITe InGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstim-mung
Negativ	8	-	-	-	100 %
3 x LoD	8	35,68	0,57	1,60	100 %
10 x LoD	8	34,22	0,24	0,70	100 %

Tabelle 24 Wiederholpräzision innerhalb des Laufs auf ELITe BeGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstimmung
Negativ	8	-	-	-	100 %
3 x LoD	8	37,32	0,49	1,30	100 %
10 x LoD	8	35,97	0,43	1,19	100 %

Ein Beispiel für die Ergebnisse der laufübergreifenden Wiederholpräzision (an zwei Tagen) ist in den nachstehenden Tabellen aufgeführt.

Tabelle 25 Laufübergreifende Wiederholpräzision auf ELITe BeGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit – Tag 1-2				
	Anzahl	Mittlerer EBV-Ct-Wert	SD EBV Ct	KV % EBV-Ct	% Übereinstimmung
Negativ	14	-	-	-	100 %
3 x LoD	16	37,29	0,67	1,79	100 %
10 x LoD	16	35,82	0,67	1,86	100 %

Tabelle 26 Laufübergreifende Wiederholpräzision auf ELITe InGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit – Tag 1-2				
	Anzahl	Mittlerer EBV-Ct-Wert	SD EBV Ct	KV % EBV-Ct	% Übereinstimmung
Negativ	14	-	-	-	100 %
3 x LoD	16	35,72	0,53	1,48	100 %
10 x LoD	16	34,39	0,37	1,07	100 %

Beim Test der Wiederholpräzision erkannte der EBV ELITe MGB Kit alle Proben wie erwartet und wies eine maximale Variabilität der Ct-Zielwerte als VK% unter 5 % aus.

12.10 Vergleichspräzision

Zur Bewertung der Vergleichspräzision des Assays mit ELITe BeGenius und ELITe InGenius wurde ein Panel von in EDTA-Proben entnommenen Vollblutproben, einschließlich einer negativen Probe und zweier Proben, die mit zertifiziertem EBV-Referenzmaterial (1st WHO International Standard, NIBSC) dotiert waren, analysiert.

Eine Übersicht der geräteübergreifenden Vergleichspräzision (bei zwei Geräten) ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Tabelle 27 Geräteübergreifende Vergleichspräzision auf ELITe InGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstim-mung
Negativ	8	-	-	-	100 %
3 x LoD	8	35,78	0,44	1,24	100 %
10 x LoD	8	30,38	0,36	1,17	100 %

Tabelle 28 Geräteübergreifende Vergleichspräzision auf ELITe BeGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstimmung
Negativ	7	-	-	-	100 %
3 x LoD	8	36,79	0,86	2,32	100 %
10 x LoD	8	35,15	0,65	1,84	100 %

Eine Übersicht der chargenübergreifenden Vergleichspräzision (bei zwei Chargen) ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Tabelle 29 Chargenübergreifende Vergleichspräzision auf ELITe InGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstimmung
Negativ	8	-	-	-	100 %
3 x LoD	8	35,91	0,38	1,06	100 %
10 x LoD	8	34,48	0,15	0,43	100 %

Tabelle 30 Chargenübergreifende Vergleichspräzision auf ELITe BeGenius

Probe	EBV ELITe MGB Kit				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstim-mung
Negativ	7	-	-	-	100 %
3 x LoD	8	37,45	0,65	1,72	100 %
10 x LoD	8	35,57	0,42	1,18	100 %

Beim Test der Vergleichspräzision erkannte der EBV ELITe MGB Kit alle Proben wie erwartet und wies eine maximale Variabilität der Ct-Zielwerte als VK% unter 5 % aus.

12.11 Faktor für die Umrechnung in internationale Einheiten

Der Umrechnungsfaktor zur Angabe der quantitativen Ergebnisse von Kopien/ml in internationale Einheiten (International Units, IU) wurde für jede Matrix berechnet. Hierfür wurde das zertifizierte kalibrierte Referenzmaterial („1st WHO International Standard for Epstein-Barr Virus (EBV) for Nucleic Acid Amplification Techniques“ (NIBSC) verwendet.

Die Ergebnisse für jede Matrix sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 31 Faktor für die Umrechnung in internationale Einheiten

Probenvolumen	Matrix	Umrechnungsfaktor Fc (IU/Kopien)
200 µl	Vollblut	2,9
	Plasma	1,9
	Liquor	2,2
1000 µl	Plasma	1,6

Der für ELITe InGenius und Vollblut-Matrix berechnete Faktor für die Umrechnung in internationale Einheiten ist auch für MyGenius PRO gültig.

(Probenvolumen 200 µl) Der Umrechnungsfaktor von Kopien/ml in internationale Einheiten (IU) / ml zur Angabe der quantitativen Ergebnisse wurde auf den Geräten **ELITe InGenius** und **ELITe BeGenius** unter Verwendung des zertifizierten kalibrierten Referenzmaterials (1st WHO International Standard, NIBSC) verifiziert. Zur Berechnung der Korrelation wurden die erhaltenen Ergebnisse mittels orthogonaler und linearer Regression analysiert.

Die Ergebnisse für jede Matrix sind in den folgenden Abschnitten angegeben.

Vollblut

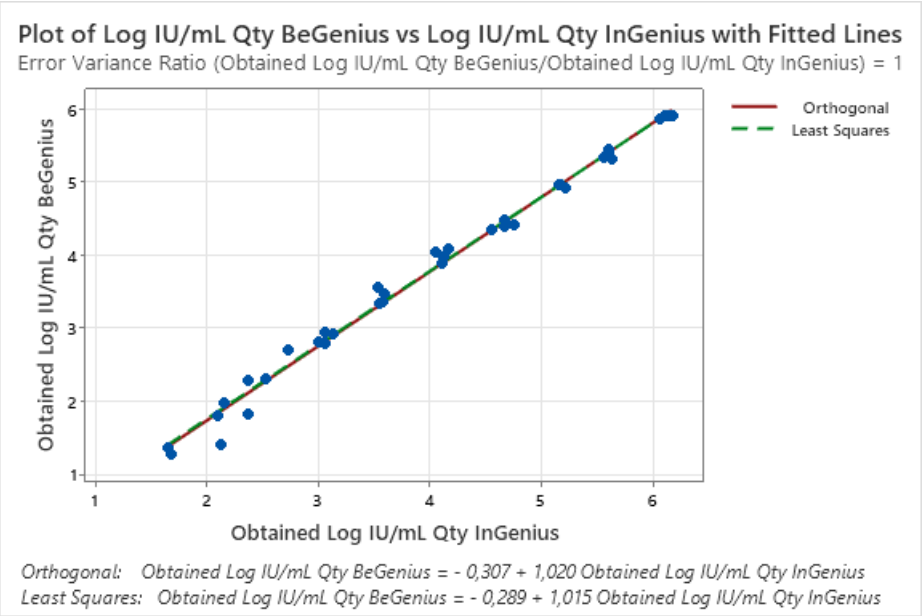

Die orthogonale Regressionsanalyse ergab einen Achsenabschnitt von -0,307 (95%-KI: -0,4419 bis -0,1725) und eine Steigung von 1,020 (95%-KI: 0,9879 bis 1,0512). Die Analyse der linearen Regression ergab einen R2-Wert von 0,991.

Plasma:

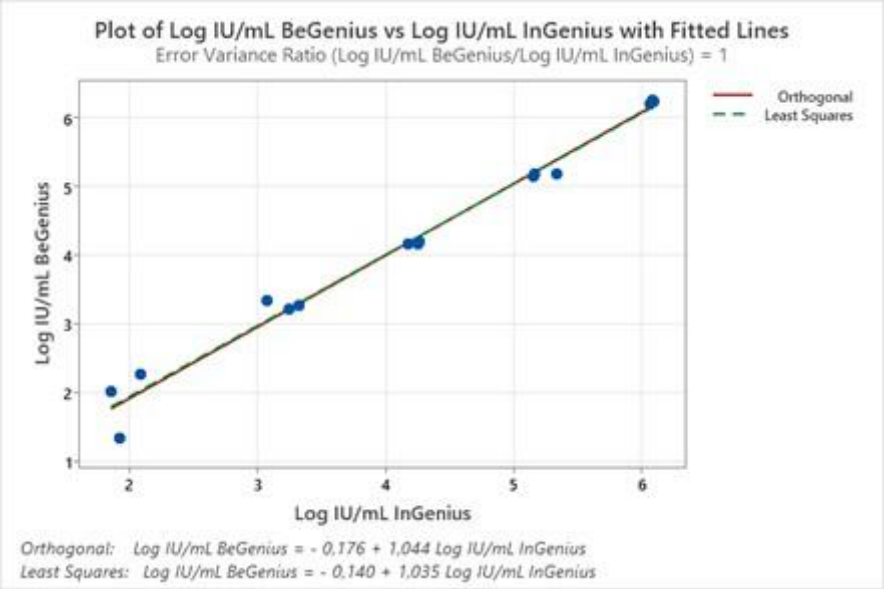

Die orthogonale Regressionsanalyse ergab einen Achsenabschnitt von -0,176 (95%-KI: -0,496 bis 0,112) und eine Steigung von 1,044 (95%-KI: 0,981 bis 1,121). Die Analyse der linearen Regression ergab einen R2-Wert von 0,984.

Liquor:

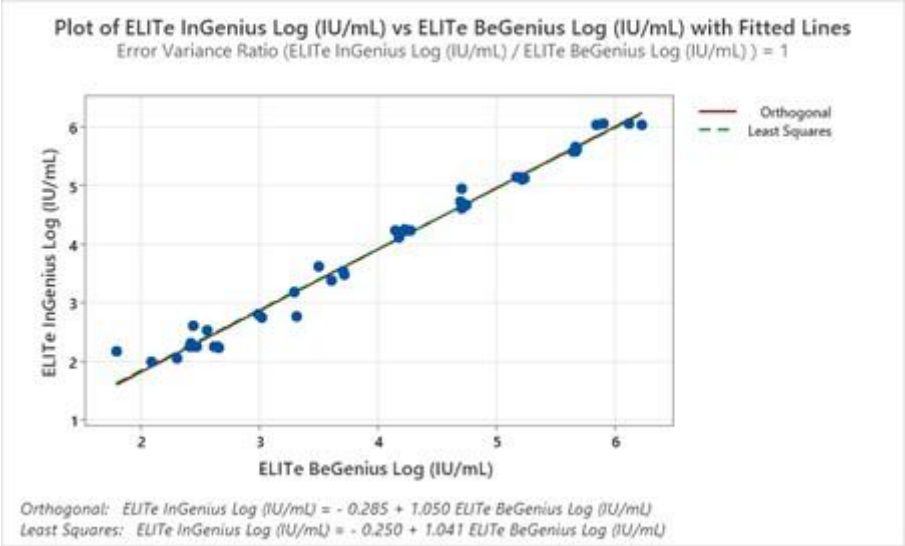

Die orthogonale Regressionsanalyse ergab einen Achsenabschnitt von 0,285 (95%-KI: -0,4623 bis -0,1067) und eine Steigung von 1,050 (95%-KI: 1,0076 bis 1,0925). Die Analyse der linearen Regression ergab einen R2-Wert von 0,984.

12.12 MyGenius PRO: Methodenkorrelation

Die Auswertung der Korrelationsanalyse verschiedener Methoden erfolgte auf MyGenius PRO durch die Analyse von EBV-Proben von Patienten, deren Viruslast innerhalb des Messbereichs der Referenzmethode (ELITe InGenius) lag. Die mit MyGenius PRO und der Referenzmethode (ELITe InGenius) erhaltenen Ergebnisse wurden mittels orthogonaler und linearer Regression analysiert.

Die Korrelationsstudie wurde an einem Standort mit 136 positiven klinischen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut, die für EBV-DNA als positiv bestätigt oder mit Referenzmaterial dotiert worden waren, getestet, wobei ELITe InGenius als Komparator verwendet wurde.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst.

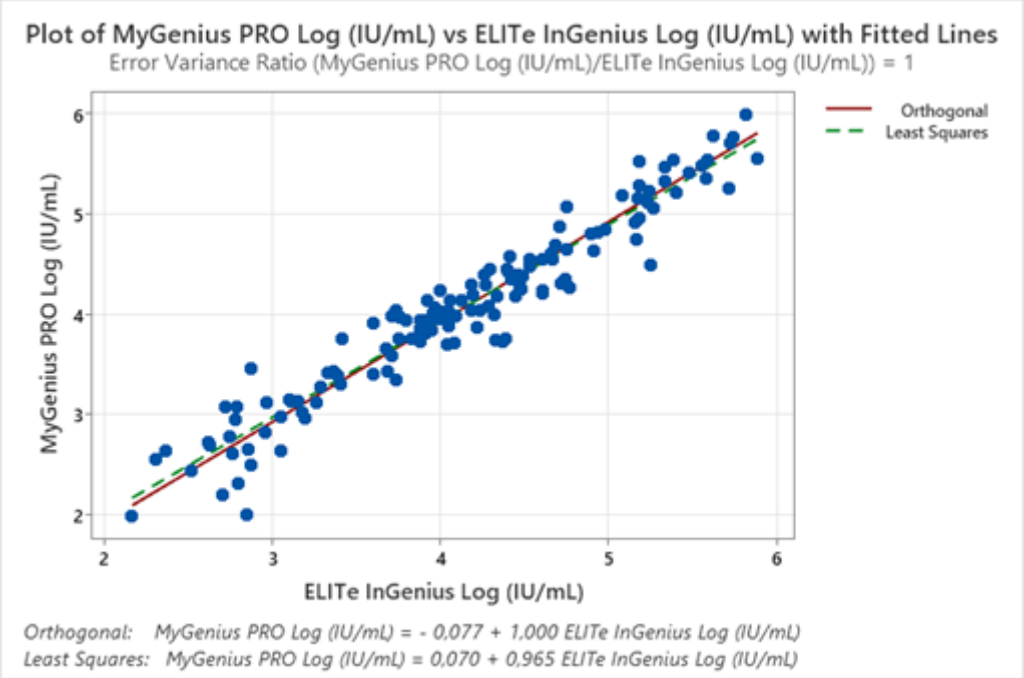

Die orthogonale Regressionsanalyse ergab einen Achsenabschnitt von -0,0767 (95%-KI: -0,2726 bis 0,1190) und eine Steigung von 1,000 (95%-KI: 0,9537 bis 1,0465). Die Analyse der linearen Regression ergab einen R2-Wert von 0,930.

12.13 Diagnostische Spezifität: Bestätigung negativer Proben

Zur Bewertung der diagnostischen Spezifität des Assays als Bestätigung negativer Proben wurden negative klinische Proben von in EDTA entnommenem Vollblut, in EDTA entnommenem Plasma und Liquor in Verbindung mit **ELITe InGenius** oder **ELITe BeGenius** analysiert.

Da EBV-Produkte auf **ELITe BeGenius** und **ELITe InGenius** gleichwertige analytische Leistungen aufwiesen, ist die diagnostische Güte der auf den beiden Geräten durchgeführten Tests bei einem Extraktionsvolumen von 200 µl ebenfalls als gleichwertig anzusehen. Daher gilt die mit ELITe InGenius erhaltene diagnostische Spezifität des Assays auch für ELITe BeGenius und umgekehrt.

Bei einem Extraktionsvolumen von 1000 µl beziehen sich die angezeigten Ergebnisse jedoch nur auf das Gerät ELITe InGenius.

Da **MyGenius PRO** gleichwertige analytische Leistungen wie ELITe InGenius in Verbindung mit der Matrix EDTA-Vollblut aufwies, ist die diagnostische Güte der auf den beiden Geräten mit der Matrix EDTA-Vollblut durchgeführten Tests ebenfalls als gleichwertig anzusehen. Daher gilt die mit ELITe InGenius erhaltene diagnostische Spezifität des Assays auch für MyGenius PRO.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 32 Diagnostische Spezifität

Proben	Probenvo-lumen	Anzahl	Positiv	Negativ	Diagnostische Spezifität in %
In EDTA entnommenes, EBV-DNA-negatives Vollblut	200 µl	110	3	107	97,3
In EDTA entnommenes, EBV-DNA-negatives Plasma	200 µl	113	1	112	98,3
	1000 µl	62	2	60	
EBV-DNA-negativer Liquor	200 µl	77	0	77	100

Der Ct-Grenzwert für die IC wurde beim Test mit ELITe InGenius, ELITe BeGenius bzw. MyGenius PRO für in EDTA entnommene Vollblutproben auf 35 festgelegt.

Der Ct-Grenzwert für die IC wurde beim Test mit ELITe InGenius bzw. ELITe BeGenius für in EDTA entnommene Plasmaproben und Liquorproben auf 35 festgelegt.

12.14 Diagnostische Sensitivität: Bestätigung positiver Proben

Zur Bewertung der diagnostischen Sensitivität des Assays als Bestätigung positiver klinischer Proben wurden negative positive oder dotierte klinische Proben von in EDTA entnommenem Vollblut, in EDTA entnommenem Plasma und Liquor in Verbindung mit **ELITe InGenius** oder **ELITe BeGenius** analysiert.

Da EBV-Produkte auf **ELITe BeGenius und ELITe InGenius,** gleichwertige analytische Leistungen aufwiesen, ist die diagnostische Güte der auf den beiden Geräten durchgeführten Tests bei einem Extraktionsvolumen von 200 µl ebenfalls als gleichwertig anzusehen. Daher gilt die mit ELITe InGenius erhaltene diagnostische Sensitivität des Assays auch für ELITe BeGenius und umgekehrt.

Bei einem Extraktionsvolumen von 1000 µl beziehen sich die angezeigten Ergebnisse jedoch nur auf das Gerät ELITe InGenius.

Da MyGenius PRO gleichwertige analytische Leistungen wie ELITe InGenius in Verbindung mit der Matrix EDTA-Vollblut aufwies, ist die diagnostische Güte der auf den beiden Geräten mit der Matrix EDTA-Vollblut durchgeführten Tests ebenfalls als gleichwertig anzusehen. Daher gilt die mit ELITe InGenius erhaltene diagnostische Sensitivität des Assays auch für MyGenius PRO.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 33 Diagnostische Sensitivität

Proben	Probenvolumen	Anzahl	Positiv	Negativ	Diagnostische Sensitivität in %
In EDTA entnommenes, EBV-DNA-positives Vollblut	200 µl	133	131	2	98,5
In EDTA entnommenes, EBV-DNA-positives Plasma	200 µl	12	12	0	98,9
In EDTA entnommenes, mit EBV-DNA dotiertes Plasma	200 µl	46	46	0	
	1000 µl	30	29	1	
EBV-DNA-positiver Liquor	200 µl	4	3	1	98,8
Mit EBV-DNA dotierter Liquor		80	80	0	

HINWEIS!

Die vollständigen Daten und Ergebnisse der Tests, die zur Bewertung der Leistungsmerkmale des Produkts mit Matrizes und Geräten durchgeführt wurden, sind in der technischen Dokumentation für das „EBV ELITe MGB® Kit“, FTP020PLD, aufgeführt.

13 PROBEN UND KONTROLLEN BEI ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument

13.1 Proben

Die folgenden Proben und Nukleinsäureextraktionsmethoden sind für die Verwendung mit dem **EBV ELITe MGB Kit** unter Verwendung des ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument validiert.

Tabelle 34

Probentyp	Kit/Methode	Protokoll	Eingangsvolumen (µl)	Elutionsvolumen (µl)	Mindestvolumen Primärröhrchen (µl)	Besondere Anweisung
Vollblut	ELITe GALAXY	xNA Extraction (Universal)	300	200	400-650	10 µl/CPE-Probe zur IC + Trägerlösung geben

13.2 Störende Substanzen

Die aus der Probe extrahierte DNA darf kein Heparin, Hämoglobin, Dextran, Ficoll®, Ethanol oder 2-Propanol enthalten, um Inhibitionsprobleme und die Möglichkeit häufiger ungültiger Ergebnisse zu verhindern.

Eine große Menge humaner genomischer DNA in der aus der Probe extrahierten DNA kann die Amplifikationsreaktion hemmen.

Es liegen keine Daten zu einer Inhibition durch antivirale, antibiotische, chemotherapeutische oder immunsupprimierende Medikamente vor.

Keine Proben verwenden, die in Heparin entnommen wurden, da dieses bekanntlich die reverse Transkription und PCR hemmt.

13.3 Amplifikationskontrollen

Jeder Amplifikationslauf muss mit einer Negative Control-Reaktion und einer Positive Control-Reaktion validiert werden.

Für die Negative Control muss statt der aus der Probe extrahierten DNA hochreines Wasser für die Molekularbiologie (nicht im Lieferumfang dieses Kits enthalten) zur Reaktion hinzugefügt werden.

Für die Positive Control das Produkt **EBV - ELITePositive Control** oder das Produkt **EBV - ELITe Standard** verwenden.

13.4 Qualitätskontrollen

Es wird empfohlen, das Extraktions- und PCR-Verfahren zu überprüfen. Es können archivierte Proben oder zertifiziertes Referenzmaterial verwendet werden. Externe Kontrollen sind gemäß den einschlägigen Anforderungen der lokalen, staatlichen und föderalen Akkreditierungsorganisationen zu verwenden.

14 VERFAHREN BEIM ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument

14.1 Einrichten des Echtzeit-Amplifikationslaufs

Vor Beginn des Laufs gemäß der Gerätedokumentation Folgendes durchführen:

- Gerät einschalten, Computer einschalten, dedizierte Software und einen Lauf für die „absolute Quantifizierung“ öffnen und „Run mode: Fast 7500“ (Laufmodus: Fast 7500) einstellen;
- im Detector Manager den Detektor („detector“) für die EBV-Sonde so einrichten, dass „reporter“ (Reporter) = „FAM“ und „quencher“ (Quencher) = „none“ (nicht fluoreszenzierend) ist, und mit „EBV“ kennzeichnen;
- im Detector Manager den Detektor („detector“) für die Sonde für die interne Kontrolle so einrichten, dass „reporter“ (Reporter) = „VIC“ (AP525 ist analog zu VIC) und „quencher“ (Quencher) = „none“ (nicht fluoreszenzierend) ist, und mit „IC“ kennzeichnen;
- für jede in der Mikrotiterplatte verwendete Vertiefung im Well Inspector den Detektor („detector“) (zu messende Fluoreszenz) so einrichten, dass „passive reference“ (passive Referenz) = „Cy5“ (AP593 wird statt Cy5 zur Normalisierung der Fluoreszenzniveaus verwendet) ist, und Reaktionstyp festlegen (Probe, negative Kontrolle, positive Kontrolle oder Standard bei bekannter Menge).

HINWEIS!
Zum Quantifizieren der DNA in der Ausgangsprobe eine Reaktionsreihe mit den **Q-PCR Standards** (10^5 Kopien, 10^4 Kopien, 10^3 Kopien, 10^2 Kopien) einbeziehen, um die **Standardkurve** zu erhalten.

Nachfolgend ist beispielhaft aufgeführt, wie die quantitative Analyse von 12 Proben eingerichtet wird.

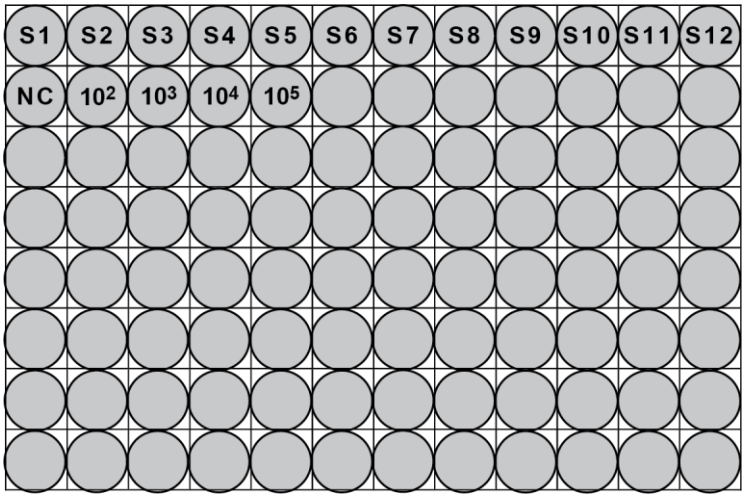

Legende: S1 -**S12**: Zu analysierende Proben;**NC**:Negative Controlder Amplifikation;

10 ²: 10^2-Standardkopien;**10³**: 10^3-Standardkopien;**10⁴**: 10^4-Standardkopien;**10⁵**: 10^5-Standardkopien.

Die Parameter des **Temperaturzyklus** gemäß der Gerätedokumentation („Instrument > Thermal Cycler Protocol > Thermal Profile“ (Gerät > Thermocycler-Protokoll > Temperaturprofil)) festlegen:

- eine **20-sekündige Verlängerung bei 72 °C** hinzufügen („Add Step“);

HINWEIS!

Hinweis: Die Fluoreszenzerfassung muss während des Hybridisierungsschritts auf 60 °C eingestellt werden („Instrument > Thermal Cycler Protocol > Settings > Data Collection“ (Gerät > Thermocycler-Protokoll > Einstellungen > Datenerfassung)).

- Thermocycler-Temperaturen und -Zeiten wie in der Tabelle **„Temperaturzyklus“** angegeben ändern;
- die Anzahl Zyklen auf **45** einstellen;
- das Probenvolumen auf **30 µl** einstellen;
- optional: eine Dissoziationsphase hinzufügen („Add Dissociation Stage“), die Starttemperatur auf **40 °C** und die Endtemperatur auf **80 °C** einstellen.

Tabelle 35 Temperaturzyklus

Phase	Temperaturen	Zeitsteuerung
Dekontamination	50 °C	2 min.
Erste Denaturierung	94 °C	2 min.
Amplifikation und Detektion (45 Zyklen)	94 °C	10 s
	60 °C (Fluoreszenzerfassung)	30 s
	72 °C	20 s
Dissoziation (optional)	95 °C	15 s
	40 °C	1 min.
	80 °C	15 s
	60 °C	15 s

14.2 Einrichtung des Echtzeit-PCR-Laufs

(Durchgeführt vom Gerät **ELITe GALAXY**)

Zum Einrichten des PCR-Laufs:

- die für den Lauf benötigten **Q-PCR Mix** Röhrchen auftauen (jedes Röhrchen reicht für **25 Reaktionen** aus).
- die **Positive Control**- (qualitative Analyse: Nachweis von extrahierter DNA) oder die **Q - PCR Standard**- (quantitative Analyse: Quantifizierung von extrahierter DNA) Röhrchen auftauen
- Die Reagenzien vorsichtig mischen und den Inhalt 5 Sekunden lang herunterzentrifugieren
- die **Negative Control** (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß der Gebrauchsanweisung des Geräts vorbereiten
- eine **Q-PCR Microplate** vorbereiten. Mit puderfreien Handschuhen anfassen und die Vertiefungen nicht beschädigen.

HINWEIS!

Zum Vorbereiten der PCR auf dem **ELITe GALAXY** die Elutions-Mikrotiterplatte, welche die extrahierten DNA-Proben, die Reagenzien und die **Q - PCR Microplate** wie in der Gebrauchsanweisung des Geräts angegeben laden und die Schritte auf der grafischen Benutzeroberfläche befolgen.

Das Gerät bereitet automatisch die PCR vor, indem es in jede Vertiefung der **Q-PCR Microplate** Folgendes dispensiert:

- **20 µl Q-PCR Mix**
- **20 µl extrahierte DNA / Q-PCR Standard / Kontrollen**

HINWEIS!

Wenn der Q-PCR-Mix nicht vollständig aufgebraucht wird, das Restvolumen maximal einen Monat bei -20 °C dunkel aufbewahren. Den Q-PCR Mix maximal **5** Gefrier- und Auftauzyklen unterziehen.

Nachdem das Gerät die PCR vorbereitet hat:

- die **Q-PCR Microplate** mit einer optisch klaren Dichtungsfolie verschließen
- die **Q-PCR Microplate** auf das **7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument** überführen und die PCR starten. Die Laufdatei mit einem eindeutigen und wiedererkennbaren Namen (z. B. „Jahr-Monat-Tag-TARGET-EGSpA“) speichern.

HINWEIS!

Am Ende der PCR muss die **Q-PCR Microplate** unter Berücksichtigung sämtlicher gesetzlicher und umweltrechtlicher Vorschriften entsorgt werden. Um ein Verschütten der PCR-Produkte zu vermeiden, **darf die optisch klare Dichtungsfolie nicht von der Q-PCR Microplate entfernt werden**.

14.3 Allgemeine Einstellungen zur Analyse der Ergebnisse

Vor Beginn der Analyse gemäß der Gerätedokumentation Folgendes durchführen:

- den Berechnungsbereich für die **Grundlinie** (Fluoreszenz-Hintergrundniveau) von Zyklus 6 auf Zyklus 15 anpassen („Results > Amplification plot > delta Rn vs Cycle“ (Ergebnisse > Amplifikationsdarstellung > Delta Rn vs. Zyklus);

HINWEIS!

Die FAM-Fluoreszenz der EBV-Sonde kann in einer Probe mit einer hohen Konzentration an EBV-DNA bereits vor dem Zyklus 15 ansteigen. Senken Sie in diesem Fall den Bereich für die **Grundlinienberechnung** auf den Zyklus, bei dem die FAM-Fluoreszenz der Probe anzusteigen beginnt („Results > Component“ (Ergebnisse > Komponente)).

- die Schwellenwerte für die Detektoren manuell einstellen:

den **Schwellenwert** für den FAM-Detektor „EBV“ auf **0,2** einstellen;

den **Schwellenwert** für den VIC-Detektor „IC“ auf **0,1** einstellen.

Der PCR-Zyklus, bei dem das Fluoreszenzniveau einer Probe den **Schwellenwert** erreicht, bestimmt den **Schwellenwertzyklus (Ct)** für diese Probe.

Die Gerätesoftware analysiert automatisch die Fluoreszenzwerte in den Kontrollen, Standards und Probenreaktionen und berechnet die Ct-Werte.

14.4 Qualitative Analyse der Ergebnisse

Der EBV-**Ct**-Wert der **Positive Control** dient zur Validierung der PCR. Der PCR-Lauf ist gültig, wenn die Ergebnisse den Angaben in der folgenden Tabelle entsprechen.

Tabelle 36

Reaktion der Positive Control FAM-Detektor „EBV“	Assayergebnis	Amplifikation/Detektion
Ct ≤ 25	POSITIV	KORREKT

Wenn das Ergebnis der **Positive Control Ct > 25** oder**Ct Undetermined**für den FAM-Detektor „EBV“ lautet, ist der Lauf ungültig und muss ab dem PCR-Schritt wiederholt werden. Dies kann auf ein Problem während der PCR-Vorbereitung, der PCR oder des Detektionsschritts hinweisen (z. B. falsche Dispensierung oder Abbau des Q-PCR-Mix oder der Positive Control, falsche Platzierung der Positive Control, falsche Temperaturzyklus-Einstellungen), was zu falschen Ergebnissen führen könnte.

HINWEIS!

Wenn das Produkt zur Quantifizierung von EBV-DNA verwendet wird, wurden statt der **Positive Control**-Reaktionen die **Q - PCR Standard**-Reaktionen ausgeführt. In diesem Fall die Amplifikation und den Nachweis validieren, hierzu die Amplifikationsreaktion von **Q - PCR Standard 10^5** (**Ct ≤ 25**) beachten.

Der EBV-Ct-Wert der **Negative Control** dient zur Validierung der PCR. Der PCR-Lauf ist gültig, wenn die Ergebnisse den Angaben in der folgenden Tabelle entsprechen.

Tabelle 37

Reaktion der Negative Control FAM-Detektor „EBV“	Assayergebnis	Amplifikation/Detektion
Ct Undetermined (Ct unbestimmt)	NEGATIV	KORREKT

Weicht das Ergebnis der Amplifikationsreaktion der **Negative Control** von **Ct Undetermined** für den FAM-Detektor „EBV“ ab, ist der Lauf ungültig und muss ab dem PCR-Schritt wiederholt werden. Dies kann auf eine Kontamination hindeuten, die zu falschen und falsch-positiven Ergebnissen führen kann.

Der **Ct**-Wert von EBV in der jeweiligen Probe wird zum Nachweis der Ziel-DNA und der **Ct**-Wert der Internal Control zur Validierung der Extraktion, der PCR und des Nachweises verwendet.

HINWEIS!

Überprüfen Sie mithilfe der Amplifikationsdarstellung („Results > Amplification plot > delta Rn vs Cycle“ (Ergebnisse > Amplifikationsdarstellung > Delta Rn vs. Zyklus)), dass der**Ct**-Wert der einzelnen Proben anhand eines schnellen und regelmäßigen Anstiegs der Fluoreszenz und nicht anhand von Spitzen oder eines Anstiegs des Hintergrundsignals (unregelmäßiger oder hoher Hintergrund) ermittelt wurde.

Mögliche Probenergebnisse („Results > Report“ (Ergebnisse > Bericht)) sind in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 38

Probenreaktion		Eignung der Probe	Assay-Probenergebnis	EBV-DNA
FAM-Detektor „EBV“	VIC-Detektor „IC“			
Ct Undetermined (Ct unbestimmt)	Ct > 35 oder Ct Undetermined (Ct unbestimmt)	ungeeignet	ungültig	-
	Ct ≤ 35	geeignet	gültig, negativ	NICHT ERKANNT
Ct Determined (Ct bestimmt)	Ct > 35 oder Ct Undetermined (Ct unbestimmt)	geeignet	gültig, positiv	ERKANNT
	Ct ≤ 35	geeignet	gültig, positiv	ERKANNT

Ein Probenergebnis von **Ct Undetermined** (Ct unbestimmt) für EBV und **Ct > 35** oder**CtUndetermined**für die Internal Control ist ungültig und weist auf ein Problem bei der Nukleinsäureextraktion oder PCR hin (z. B. Abbau der Proben-DNA, Verlust von DNA während der Extraktion, Vorhandensein von Inhibitoren in der DNA, ineffiziente oder fehlende Amplifikation), was zu falschen Ergebnissen führen kann. Die Probe ist nicht für die Analyse geeignet und der Assay muss ab der Nukleinsäureextraktion einer neuen Probe wiederholt werden.

Ein Probenergebnis von **Ct Undetermined** für EBV und **Ct ≤ 35** für die Internal Control ist ein gültiges Ergebnis und zeigt an, dass in der Probe keine EBV-DNA nachgewiesen wurde. Die Probe enthält möglicherweise keine EBV-DNA oder sie enthält EBV-DNA in einer Konzentration, die unter der Nachweisgrenze des Produkts liegt (siehe 15 Leistungsmerkmale page 53). Ein Probenergebnis von **Ct Determined (Ct ≤ 45)** für EBV und **Ct >35**,**Ct Undetermined**oder**Ct ≤ 35**für die IC ist ein gültiges Ergebnis und zeigt an, dass in der Probe EBV-DNA nachgewiesen wurde.

HINWEIS!

Bei einem Probenergebnis von „Ct Determined“ für EBV und Ct > 35 bzw. „Undetermined“ für die IC kann die PCR-Effizienz der IC durch Konkurrenz mit der hohen PCR-Effizienz der EBV-DNA beeinträchtigt worden sein. In diesem Fall ist die Probe geeignet und das positive Ergebnis gültig.

HINWEIS!

Bei der Interpretation der mit dem Assay erhaltenen Ergebnisse müssen alle relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunde herangezogen werden.

14.5 Quantitative Analyse der Ergebnisse

Bei den Amplifikationsreaktionen der vier **Q - PCR Standards** ermöglichen die EBV-**Ct**-Werte die Berechnung der **Standardkurve** („Results > Standard Curve“ (Ergebnisse > Standardkurve)) für den Amplifikationslauf sowie die Validierung der Amplifikation und Detektion, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 39

Standardkurve FAM-Detektor „EBV“	Akzeptanzbereich	Amplifikation/Detektion
Korrelationskoeffizient (R2)	0,990 ≤ R2 ≤ 1,000	KORREKT

Wenn der Wert des **Korrelationskoeffizienten (R2)** nicht innerhalb der Grenzen liegt, ist der Lauf ungültig und muss ab dem PCR-Schritt wiederholt werden. Dies kann auf ein Problem während der PCR oder des Detektionsschritts hindeuten (z. B. falsche Dispensierung oder Abbau des Q-PCR Mix oder der Standards, falsche Platzierung der Standards, falsche Temperaturzyklus-Einstellungen oder Kreuzkontamination), was zu falschen Ergebnissen führen könnte.

Tabelle 40

Probenergebnis für FAM-Detektor „EBV“	EBV-Kopien pro Reaktion
Menge > 1×10^6	MEHR ALS 1×10^6
1×10^1 ≤ Menge ≤ 1×10^6	= Menge
Menge < 1×10^1	WENIGER ALS 10

Die Ergebnisse (**Menge**) jeder Probe („Results > Report“ (Ergebnisse > Bericht)) dienen zur Berechnung der Kopien von EBV, die in der bei der Extraktion verwendeten Probe vorhanden sind (**Nc**), gemäß dieser Formel:

Tabelle 41

$$Nc = \frac{Ve \times Menge}{Vc \times Va \times Ep}$$

dabei ist:

Ve das Gesamtvolumen **in µl** der extrahierten DNA-Probe (Elutionsvolumen)

Menge die von der Gerätesoftware berechnete **Kopien/Reaktion** der Probe (PCR-Ergebnis)

Vc das Volumen der bei für die Nukleinsäureextraktion verwendeten Probe (Eingangsvolumen), ausgedrückt in der gewünschten Maßeinheit

Va das Volumen der in der PCR verwendeten extrahierten DNA-Probe (Eluat) in **µl**

Ep die Effizienz des Verfahrens (Extraktion und PCR), **ausgedrückt als Dezimalzahl**

Zur Umrechnung der Probenmenge von Kopien/ml in IU/ml wird der Kopien/ml-Wert mit dem **Umrechnungsfaktor (Fc)** multipliziert. Der Fc wurde unter Verwendung von kalibriertem zertifiziertem Referenzmaterial („1st WHO International Standard for Epstein Barr virus for Nucleic Acid Amplification Techniques“, NIBSC) berechnet (siehe 15 Leistungsmerkmale page 53).

Der Einfachheit halber werden im Folgenden vereinfachte Formeln aufgeführt, in denen Ve/(Vc x Va x Ep) und die Umrechnung in IU/ml berechnet wurden.

Tabelle 42

Matrix	Methode der Nukleinsäureex-traktion	Ve/ (Vc x Va x Ep)	Formel zur Quantifizierung Nc (Kopien/ml)	Fc (IU/Kopie)	Formel zur Quantifizierung Nc (IU/ml)
Vollblut	ELITe GALAXY	35	35 x Menge	0,82	31,2 x Menge

15 LEISTUNGSMERKMALE BEI ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument

15.1 Nachweisgrenze (LoD)

Die Nachweisgrenze (LoD) des Assays in Verbindung mit Vollblut wurde auf den Geräten ELITe GALAXY und ABI 7500 mithilfe einer Reihe EBV-negativer Matrizes, die mit zertifiziertem Referenzmaterial dotiert waren (1st WHO International Standard for Epstein Barr Virus for Nucleic Acid Amplification Technique, NIBSC, Vereinigtes Königreich), getestet. Die Ergebnisse wurden einer Probit-Regressionsanalyse unterzogen, und die LoD wurde als die Konzentration geschätzt, die einer 95 %igen Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses entspricht.

Tabelle 43 Nachweisgrenze mit ELITe GALAXY (IU/ml)

Matrix	95 %-Positivität	95 %-Konfidenzintervall	
		Untere Grenze	Obere Grenze
Vollblut	**99 IU/ml**	57 IU/ml	376 IU/ml

Die LoD als Kopien/ml für jede Matrix wird unter Anwendung des spezifischen Umrechnungsfaktors berechnet, der in Abschnitt 15.3 Umrechnung in internationale Einheiten page 54 angegeben ist.

Die analytische Sensitivität als Kopien/ml ist nachfolgend angegeben.

Tabelle 44 Nachweisgrenze mit ELITe GALAXY (Kopien/ml)

Matrix	95 %-Positivität	95 %-Konfidenzintervall	
		Untere Grenze	Obere Grenze
Vollblut	**121 Kopien/ml**	70 Kopien/ml	459 Kopien/ml

15.2 Linearer Messbereich

Zur Bestimmung des linearen Messbereichs des Assays in Verbindung mit Vollblut wurde auf **ELITe GALAXY** und **ABI 7500** eine Verdünnungsreihe einer Plasmid-DNA, die das Amplifikationsprodukt enthielt, verwendet.

Die Ergebnisse bei Vollblut sind im folgenden Diagramm aufgeführt.

Der lineare Messbereich in Kopien/ml wird unter Anwendung des spezifischen Umrechnungsfaktors berechnet, der im Abschnitt 15.3 Umrechnung in internationale Einheiten page 54 angegeben ist.

Die endgültigen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 45 Linearer Messbereich für Vollblutproben

Maßeinheit	Untere Grenze	Obere Grenze
Kopien/Reaktion	**10**	**1.000.000**

15.3 Umrechnung in internationale Einheiten

Der Umrechnungsfaktor zur Angabe der quantitativen Ergebnisse von Kopien/ml in internationale Einheiten (International Units, IU) wurde für in EDTA entnommenes Vollblut berechnet. Hierfür wurde das zertifizierte kalibrierte Referenzmaterial „1st WHO International Standard for Epstein Barr virus for Nucleic Acid Amplification Techniques“ (NIBSC) verwendet.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 46 Faktor zur Umrechnung in internationale Einheiten bei ABI 7500 und Vollblut

Gerät	Umrechnungsfaktor Fc (IU/Kopien)
ELITe GALAXY	**0,82**

15.4 Inklusivität: Nachweis- und Quantifizierungseffizienz bei verschiedenen Genotypen

Die Inklusivität des Assays als die Nachweiseffizienz für verschiedene Genotypen des EBV wurde mittels *In-silico*-Analyse der in den Nukleotid-Datenbanken verfügbaren Sequenzen bewertet. Die Analyse zeigte eine Sequenzerhaltung und ein Nichtvorhandensein signifikanter Mutationen. Daher wird ein effizienter Nachweis für die verschiedenen Stämme oder Isolate erwartet.

15.5 Potenziell interferierende Organismen: Kreuzreaktivität

Die potenzielle Kreuzreaktivität mit unbeabsichtigten Organismen, die in klinischen Proben vorkommen können, wurde durch eine *In-silico*-Analyse bewertet. Die Analyse ergab keine signifikante Homologie mit anderen unbeabsichtigten Organismen (Viren, Prokaryoten, Pilze, Phagen, Wirbellose und Menschen). Es dürfte daher keine Kreuzreaktivität zu erwarten sein.

15.6 Wiederholpräzision

Zur Bewertung der Wiederholpräzision innerhalb eines Laufs wurden mit ABI 7500 ein Panel von Proben, die mit einer Plasmid-DNA dotiert waren, welche das Amplifikationsprodukt enthielt, sowie eine negative Probe analysiert.

Ein Beispiel für die Ergebnisse der Wiederholpräzision innerhalb eines Laufs ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 47 Wiederholpräzision innerhalb eines Laufs auf ABI 7500

Probe	EBV				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstim-mung
10.000.000	9	15,16	0,11	0,70	100 %
1.000.000	9	18,52	0,14	0,75	100 %
100.000	9	21,93	0,21	0,94	100 %
10.000	9	25,21	0,09	0,35	100 %
1.000	9	28,50	0,19	0,67	100 %
100	9	31,88	0,23	0,72	100 %
10	9	35,42	0,70	1,97	100 %

Beim Test der Wiederholpräzision wurde der EBV ELITe MGB Kit wie erwartet für alle Proben korrekt erkannt und wies eine maximale Variabilität der Ct-Zielwerte mit einem VK% von weniger 5 % aus.

15.7 Vergleichspräzision

Zur Bewertung der Vergleichspräzision des Assays wurden mit ABI 7500 ein Panel von Proben, die mit einer Plasmid-DNA dotiert waren, welche das Amplifikationsprodukt enthielt, sowie eine negative Probe analysiert.

Eine Übersicht der chargenübergreifenden Vergleichspräzision (bei fünf Chargen) ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 48 Chargenübergreifende Vergleichspräzision auf ABI 7500

Probe	EBV				
	Anzahl	Mittlerer Ct-Wert	SD	VK %	% Übereinstim-mung
50.000 Kopien/ Reaktion	15	23,45	0,3793	1,6172	100 %
5.000 Kopien/ Reaktion	15	26,73	0,4545	1,7001	100 %
500 Kopien/ Reaktion	15	29,98	0,5477	1,8270	100 %
Negativ	15	-	-	-	100 %

Beim Test der Vergleichspräzision wurde der EBV ELITe MGB Kit wie erwartet für alle Proben korrekt erkannt und wies eine maximale Variabilität der Ct-Zielwerte mit einem VK% von weniger 5 % aus.

15.8 Diagnostische Sensitivität: Nachweis- und Quantifizierungseffizienz bei verschiedenen Genotypen/Subtypen

Die diagnostische Sensitivität des Assays als die Nachweis- und Quantifizierungseffizienz bei verschiedenen Genotypen/Subtypen wurde durch den Vergleich von Sequenzen mit Nukleotid-Datenbanken bewertet.

Die Analyse der für die Hybridisierung der Primer und des Fluoreszenzmarkers ausgewählten Regionen in der Anordnung der in der Datenbank für das EBNA 1-Gen von EBV verfügbaren Sequenzen ergab eine Erhaltung und ein Nichtvorhandensein von signifikanten Mutationen.

15.9 Diagnostische Sensitivität: Bestätigung positiver Proben

Zur Bewertung der diagnostischen Sensitivität des Assays als die Bestätigung positiver klinischer Proben wurden mit **ELITe GALAXY** und ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument als positiv für die Zielsequenz bestätigte Proben analysiert.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 49

Proben	Anzahl	positiv	negativ	Diagnostische Sensitivität in %
In EDTA entnommenes, EBV-DNA-positives Vollblut	54	54	0	100

HINWEIS!

Die vollständigen Daten und Ergebnisse der Tests, die zur Bewertung der Leistungsmerkmale des Produkts mit Matrizes und Geräten durchgeführt wurden, sind in der technischen Produktdokumentation „EBV ELITe MGB Kit“, FTP 020PLD, aufgeführt.

15.10 Diagnostische Spezifität: Bestätigung negativer Proben

Zur Bewertung der diagnostischen Spezifität des Assays als die Bestätigung negativer klinischer Proben wurden mit **ELITe GALAXY** und ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument als negativ für die Zielsequenz bestätigte Proben analysiert.

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 50 Diagnostische Spezifität

Proben	Anzahl	positiv	negativ	Diagnostische Spezifität in %
In EDTA entnommenes, EBV-DNA-negatives Vollblut	52	2	50	96,1

16 REFERENZEN

S. W. Aberle et al. (2002) *J Clin Virology* 25: S79 - S85

C. N. Kotton et al. (2025) Transplantation 109: 1066-1110

E. A. Lukhtanov et al. (2007) *Nucleic Acids Res.* 35: e30

17 GRENZEN DES VERFAHRENS

Dieses Produkt darf nur mit den folgenden klinischen Proben verwendet werden:

- in EDTA entnommenes Vollblut (alle Geräte),
- in EDTA entnommenes Plasma (nur ELITe InGenius und ELITe BeGenius).
- Liquor (nur ELITe InGenius und ELITe BeGenius).

Derzeit liegen keine Daten zur Produktleistung mit anderen klinischen Proben, wie z. B. Leukozytensuspensionen oder Granulozytensuspensionen, vor.

In EDTA entnommenes Plasma muss aus Vollblut gewonnen werden, das bei Raumtemperatur oder bei +2 bis +8 °C nicht länger als 24 Stunden gelagert wurde.

Keine aus heparinisierten Proben extrahierte DNA zusammen mit diesem Produkt verwenden: Heparin hemmt die Amplifikationsreaktion von Nukleinsäuren und führt zu ungültigen Ergebnissen.

Keine mit Hämoglobin, Dextran, Ficoll®, Ethanol oder 2-Propanol kontaminierte extrahierte DNA zusammen mit diesem Produkt verwenden: Diese Stoffe hemmen die Amplifikationsreaktion von Nukleinsäuren und können zu ungültigen Ergebnissen führen.

Mit diesem Produkt keine extrahierte DNA verwenden, die große Mengen an humaner genomischer DNA enthält, da diese die Amplifikationsreaktion von Nukleinsäuren hemmen kann.

Es liegen keine Daten zu einer Inhibition durch antivirale, antibiotische, chemotherapeutische oder immunsupprimierende Medikamente vor.

Die mit diesem Produkt erhaltenen Ergebnisse hängen von der ordnungsgemäßen Durchführung von Identifizierung, Entnahme, Transport, Lagerung und Verarbeitung der Proben ab. Zur Vermeidung falscher Ergebnisse ist es daher notwendig, bei diesen Schritten sorgfältig vorzugehen und die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu befolgen.

Aufgrund ihrer hohen analytischen Sensitivität ist die Real-Time-PCR-Methode empfindlich für Kontaminationen durch positive Proben, Positivkontrollen und PCR-Produkte. Solche Kreuzkontaminationen können zu falsch-positiven Ergebnissen führen. Das Produktformat ist zwar so gestaltet, dass Kreuzkontaminationen reduziert werden, sie lassen sich jedoch nur durch eine gute Laborpraxis und die Einhaltung dieser Gebrauchsanweisung verhindern.

Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal, das im Umgang mit potenziell infektiösen biologischen Proben und als gefährlich klassifizierten chemischen Präparaten geschult ist, verwendet werden. Dadurch sollen Unfälle mit möglicherweise ernsten Folgen für den Anwender und andere Personen vermieden werden.

Die Verwendung dieses Produkts erfordert persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsbereiche, die für den Umgang mit potenziell infektiösen biologischen Proben und als gefährlich klassifizierten chemischen Präparaten geeignet sind, um Unfälle mit möglicherweise ernsten Folgen für den Anwender und andere Personen zu vermeiden.

Dieses Produkt macht das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung und das Verwenden von für die Einrichtung des Arbeitslaufs vorgesehenen Instrumente erforderlich, um falsch-positive Ergebnisse zu vermeiden.

Zur Vermeidung falscher Ergebnisse darf dieses Produkt nur von professionellem, qualifiziertem Personal, das im Umgang mit molekularbiologischen Techniken, wie Extraktion, PCR und Nachweis von Nukleinsäuren geschult ist, verwendet werden.

Vor einer Umstellung auf eine neue Technologie sollten die Anwender aufgrund von inhärenten Unterschieden zwischen verschiedenen Technologien Korrelationsstudien zu den Methoden durchführen, um die Unterschiede zwischen den Technologien abschätzen zu können.

Ein mit diesem Produkt erhaltenes negatives Ergebnis zeigt, dass die Ziel-DNA nicht in der DNA, die aus der Probe extrahiert wurde, nachgewiesen wurde. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Erregerlast unter der Nachweisgrenze des Produkts liegt (siehe 12 LEISTUNGSMERKMALE BEI ELITe InGenius, ELITe BeGenius und MyGenius PRO page 33). In diesem Fall kann das Ergebnis falsch-negativ sein.

Mit diesem Produkt erhaltene Ergebnisse können manchmal aufgrund von Ausfällen der internen Kontrolle ungültig sein. In diesem Fall ist die Probe beginnend mit der Extraktion erneut zu testen, was zu einer Verzögerung der endgültigen Testergebnisse führen kann.

Etwaige Polymorphismen, Insertionen oder Deletionen in der Primer- oder Sondenbindungsregion der DNA können den Nachweis und die Quantifizierung der Ziel-DNA beeinträchtigen.

Wie bei allen anderen diagnostischen Produkten müssen die mit diesem Produkt erhaltenen Ergebnisse in Kombination mit allen relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunden interpretiert werden.

Wie bei allen diagnostischen Produkten besteht auch bei diesem Produkt ein Restrisiko von ungültigen oder fehlerhaften Ergebnissen. Dieses Restrisiko kann nicht eliminiert oder weiter minimiert werden. In manchen Fällen kann dieses Restrisiko zu falschen Entscheidungen mit potenziell gefährlichen Auswirkungen auf den Patienten beitragen. Dieses Restrisiko im Zusammenhang mit dem Verwendungszweck des Produkts wurde jedoch gegen den potenziellen Nutzen für den Patienten abgewogen und als akzeptabel eingestuft.

18 FEHLERBEHEBUNG

ELITe InGenius und ELITe BeGenius

Tabelle 51

Ungültige Reaktion von Q-PCR Standard, Standardkurve oder Positive Control	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Position von Q-PCR Mix, Q-PCR Standards und Positive Control kontrollieren. Volumina von Q-PCR Mix, Q-PCR Standards und Positive Control kontrollieren.
Abbau des PCR Mix.	Den Q-PCR Mix nicht für mehr als 5 unabhängige Arbeitsläufe verwenden (jeweils 3 Stunden im gekühlten Reagenzienblock oder in der Cooler Unit). Den Q-PCR Mix nicht für mehr als 3 aufeinander folgende Läufe verwenden (7 Stunden im gekühlten Reagenzienblock oder in der Cooler Unit). Den Q-PCR Mix nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Abbau von Q-PCR Standards oder Positive Control.	Den Q-PCR Standard nicht für mehr als 4 unabhängige Läufe verwenden (jeweils 2 Stunden im Extraktionsbereich oder in der Cooler Unit). Die Positive Control nicht für mehr als 4 unabhängige Arbeitsläufe verwenden (jeweils 3 Stunden im Extraktionsbereich oder in der Cooler Unit). Neue Röhrchen von Q-PCR Standards oder Positive Control verwenden.
Gerätefehler.	Technischen Kundendienst der ELITechGroup kontaktieren.

Tabelle 52

Ungültige Reaktion der Negativkontrolle	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Position des Q-PCR Mix und der Negative Control kontrollieren. Volumina des Q-PCR Mix und der Negative Control kontrollieren.
Kontamination der Negativkontrolle.	Die Negativkontrolle nicht für mehr als 1 Lauf verwenden. Ein neues Aliquot hochreines Wasser für die Molekularbiologie verwenden.
Kontamination des PCR Mix.	Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.

Tabelle 52 (continued)

Ungültige Reaktion der Negativkontrolle	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Kontamination des Extraktionsbereichs, der Racks, des Bestandsmanager oder der Cooler Unit.	Oberflächen mit wässrigen Reinigungsmitteln reinigen, Laborkittel waschen, verwendete Röhrchen und Spitzen austauschen.
Gerätefehler.	Technischen Kundendienst der ELITechGroup kontaktieren.

Tabelle 53

Ungültige Probenreaktion	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Position von Q-PCR Mix, Internal Control und Probe kontrollieren. Volumina von Q-PCR Mix, Internal Control und Probe kontrollieren.
Abbau des PCR Mix.	Den Q-PCR Mix nicht für mehr als 5 unabhängige Arbeitsläufe verwenden (jeweils 3 Stunden im gekühlten Reagenzienblock oder in der Cooler Unit). Den Q-PCR Mix nicht für mehr als 3 aufeinander folgende Läufe verwenden (7 Stunden im gekühlten Reagenzienblock oder in der Cooler Unit). Den Q-PCR Mix nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Abbau der Vorlage für die Internal Control.	Ein neues Röhrchen der Internal Control verwenden.
Inhibition durch Störsubstanzen in der Probe.	Amplifikation der eluierten Probe unverdünnt oder mit einer 1:2-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie in einem „PCR Only“-Lauf (nur PCR) wiederholen. Extraktion der Probe mit einer 1:2-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie in einem „Extract + PCR“-Lauf (Extraktion + PCR) wiederholen.
Gerätefehler.	Technischen Kundendienst der ELITechGroup kontaktieren.

Tabelle 54

Anomale Dissoziationskurve	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Fehlen eines definierten Peaks. Definierter Peak, Tm-Wert unterscheidet sich jedoch von dem der anderen Proben und dem der Standards oder der Positive Control.	Kontrollieren, ob der Ct-Zielwert unter 30 liegt. Große Menge an Amplifikationsprodukt am Ende der Reaktion kann die Schmelzkurvenanalyse beeinträchtigen. Die Probenamplifikation wiederholen, um das Vorhandensein von Ziel-DNA mit einer möglichen Mutation zu bestätigen. Die Ziel-DNA in der Probe sollte sequenziert werden, um die Mutation zu bestätigen.

Tabelle 55

Fehler bei der Berechnung des Ct-Werts	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Zu hohe Konzentration von Ziel-DNA in der Probe oder Probe mit anomalem Fluoreszenzsignal.	Wenn im PCR-Diagramm eine signifikante Amplifikation zu beobachten ist, entsprechende Spur für die Probe auswählen und Ergebnis manuell als positiv bestätigen. Wenn im PCR-Diagramm keine Amplifikation zu beobachten ist, entsprechende Spur für die Probe auswählen und Ergebnis manuell als negativ bestätigen oder als ungültig belassen. Wenn ein Ct-Wert benötigt wird: - Amplifikation der eluierten Probe mit einer 1:10-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie in einem „PCR Only“-Lauf (nur PCR) wiederholen. - Extraktion der Probe mit einer 1:10-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie in einem „Extract + PCR“-Lauf (Extraktion + PCR) wiederholen.

Tabelle 56

Ungewöhnlich hoher Anteil positiver Ergebnisse innerhalb ein und desselben Laufs (Reaktionen mit ähnlich späten Ct-Werten)	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Kontamination von Probe zu Probe bei Präanalyseschritten.	Mikropipette nach dem Pipettieren jeder Probe mit frischer 3%iger Natriumhypochloritlösung (Bleiche) oder DNA/RNA-Cleaner reinigen. Keine Pasteur-Pipetten verwenden. Die Pipetten müssen entweder Direktverdrängungspipetten sein oder zusammen mit Aerosolfilterspitzen verwendet werden. Proben in die letzten Positionen der Geräte einsetzen, wie auf der Benutzeroberfläche angegeben. Die von der Software angegebene Ladefolge beachten.
Kontamination der Laborumgebung.	Alle Oberflächen, die mit dem Bediener und den Proben (einschließlich Pipetten) in Kontakt kommen, mit frischer 3%iger Natriumhypochloritlösung (Bleiche) oder DNA/RNA-Cleaner reinigen. Einen UV-Dekontaminationszyklus durchführen. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix und/oder Internal Control verwenden.

MyGenius PRO

Tabelle 57

Ungültige Reaktion von Q-PCR Standard, Standardkurve oder Positive Control	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Volumina von Q-PCR Mix, Q-PCR Standards und Positive Control kontrollieren. Es ist wichtig, dass die auf MyGenius PRO verwendeten Röhrchen nicht zuvor von anderen Plattformen oder für Einrichtläufe auf offenen Plattformen verwendet wurde, da das Gerät das Etikett liest und die maximale Anzahl an Replikaten, die ausgeführt werden können, wenn das Röhrchen noch nie auf MyGenius PRO geladen wurde, automatisch zuweist. Daher kann bei Verwendung eines neuen Röhrchens das Volumen möglicherweise nicht ausreichen.
Abbau des PCR Mix.	Den Q-PCR Mix nicht länger als 7 Stunden im Karussell bzw. fünfmal nicht länger als 3 Stunden im Karussell verwenden. Den Q-PCR Mix nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Abbau von Q-PCR Standards oder Positive Control.	Den Q-PCR Standard nicht für mehr als 4 unabhängige Arbeitsläufe verwenden (jeweils 2 Stunden im Karussell). Die Positive Control nicht für mehr als 4 unabhängige Arbeitsläufe verwenden (jeweils 3 Stunden im Karussell). Neue Röhrchen von Q-PCR Standards oder Positive Control verwenden.
Gerätefehler.	Technischen Kundendienst der ELITechGroup kontaktieren.

Tabelle 58

Ungültige Reaktion der Negativkontrolle	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Volumina des Q-PCR Mix und der Negative Control kontrollieren. Es ist wichtig, dass die auf MyGenius PRO verwendeten Röhrchen nicht zuvor von anderen Plattformen oder für Einrichtläufe auf offenen Plattformen verwendet wurde, da das Gerät das Etikett liest und die maximale Anzahl an Replikaten, die ausgeführt werden können, wenn das Röhrchen noch nie auf MyGenius PRO geladen wurde, automatisch zuweist. Daher kann bei Verwendung eines neuen Röhrchens das Volumen möglicherweise nicht ausreichen.
Kontamination der Negativkontrolle.	Die Negative Control nicht für mehr als 1 Lauf und mehr als 8 Stunden verwenden. Ein neues Röhrchen der Negative Control verwenden.
Kontamination des PCR Mix.	Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Kontamination des Extraktionsbereichs, der Racks, des Bestandsmanager oder der Cooler Unit.	Oberflächen mit wässrigen Reinigungsmitteln reinigen, Laborkittel waschen, verwendete Röhrchen und Spitzen austauschen.
Gerätefehler.	Technischen Kundendienst der ELITechGroup kontaktieren.

Tabelle 59

Ungültige Probenreaktion	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Volumina von Q-PCR Mix, Internal Control und Proben kontrollieren. Es ist wichtig, dass die auf MyGenius PRO verwendeten Röhrchen nicht zuvor von anderen Plattformen oder für Einrichtläufe auf offenen Plattformen verwendet wurde, da das Gerät das Etikett liest und die maximale Anzahl an Replikaten, die ausgeführt werden können, wenn das Röhrchen noch nie auf MyGenius PRO geladen wurde, automatisch zuweist. Daher kann bei Verwendung eines neuen Röhrchens das Volumen möglicherweise nicht ausreichen.
Abbau des PCR Mix.	Den Q-PCR Mix nicht länger als 7 Stunden im Karussell bzw. fünfmal nicht länger als 3 Stunden im Karussell verwenden. Den Q-PCR Mix nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Abbau der Vorlage für die Internal Control.	Die Internal Control nicht für mehr als 8 Stunden verwenden. Ein neues Röhrchen der Internal Control verwenden.
Inhibition durch Störsubstanzen in der Probe.	Die Extraktion und Amplifikation der Probe wiederholen. Die Extraktion und Amplifikation der Probe mit einer 1:2-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie wiederholen.
Zu hohe Konzentration von Ziel-DNA in der Probe oder Probe mit anomalem Fluoreszenzsignal.	Wenn ein Ct-Wert benötigt wird, die Extraktion und Amplifikation der Probe mit einer 1:10-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie wiederholen.
Gerätefehler.	Technischen Kundendienst der ELITechGroup kontaktieren.

Tabelle 60

Anomale Dissoziationskurve	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Fehlen eines definierten Peaks. Definierter Peak, Tm-Wert unterscheidet sich jedoch von dem der anderen Proben und dem der Standards oder der Positive Control.	Kontrollieren, ob der Ct-Zielwert unter 30 liegt. Große Menge an Amplifikationsprodukt am Ende der Reaktion kann die Schmelzkurvenanalyse beeinträchtigen. Die Probenextraktion und -amplifikation wiederholen, um das Vorhandensein von Ziel-DNA mit einer möglichen Mutation zu bestätigen. Die Ziel-DNA in der Probe sollte sequenziert werden, um die Mutation zu bestätigen.

Tabelle 61

Fehler bei der Berechnung des Ct-Werts	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Zu hohe Konzentration von Ziel-DNA in der Probe oder Probe mit anomalem Fluoreszenzsignal.	Wenn eine signifikante Amplifikation im PCR-Diagramm erscheint, ist das Ergebnis als positiv zu betrachten. Wenn keine Amplifikation im PCR-Diagramm erscheint, ist das Ergebnis als negativ oder ungültig zu betrachten. Wenn ein Ct-Wert benötigt wird, die Extraktion und Amplifikation der Probe mit einer 1:10-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie wiederholen.

Tabelle 62

Ungewöhnlich hoher Anteil positiver Ergebnisse innerhalb ein und desselben Laufs (Reaktionen mit ähnlich späten Ct-Werten)	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Kontamination von Probe zu Probe bei Präanalyseschritten.	Mikropipette nach dem Pipettieren jeder Probe mit frischer 3%iger Natriumhypochloritlösung (Bleiche) oder DNA/RNA-Cleaner reinigen. Keine Pasteur-Pipetten verwenden. Die Pipetten müssen entweder Direktverdrängungspipetten sein oder zusammen mit Aerosolfilterspitzen verwendet werden. Als letzten Vorgang des Tages Proben einsetzen.
Kontamination der Laborumgebung.	Alle Oberflächen, die mit dem Bediener und den Proben (einschließlich Pipetten) in Kontakt kommen, mit frischer 3%iger Natriumhypochloritlösung (Bleiche) oder DNA/RNA-Cleaner reinigen. Einen UV-Dekontaminationszyklus durchführen. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix und/oder Internal Control verwenden.

Offene Plattform

Tabelle 63

Ungültige Reaktion von Q-PCR Standard, Standardkurve oder Positive Control	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Falsches Dispensieren in die Vertiefungen der Mikrotiterplatte.	Volumina von PCR Mix, Q-PCR Standards und Positive Control, die in die Q-PCR Microplate dispensiert wurden, kontrollieren.
Abbau des Q-PCR Mix.	PCR Mix nicht mehr als 5 Mal einfrieren und wieder auftauen. Den Q-PCR Mix nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Abbau von Q-PCR Standards oder Positive Control.	Q-PCR Standard nicht mehr als 4 Mal einfrieren und wieder auftauen. Neue Röhrchen von Q-PCR Standards oder Positive Control verwenden.
Einstellfehler des Geräts.	Position von PCR Mix, Q-PCR Standards und Positive Control auf dem Gerät kontrollieren. Temperaturzyklus-Einstellungen des Geräts überprüfen.

Tabelle 64

Ungültige Reaktion der Negativkontrolle	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Position des Q-PCR Mix und der Negative Control kontrollieren. Volumina des Q-PCR Mix und der Negative Control kontrollieren.
Mikrotiterplatte schlecht versiegelt.	Beim Verschließen der Q-PCR Microplate mit der optisch klaren Dichtungsfolie vorsichtig vorgehen.
Kontamination der Negativkontrolle.	Die Negativkontrolle nicht für mehr als 1 Lauf verwenden. Ein neues Aliquot hochreines Wasser für die Molekularbiologie verwenden.

Tabelle 64 (continued)

Ungültige Reaktion der Negativkontrolle	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Kontamination des PCR Mix.	Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Kontamination von Vorbereitungsbereich, Racks und Mikropipette.	Oberflächen und Geräte mit wässrigen Reinigungsmitteln reinigen, Laborkittel waschen, verwendete Teströhrchen und Spitzen austauschen.

Tabelle 65

Ungültige Probenreaktion	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Einstellfehler des Geräts.	Position von Q-PCR Mix, Internal Control und Probe kontrollieren. Volumina von Q-PCR Mix, Internal Control und Probe kontrollieren.
Abbau des PCR Mix.	PCR Mix nicht mehr als fünfmal einfrieren und wieder auftauen. Den Q-PCR Mix nicht länger als 30 Minuten bei Raumtemperatur aufbewahren. Ein neues Röhrchen mit Q-PCR Mix verwenden.
Abbau der Vorlage für die Internal Control.	Ein neues Röhrchen der Internal Control verwenden.
Inhibition durch Störsubstanzen in der Probe.	Amplifikation der eluierten Probe mit einer 1:2-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie wiederholen. Extraktion der Probe mit einer 1:2-Verdünnung in hochreinem Wasser für die Molekularbiologie wiederholen.

Tabelle 66

Unregelmäßige oder hohe Hintergrundfluoreszenz in den Reaktionen	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Falsche Dispensierung der Probe.	Volumina der in die Q-PCR Microplate dispensierten Reagenzien und Proben kontrollieren.
Einstellfehler der Grundlinie.	Wenn der Berechnungsbereich für die von Zyklus 6 bis Zyklus 15 eingestellten Grundlinie nicht geeignet ist, um den Hintergrund zu normalisieren, den Berechnungsbereich innerhalb der Zyklen einstellen, in denen sich die Hintergrundfluoreszenz bereits stabilisiert hat („Results“ [Ergebnisse], „Component“ [Komponente] überprüfen) und die Zielfluoreszenz noch nicht zuzunehmen begonnen hat.

Tabelle 67

Anomale Dissoziationskurve	
Mögliche Ursachen	**Abhilfemaßnahmen**
Fehlen eines definierten Peaks. Definierter Peak, Wert unterscheidet sich jedoch von dem der anderen Proben und dem der Standards oder der Positive Control.	Kontrollieren, ob der Ct-Zielwert unter 30 liegt. Große Menge an Amplifikationsprodukt am Ende der Reaktion kann die Schmelzkurvenanalyse beeinträchtigen. Die Probenamplifikation wiederholen, um das Vorhandensein von Ziel-DNA mit einer möglichen Mutation zu bestätigen. Die Ziel-DNA in der Probe sollte sequenziert werden, um die Mutation zu bestätigen.

19 SYMBOLE

REF Katalognummer.

Temperaturobergrenze.

LOT Chargenbezeichnung.

Verfallsdatum (letzter Tag des Monats).

IVD *In-vitro*-Diagnostikum.

CE 0123 Erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/746 über *In-vitro*-Diagnostika (IVDR). Zertifizierung ausgestellt von der TÜV SÜD Product Service GmbH, Deutschland.

UDI Unique Device Identification, eindeutige Gerätekennung

Σ Ausreichend für „N" Tests

Gebrauchsanweisung beachten.

CONT Inhalt.

Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Hersteller.

20 ANWENDERHINWEISE

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden. Um den Hersteller dieses Geräts zu informieren, verwenden Sie sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: egspa.vigilance@elitechgroup.com.

Eine „Zusammenfassung der Unbedenklichkeit und der Leistung“ wird der Öffentlichkeit über die Europäische Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) zur Verfügung gestellt, sobald dieses Informatiksystem funktionsfähig ist. Vor der Veröffentlichung des Hinweises über die vollständige Funktionsfähigkeit von Eudamed wird die „Zusammenfassung der Sicherheit und Leistung“ der Öffentlichkeit auf Anfrage per E-Mail an emd.support@elitechgroup.com ohne unnötige Verzögerung zur Verfügung gestellt.

21 HINWEIS FÜR DEN KÄUFER: EINGESCHRÄNKTE LIZENZ

Dieses Produkt enthält Reagenzien, die zur ausschließlichen Verwendung als Komponenten von Diagnostik-Kits der Marke ELITech von Promega Corporation hergestellt und an ELITechGroup S. p. A. geliefert wurden. Die Reagenzien dürfen nur innerhalb dieses Kits verwendet werden. Es werden keine weiteren Rechte oder Lizenzen – weder ausdrücklich noch stillschweigend – für die Verwendung, die Änderung oder den Weiterverkauf der Reagenzien außerhalb dieses Kits gewährt.

ELITe MGB® Nachweisreagenzien und ELITech-Plattformen (ELITe InGenius®, ELITe BeGenius®, MyGenius PRO®) sind durch erteilte Patente und Patentanmeldungen geschützt.

Jede Verwendung der Reagenzien oder der zugehörigen Daten außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Kits bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung von ELITechGroup S.p.A.

ELITe MGB ® Nachweisreagenzien sind durch eines oder mehrere der US-Patente mit den Nummern 7319022, 7348146, 7541454, 7671218, 7723038, 7767834, 8163910, 8969003, 9056887, 9085800, 9169256, 9328384, 10677728, 10738346, 10890529 und der EP-Patente mit den Nummern 2689031, 2714939, 2736916, 2997161 sowie durch anhängige Patentanmeldungen geschützt.

Die ELITe InGenius®-, die ELITe BeGenius®- und die MyGenius PRO®-Technologie sind durch Patente und Patentanmeldungen geschützt.

Diese eingeschränkte Lizenz erlaubt der Person oder Einrichtung, der das Produkt zur Verfügung gestellt wurde, das Produkt und die bei Verwendung des Produkts erzeugten Daten ausschließlich für die Humandiagnostik zu verwenden. Weder die ELITechGroup S. p. A. noch deren Lizenzgeber gewähren weitere, ausdrückliche oder stillschweigende Lizenzen für andere Zwecke.

MGB®, Eclipse Dark Quencher®, AquaPhluor®, ELITe MGB®, das ELITe MGB® Logo, ELITe InGenius®, ELITe BeGenius® und MyGenius PRO® (eingetragener Name: ELIVERSE®) sind eingetragene Marken der ELITechGroup in der Europäischen Union.
QIAsymphony® ist eine eingetragene Marke der QIAGEN GmbH.
Ficoll® ist eine eingetragene Marke von GE Healthcare Bio-Sciences AB.

Appendix A EBV ELITe MGB Kit zur Verwendung mit Plattformen der Genius-Reihe®

VORSICHT

Dieses Dokument ist eine vereinfachte Version der offiziellen Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch das vollständige Dokument: www.elitechgroup.com

Verwendungszweck

Das Produkt **EBV ELITe MGB® Kit** ist ein *In-vitro*-Diagnostikum, das für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal als quantitativer Nukleinsäure- und Real-Time-PCR-Assay zum Nachweis und zur Quantifizierung der **DNA des Epstein-Barr-Virus (EBV)**, die aus klinischen Proben extrahiert wurde, bestimmt ist.

Dieser Assay ist in Verbindung mit den Geräten **ELITe InGenius®** und**ELITe BeGenius®**, automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut, in EDTA entnommenem Plasma und Liquor, validiert.

Dieser Assay ist auch in Verbindung mit dem Gerät **MyGenius PRO®** (eingetragener Name: ELIVERSE®), einem automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen, in EDTA entnommenen Vollblutproben, validiert.

Außerdem ist der Assay in Verbindung mit **ELITe GALAXY**, einem System für die automatische Extraktion und PCR-Einstellung, und dem **7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument**, einer Real-Time PCR-Plattform, für die Verwendung von humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut validiert.

Das Produkt ist zur Verwendung als Hilfsmittel bei der Diagnose und Überwachung von EBV-Infektionen bei Patienten bestimmt, bei denen Verdacht auf eine EBV-Infektionen besteht oder die auf EBV-Infektionen überwacht werden.

Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen alle relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunde herangezogen werden.

Amplifizierte Sequenz

Sequenz	**Gen**	**Fluorophor**	**Kanal**
Zielorganismus	**EBNA-1-Gen**	FAM	EBV
Internal Control	**Promoter- und 5'-UTR-Region** des **humanen beta-Globin-Gens**	AP525	IC

Validierte Matrix

- In EDTA entnommenes Vollblut
- In EDTA entnommenes Plasma
- Liquor

Kit-Inhalt und zugehörige Produkte

EBV ELITe MGB Kit	EBV ELITe Standard	EBV- ELITe Positive Control
X 4	 X 2	X 2
Gebrauchsfertiger PCR Mix 4 Röhrchen mit 540 µl 96 Reaktionen pro Kit 5 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen	4 Konzentrationen (gebrauchsfertig): 10^5, 10^4, 10^3, 10^2 2 Sets à 4 Röhrchen mit 200 µl 8 Reaktionen pro Kit 4 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen	Gebrauchsfertige PC 2 Röhrchen mit 160 µl 8 Reaktionen pro Kit 4 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen

Maximale Haltbarkeitsdauer: **24 Monate**

Lagerungstemperatur: **-20 °C**

Weitere benötigte, nicht im Kit enthaltene Produkte

- ELITe InGenius-Gerät: INT030.
- ELITe BeGenius-Gerät: INT040.
- ELITe InGenius SP 200: INT032SP200.
- ELITe InGenius SP1000: INT033SP1000
- CPE – Internal Control: CTRCPE
- ELITe InGenius und ELITe BeGenius Verbrauchsmaterialien (siehe ELITe InGenius und ELITe BeGenius Gebrauchsanweisung)

ELITe InGenius- und ELITe BeGenius-Protokoll

› Probenvolumen › CPE-Volumen › Gesamtes Elutionsvolumen	200 µl (InGenius und BeGenius) oder 1000 µl (nur InGenius) 10 µl 100 µl	› PCR-Eingangsvolumen für die Elution: › Volumen Q-PCR-Mix: › Häufigkeit der Kontrollen: › Häufigkeit der Kalibrierung:	20 µl 20 µl 15 Tage 30 Tage

Leistungsdaten für ELITe InGenius und ELITe BeGenius

Matrix	Nachweisgrenze		Diagnostische Sensitivität	Diagnostische Spezifität	Linearität (IU/ml)		Umrechnungsfaktor (IU/Kopien)
	IU/ml	Kopien/ml			IU/ml	Kopien/ml	
Vollblut	104	36	98,5 %	97,3 %	104 - 1000001	36 — 344.828	2,9
Plasma (Probenvolumen 200 µl)	124	65	98,9 %	98,3 %	124 — 10.000.000	65 — 5.263.158	1,9
Plasma (Probenvolumen 1000 µl, nur InGenius)	18	11			99 – 1.000.000	62 – 625000	1,6
Liquor	176	80	98,8 %	100 %	176 — 1.000.000	80 — 454.545	2,2

Probenvorbereitung

Dieses Produkt ist für die Verwendung auf dem **ELITe InGenius** und **ELITe BeGenius** mit den folgenden klinischen Proben, die gemäß den Laborrichtlinien identifiziert und unter den folgenden Bedingungen entnommen, transportiert und aufbewahrt wurden, bestimmt:

Probentyp	Anforderungen an die Entnahme	Transport-/Lagerbedingungen			
		+16 / +26 °C (Raumtemperatur)	+2 / +8 °C	-20 ± 10 ° C	-70 ± 15 ° C
Vollblut	EDTA	≤ 1 d	≤ 3 d	≤ 30 d	≤ 30 d
Plasma	EDTA	≤ 1 d	≤ 3 d	≤ 30 d	≤ 30 d
Liquor	Minimale Patientenblut-vermeiden	≤ 1 d	≤ 2 d	≤ 30 d	≤ 30 d

EDTA, Ethylendiamintetraessigsäure; CSF, Liquor, d, Tag.

ELITe InGenius-Verfahren

Der Benutzer wird von der ELITe InGenius-Software zur Vorbereitung des Laufs Schritt für Schritt durch die grafische Benutzeroberfläche geführt. Alle Schritte: Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation werden automatisch durchgeführt. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: vollständiger Lauf „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) und „PCR Only“ (Nur PCR).

Vor der Analyse

1. ELITe InGenius einschalten. Mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden. Den Modus „Closed“ (Geschlossen) wählen.	**2.** Kalibratoren überprüfen: **Q-PCR Standard** im Menü „Calibration“ (Kalibrierung). Kontrollen überprüfen: **Positive Control** und **Negative Control** im Menü „Controls“ (Kontrollen). Hinweis: Alle müssen ausgeführt und genehmigt worden sein und dürfen nicht abgelaufen sein.	**3.** Die **PCR Mix**- und **CTRCPE**-Röhrchen auftauen. Vorsichtig vortexen. 5 Sek. herunterzentrifugieren.

Verfahren 1 – Vollständiger Lauf: „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) (z. B. Proben)

1. Auf der Startseite „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen	**2.** Die Extraktionsvolumina überprüfen: Eingangsvolumen: „200 µL“ oder „1000 µL“, Elution: „100 µL“	**3.** Die Proben-Barcodes mit dem tragbaren Barcodeleser scannen oder die Proben-ID eingeben
4. Das gewünschte Assay-Protokoll auswählen: EBV ELITe_WB_200_100 oder EBV ELITe_PL_200_100 oder EBV ELITe_PL_1000_100 oder EBV ELITe_CSF_200_100	**5.** Die Methode „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) und die „Sample Position“ (Probenposition) auswählen: Primärröhrchen oder Extraktionsröhrchen	**6.** Den PCR Mix und die Internal-Control in den Inventory Block (Bestandsmanager) laden
7. Folgendes laden: PCR Cassette, Extraktionskartusche, Elution tube (Elutionsröhrchen), Spitzenkassette, Extraction Tube (Extraktionsröhrchen)-Racks und Primärproben-Racks	**8.** Tür schließen. Analyselauf starten	**9.** Ergebnisse anzeigen, genehmigen und speichern

HINWEIS!
Wird der Modus „Extract Only“ (nur Extraktion) benötigt, zum Verfahren das Benutzerhandbuch des Geräts beachten.

Verfahren 2: „PCR Only“ (Nur PCR) (z. B. Eluate, Standards, Kontrollen)

1. Auf der Startseite „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen	**2.** Die Extraktionsvolumina überprüfen: Eingangsvolumen: „200 µL“ oder „1000 µL“, Elution: „100 µL“	**3.** Die Proben-Barcodes mit dem tragbaren Barcodeleser scannen oder die Proben-ID eingeben
4. Das gewünschte Assay-Protokoll auswählen: EBV ELITe_PC und EBV ELITe_NC oder EBV ELITe_STD oder EBV ELITe_PL_200_100 oder EBV ELITe_ PL_1000_100 oder EBV ELITe_WB_ 200_100, EBV ELITe_ CSF_ 200_100.	**5.** Die Methode „PCR Only“ (Nur PCR) und die „Sample Position“ (Probenposition) „Elution Tube“ (Elutionsröhrchen) auswählen	**6.** Den PCR Mix in den „Inventory Block“ (Bestandsmanager) laden
7. Folgendes laden: PCR Cassette-Rack und Elution tube (Elutionsröhrchen)-Rack mit der extrahierten Nukleinsäure	**8.** Tür schließen. Analyselauf starten	**9.** Ergebnisse anzeigen, genehmigen und speichern

ELITe BeGenius-Verfahren

Der Benutzer wird von der ELITe BeGenius-Software zur Vorbereitung des Laufs Schritt für Schritt durch die grafische Benutzeroberfläche geführt. Alle Schritte: Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation werden automatisch durchgeführt. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: vollständiger Lauf „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) und „PCR Only“ (Nur PCR).

Vor der Analyse

1. ELITe BeGenius einschalten. Mit dem Benutzernamen und Passwort anmelden. Den Modus „Closed“ (Geschlossen) wählen.	**2.** Kalibratoren überprüfen: **Q-PCR Standard** im Menü „Calibration“ (Kalibrierung). Kontrollen überprüfen: **Positive Control** und **Negative Control** im Menü „Controls“ (Kontrollen). Hinweis: Alle müssen ausgeführt und genehmigt worden sein und dürfen nicht abgelaufen sein.	**3.** Die **PCR Mix**- und **CTRCPE**-Röhrchen auftauen. Vorsichtig vortexen. 5 Sek. herunterzentrifugieren.

Verfahren 1 – Vollständiger Lauf: „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) (z. B. Proben)

1. Auf dem Touchscreen „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen und anschließend auf den Laufmodus „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) klicken.	**2.** Das Sample Rack (Probenständer) mit den barcodierten Proben in die Cooler Unit einsetzen. Der Barcode-Scan ist bereits aktiv	**3.** Die Extraktionsvolumina überprüfen: Eingang: „200 µL“, Elutionsvolumen: „100 µL“
4. Das gewünschte Assay-Protokoll auswählen: EBV ELITe_Be_WB_200_100 oder EBV ELITe_Be_PL_200_100 oder EBV ELITe_Be_CSF_200_100 **Hinweis:** Bei Durchführung einer zweiten Extraktion die Schritte 2 bis 4 wiederholen	**5.** Die Etiketten ausdrucken, um die leeren Elution Tubes (Elutionsröhrchen) mit einem Barcode zu versehen. Die Röhrchen in das Elution Rack (Elutionsablage) laden und in die Cooler Unit einsetzen	**6.** Den PCR Mix und die Internal Control in das „Reagent/Elution Rack“ (Reagenz-/Elutionsablage) laden und in die Cooler Unit einsetzen
7. Das „PCR Rack“ mit der „PCR Cassette“ und den „Extraction Rack“ (Extraktionsrack) mit den „ELITe InGenius SP 200“ Extraktionskartuschen und die für die Extraktion erforderlichen Verbrauchsmaterialien laden	**8.** Tür schließen. Analyselauf starten	**9.** Ergebnisse anzeigen, genehmigen und speichern

HINWEIS!
Wird der Modus „Extract Only“ (nur Extraktion) benötigt, zum Verfahren das Benutzerhandbuch des Geräts beachten.

Verfahren 2: „PCR Only“ (Nur PCR) (z. B. Eluate, Standards, Kontrollen)

1. Auf der Startseite „Perform Run“ (Lauf durchführen) auswählen	**2.** Die Extraktionsvolumina überprüfen: Eingang: „200 µL“, Elutionsvolumen: „100 µL“	**3.** Die Proben-Barcodes mit dem tragbaren Barcodeleser scannen oder die Proben-ID eingeben
4. Das gewünschte Assay-Protokoll auswählen: EBV ELITe_Be_PC und EBV ELITe_Be_NC, oder EBV ELITe_Be_STD.	**5.** Die Methode „PCR Only“ (Nur PCR) und die „Sample Position“ (Probenposition) „Elution Tube“ (Elutionsröhrchen) auswählen	**6.** Den PCR Mix in den „Inventory Block“ (Bestandsmanager) laden
7. Folgendes laden: PCR Cassette-Rack und Elution tube (Elutionsröhrchen)-Rack mit der extrahierten Nukleinsäure	**8.** Tür schließen. Analyselauf starten	**9.** Ergebnisse anzeigen, genehmigen und speichern

Appendix B In Kombination mit MyGeniusPRO verwendetes EBV ELITe MGB Kit

VORSICHT

Dieses Dokument ist eine vereinfachte Version der offiziellen Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch das vollständige Dokument: www.elitechgroup.com

Verwendungszweck

Das Produkt **EBV ELITe MGB® Kit** ist ein *In-vitro*-Diagnostikum, das für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal als quantitativer Nukleinsäure- und Real-Time-PCR-Assay zum Nachweis und zur Quantifizierung der **DNA des Epstein-Barr-Virus (EBV)**, die aus klinischen Proben extrahiert wurde, bestimmt ist.

Dieser Assay ist in Verbindung mit den Geräten **ELITe InGenius®** und**ELITe BeGenius®**, automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut, in EDTA entnommenem Plasma und Liquor, validiert.

Dieser Assay ist auch in Verbindung mit dem Gerät **MyGenius PRO®** (eingetragener Name: ELIVERSE®), einem automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen, in EDTA entnommenen Vollblutproben, validiert.

Außerdem ist der Assay in Verbindung mit **ELITe GALAXY**, einem System für die automatische Extraktion und PCR-Einstellung, und dem **7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument**, einer Real-Time PCR-Plattform, für die Verwendung von humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut validiert.

Das Produkt ist zur Verwendung als Hilfsmittel bei der Diagnose und Überwachung von EBV-Infektionen bei Patienten bestimmt, bei denen Verdacht auf eine EBV-Infektionen besteht oder die auf EBV-Infektionen überwacht werden.

Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen alle relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunde herangezogen werden.

Amplifizierte Sequenz

Sequenz	**Gen**	**Fluorophor**	**Kanal**
Zielorganismus	**EBNA-1-Gen**	FAM	EBV
Internal Control	**Promoter- und 5'-UTR-Region** des **humanen beta-Globin-Gens**	AP525	IC

Validierte Matrix

- In EDTA entnommenes Vollblut

Kit-Inhalt und zugehörige Produkte

EBV ELITe MGB Kit	EBV ELITe Standard	EBV- ELITe Positive Control
X 4	 X 2	X 2
Gebrauchsfertiger PCR Mix 4 Röhrchen mit 540 µl 96 Reaktionen pro Kit 5 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen	4 Konzentrationen (gebrauchsfertig): 10^5, 10^4, 10^3, 10^2 2 Sets à 4 Röhrchen mit 200 µl 8 Reaktionen pro Kit 4 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen	Gebrauchsfertige PC 2 Röhrchen mit 160 µl 8 Reaktionen pro Kit 4 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen

Maximale Haltbarkeitsdauer: **24 Monate**

Lagerungstemperatur: **-20 °C**

Weitere benötigte, nicht im Kit enthaltene Produkte

• **MyGenius PRO** (EG SpA Art.-Nr.: INT050) • **MyGenius PRO Software,** Version BB-04 (oder später)	• **Negative Control** (EG SpA, Art.-Nr. CTRNEG) • **Internal Control Maxi** (EG SpA, Art.-Nr. ICMAXI) • **MyGenius PRO** Verbrauchsmaterialien (siehe MyGenius PRO Gebrauchsanweisung)

Protokoll bei MyGenius PRO

› Probenvolumen › IC-Volumen › Gesamtes Elutionsvolumen	200 µl 10 µl 100 µl	› PCR-Eingangsvolumen für die Elution › Volumen Q-PCR-Mix › Häufigkeit der Kontrollen › Häufigkeit der Kalibrierung	20 µl 20 µl 15 Tage 60 Tage

Leistungen von MyGenius PRO

Matrix	Nachweisgrenze		Diagnostische Sensitivität	Diagnostische Spezifität	Linearität (IU/ml)		Umrechnungsfaktor (IU/Kopien)
	IU/ml	Kopien/ml			IU/ml	Kopien/ml	
Vollblut	104	36	98,5 %	97,3 %	104 - 1000001	36 — 344.828	2,9

Probenvorbereitung

Dieses Produkt ist zur Verwendung auf dem **MyGenius PRO** mit den folgenden klinischen Proben, die gemäß den Laborrichtlinien identifiziert und unter den folgenden Bedingungen entnommen, transportiert und aufbewahrt wurden, bestimmt:

Probentyp	Anforderungen an die Entnahme	Transport-/Lagerbedingungen			
		+16 / +26 °C (Raumtemperatur)	+2 / +8 °C	-20 ± 10 ° C	-70 ± 15 ° C
Vollblut	EDTA	≤ 1 d	≤ 3 d	≤ 30 d	≤ 30 d

C EDTA: Ethylendiamintetraessigsäure; d: Tag.

Verfahren bei MyGenius PRO

Der Benutzer wird von der MyGenius PRO-Software zur Vorbereitung des Laufs Schritt für Schritt durch die grafische Benutzeroberfläche geführt. Alle Schritte: Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation werden automatisch durchgeführt. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: vollständiger Lauf „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) und „PCR Only“ (Nur PCR). Die Ergebnisinterpretation wird automatisch durchgeführt. Es stehen zwei Betriebsmodi zur Verfügung: vollständiger Lauf „Extract + PCR“ (Extraktion + PCR) und „PCR Only“ (Nur PCR, nur bei Kalibratoren und Kontrollen).

1. MyGenius PRO einschalten. Mit dem Benutzernamen und Passwort **STANDBY**-Modus anmelden.	**2.** Alle Verbrauchsmaterialien in die Schubladen einsetzen und Flüssigabfalltank und Festabfallbehälter falls notwendig leeren. Die Schaltfläche „Start“ (Starten) drücken, um die Vorbereitung durchzuführen: Nach der Vorbereitung wechselt das Gerät in den Modus „Operation“ (Betrieb).	**3.** Kalibratoren überprüfen: **Q-PCR Standard** im Menü „Calibration“ (Kalibrierung). Kontrollen überprüfen: **Positive Control** und **Negative Control** im Menü „Controls“ (Kontrollen) Hinweis: Alle müssen ausgeführt und genehmigt worden sein und dürfen nicht abgelaufen sein.

4. Die **PCR Mix**- und **IC MAXI**-Röhrchen auftauen. Vorsichtig vortexen. 5 Sek. herunterzentrifugieren.	**5.** PCR Mix-Röhrchen unter Befolgung der Bildschirmanweisungen in das Reagenzienkarussell laden.	**6.**IC MAXI-Röhrchen in das dafür vorgesehene blaue Rack einsetzen und dieses in den Auto-Sampler-Bereich laden.
7a. Wenn das Gerät mit dem LIS verbunden ist, die Proben in den für die verwendeten Röhrchendurchmesser vorgesehenen Racks in den Auto-Sampler-Bereich einsetzen. Die Extraktion startet automatisch. **7b**. Wenn das Gerät nicht mit dem LIS verbunden ist, in der Probenliste auf „Assign test“ (Test zuweisen) drücken, den Barcode der Probe mit dem externen Barcode-Lesegerät lesen, als Matrix „Whole blood“ (Vollblut) auswählen und das Assay-Protokoll „EBV ELITe_My_WB_IU_200_100“ oder „EBV ELITe_My_WB_cmL_200_100“ zuweisen. Die Proben mithilfe der für die verwendeten Röhrchendurchmesser vorgesehenen Racks in den Auto-Sampler-Bereich einsetzen. Die Extraktion startet automatisch.		

Appendix C EBV ELITe MGB Kit verwendet zusammen mit ABI 7500 Instrument

VORSICHT

Dieses Dokument ist eine vereinfachte Version der offiziellen Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch das vollständige Dokument: www.elitechgroup.com

Verwendungszweck

Das Produkt **EBV ELITe MGB® Kit** ist ein *In-vitro*-Diagnostikum, das für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal als quantitativer Nukleinsäure- und Real-Time-PCR-Assay zum Nachweis und zur Quantifizierung der **DNA des Epstein-Barr-Virus (EBV)**, die aus klinischen Proben extrahiert wurde, bestimmt ist.

Dieser Assay ist in Verbindung mit den Geräten **ELITe InGenius®** und**ELITe BeGenius®**, automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut, in EDTA entnommenem Plasma und Liquor, validiert.

Dieser Assay ist auch in Verbindung mit dem Gerät **MyGenius PRO®** (eingetragener Name: ELIVERSE®), einem automatisierten und integrierten System zur Extraktion, Real-Time-PCR und Ergebnisinterpretation mit humanen, in EDTA entnommenen Vollblutproben, validiert.

Außerdem ist der Assay in Verbindung mit **ELITe GALAXY**, einem System für die automatische Extraktion und PCR-Einstellung, und dem **7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument**, einer Real-Time PCR-Plattform, für die Verwendung von humanen Proben von in EDTA entnommenem Vollblut validiert.

Das Produkt ist zur Verwendung als Hilfsmittel bei der Diagnose und Überwachung von EBV-Infektionen bei Patienten bestimmt, bei denen Verdacht auf eine EBV-Infektionen besteht oder die auf EBV-Infektionen überwacht werden.

Bei der Interpretation der Ergebnisse müssen alle relevanten klinischen Beobachtungen und Laborbefunde herangezogen werden.

Amplifizierte Sequenz

Sequenz	**Gen**	**Fluorophor**	**Kanal**
Zielorganismus	**EBNA-1-Gen**	FAM	EBV
Internal Control	**Promoter- und 5'-UTR-Region** des **humanen beta-Globin-Gens**	AP525	IC

Validierte Matrix

- In EDTA entnommenes Vollblut

Kit-Inhalt und zugehöriges Produkt

EBV ELITe MGB Kit	EBV ELITe Standard	EBV- ELITe Positive Control
X 4	X 2	X 2
Gebrauchsfertiger PCR Mix 4 Röhrchen mit 540 µl 100 Reaktionen pro Kit 5 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen	4 Konzentrationen (gebrauchsfertig): 10^5, 10^4, 10^3, 10^2 2 Sets à 4 Röhrchen mit 200 µl 8 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen	Gebrauchsfertige PC 2 Röhrchen mit 160 µl 12 Reaktionen pro Kit (Galaxy) 8 Einfrier- und Auftau-Zyklen pro Röhrchen

Maximale Haltbarkeitsdauer: **24 Monate**

Lagerungstemperatur: **-20 °C**

Weitere benötigte, nicht im Kit enthaltene Produkte

- **ELITe GALAXY** INT020
- **ELITe GALAXY 300 extraction kit:** INT021EX
- **ABI 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument**
- CPE – Internal Control: CTRCPE
- Hochreines Wasser für die Molekularbiologie

Leistung von 7500 Real-Time PCR Instrument

Methode der Nuklein-säureex-traktion	Nachweis-grenze	Diagnosti-sche Spezifität	Diagnosti-sche Sensitivität	Linearität (IU/ml)	Formel zur Quantifizierung (gEq/ml)	Umrechnungs-faktor gEq/ml in IU/ml
ELITe GALAXY	**127 IU/ml** 249 gEq/ml	**100 %** (65/65)	**100 %** (60/60)	178→ 17,8 x 10^6	35 x Menge	0,51
QIAsym-phony SP/ AS	—	**98,3 %** (59/60)	**100 %** (60/60)	-	24 x Menge	0,46

7500 Real-Time PCR Instrument-Verfahren

Das nachfolgende Verfahren fasst die Hauptschritte der Probenanalyse mit dem herkömmlichen PCR-Arbeitsablauf zusammen: validierte Extraktionssysteme, PCR-Geräteeinstellungen, PCR-Einrichtung und Ergebnisinterpretation.

Extraktion – Validierte Systeme

Extraktion	Validierte Matrix	Verarbeitetes Probenvolumen	Mindestproben-volumen	Gesamtes Elutionsvolumen	CPE Internal-Control-Volumen
ELITe Galaxy	VB	300 µl	400 µl	200 µl	10 µl

Amplifikation – Einstellungen von 7500 Fast Dx

1. Thermocycler einschalten
2. „EBV“-Detektor auf „FAM“ und Quencher auf „keinen“ einstellen
3. „Internal Control“-Detektor auf „VIC“ und Quencher auf „keinen“ einstellen

4. Passive Fluoreszenz auf „Cy5“ einstellen
5. Das Temperaturprofil wie angegeben einstellen. Die Fluoreszenzerfassung muss während des Hybridisierungsschritts auf 60 °C eingestellt werden.

Phase	Temperatur	Zeitsteuerung
Dekontamination	50 °C	2 min
Erste Denaturierung	94 °C	2 min
Amplifikation Detektion 45 Zyklen	94 °C	10 s
	60 °C	30 s
	72 °C	20 s

Die Schmelzkurvenanalyse ist optional, vollständige Gebrauchsanweisung beachten

Amplifikation – PCR-Einrichtung (durchgeführt von ELITe GALAXY und QIAsymphony)

Zum Einrichten des PCR-Laufs:

1. Q-PCR Mix und Positive Control /Q-PCR Standard-Röhrchen auftauen
2. vorsichtig mischen und herunterzentrifugieren
3. die **Negative Control** (nicht im Lieferumfang enthalten) vorbereiten
4. eine **Q-PCR Microplate** vorbereiten
5. Das Gerät bereitet automatisch die PCR vor, indem es in jede Vertiefung der **Q-PCR Microplate 20 µl PCR Mix** und **20 µl extrahierte DNA** / **Q-PCR Standard** / **Kontrollen** dispensiert.

Nachdem das Gerät die PCR vorbereitet hat:

1. die **Q-PCR Microplate** mit einer optisch klaren Dichtungsfolie verschließen.
2. die **Q-PCR Microplate** auf das **7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument** überführen und die PCR starten. Die Laufdatei mit einem eindeutigen und wiedererkennbaren Namen (z. B. „Jahr-Monat-Tag-TARGET-EGSpA“) speichern.

Amplifikation – Schwellenwert für die qualitative Analyse

Instrument	EBV FAM	Internal Control VIC
7500 Fast Dx Real Time PCR	0,2	0,1

Interpretation

Qualitative Ergebnisse		
EBV-Ct-Wert	**Internal Control Ct-Wert**	**Interpretation**
Determined (bestimmt)	—	Positiv
Undetermined (unbestimmt)	Ct ≤ 35	Negativ
	Ct > 35 oder Undetermined (unbestimmt)	Ungültig*

* *Den Assay ab der Extraktion wiederholen*

Quantitative Ergebnisse
Der für jede Probe erhaltene EBV-Ct-Wert und die generierte Standardkurve werden zur Berechnung der Menge der Ziel-DNA in der Reaktion herangezogen.
Die Probenquantifizierung reicht zirka von 10 bis 10^6 Kopien/Reaktion.

ELITechGroup S.p.A.
C.so Svizzera, 185, 10149 Torino ITALIEN
Tel. +39-011 976 191
Fax +39-011 936 76 11
E-Mail: emd.support@elitechgroup.com
Website: www.elitechgroup.com